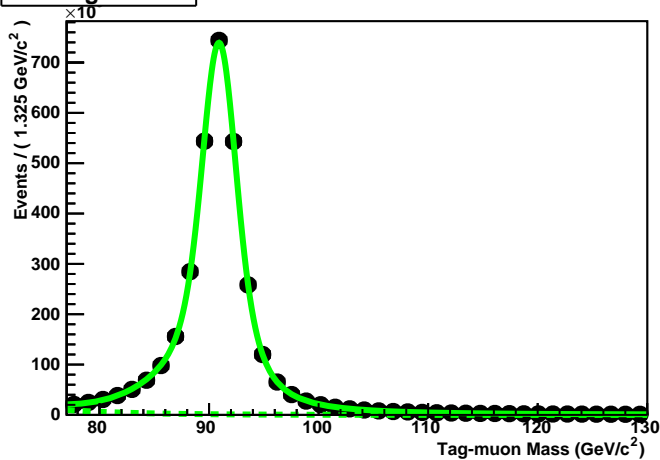
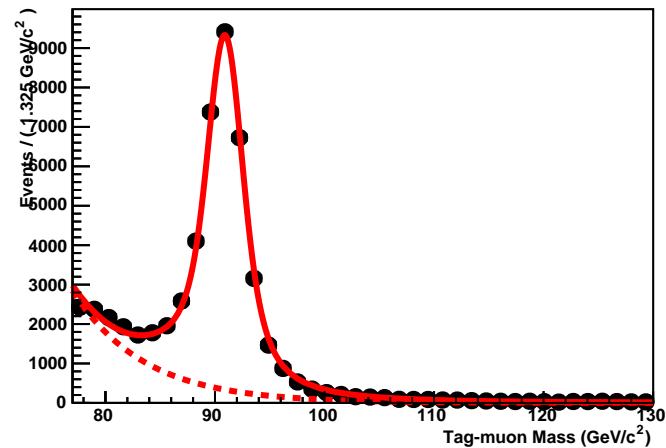
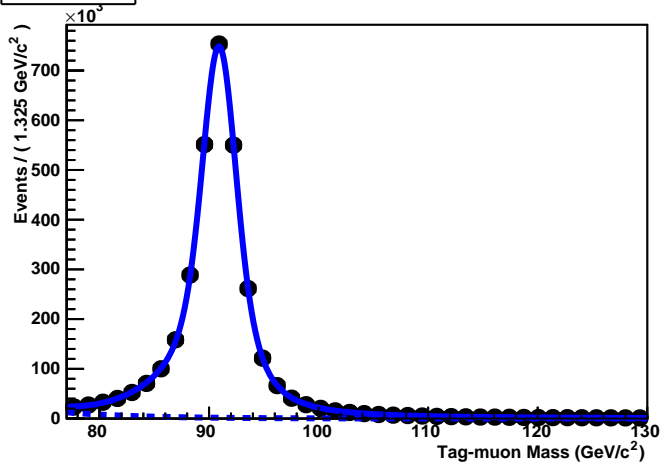


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.778 ± 0.007
 efficiency = 0.98796 ± 0.00008
 fSigAll = 0.9809 ± 0.0006
 lf = -0.1538 ± 0.003
 lp = -0.1501 ± 0.005
 mean1 = 90.929 ± 0.002
 mean2 = 87.50 ± 0.06
 numTot = 3284842 ± 1812
 sigma1 = 1.048 ± 0.003
 sigma2 = 3.43 ± 0.04
 vFrac = 0.893 ± 0.002