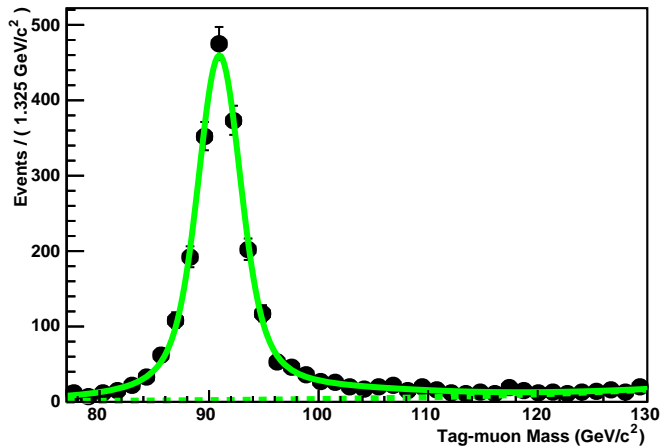
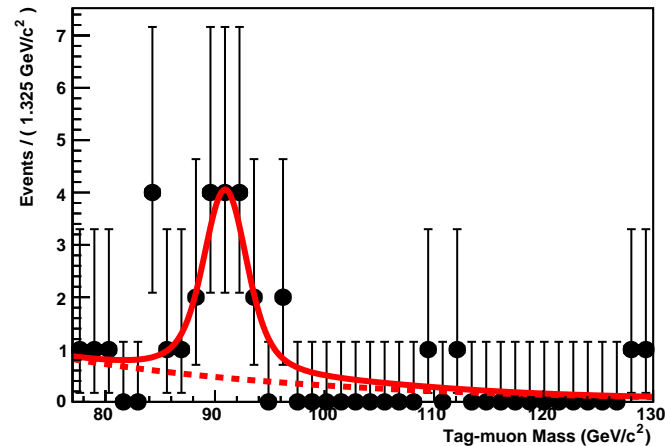
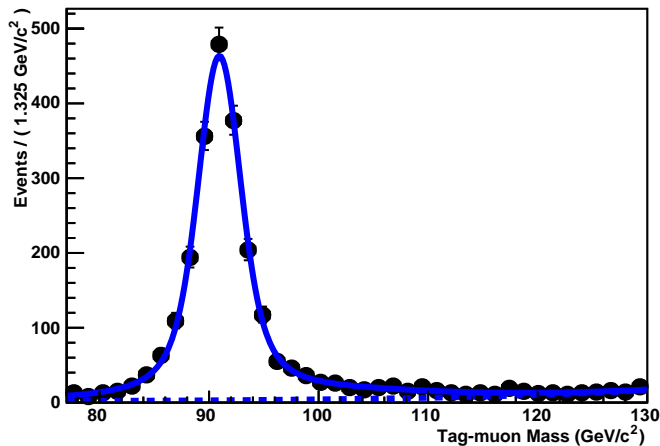


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.95 ± 0.03
 efficiency = 0.992 ± 0.002
 fSigAll = 0.90 ± 0.05
 lf = -0.042 ± 0.02
 lp = 0.05 ± 0.04
 mean1 = 90.94 ± 0.06
 mean2 = 100 ± 4
 numTot = 2524 ± 50
 sigma1 = 1.40 ± 0.09
 sigma2 = 9 ± 7
 vFrac = 0.91 ± 0.06