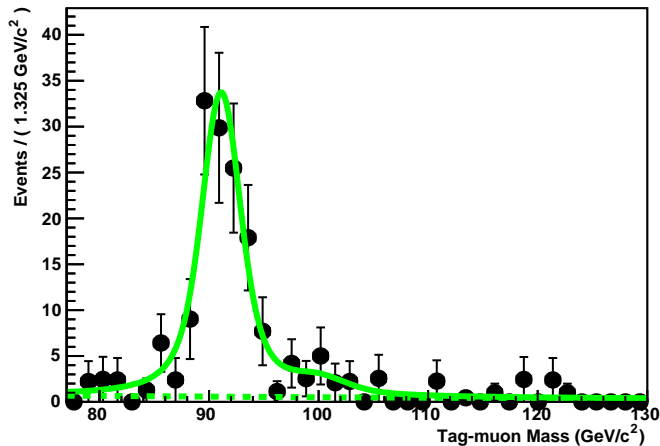
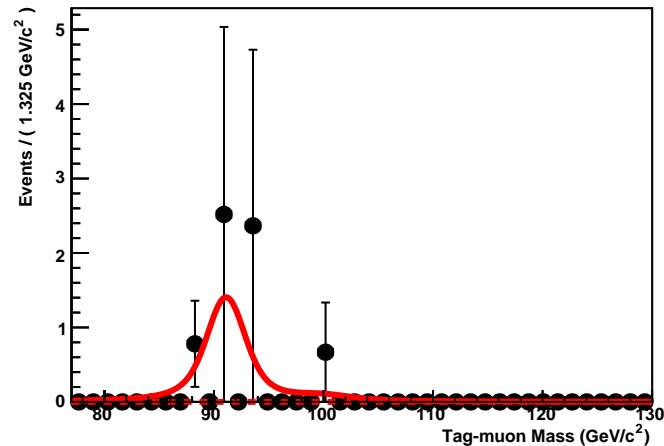
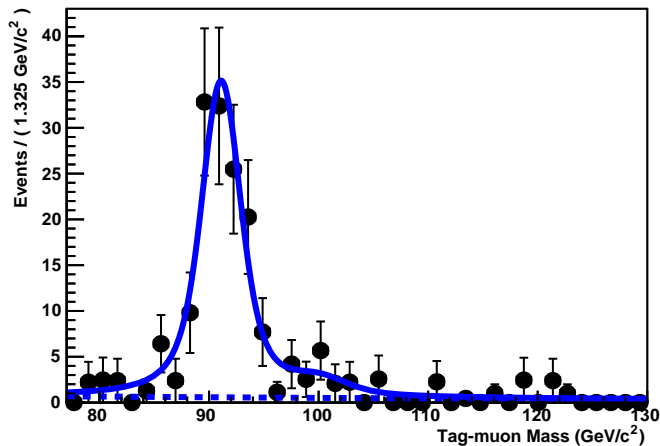


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 1.00 ± 0.02
 efficiency = 0.96 ± 0.02
 fSigAll = 0.89 ± 0.05
 lf = -0.35 ± 0.5
 lp = -0.013 ± 0.02
 mean1 = 91.1 ± 0.2
 mean2 = 100 ± 3
 numTot = 176 ± 13
 sigma1 = 1.2 ± 0.2
 sigma2 = 2.0 ± 0.6
 vFrac = 0.94 ± 0.03