




Passing Probes

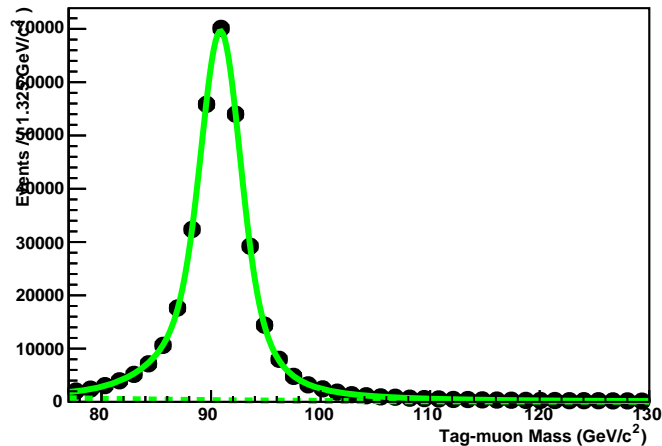

Failing Probes

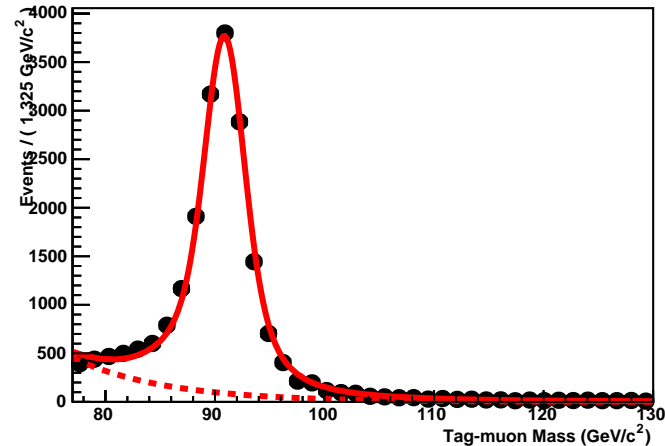

All Probes

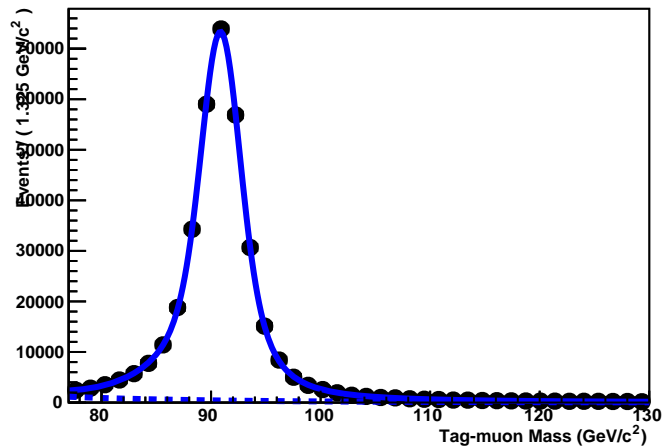

effBkg = 0.75 ± 0.01
 efficiency = 0.9495 ± 0.0005
 fSigAll = 0.967 ± 0.002
 lf = -0.1176 ± 0.005
 lp = -0.0563 ± 0.003
 mean1 = 90.880 ± 0.008
 mean2 = 88.4 ± 0.2
 numTot = 358876 ± 599
 sigma1 = 1.31 ± 0.01
 sigma2 = 3.9 ± 0.1
 vFrac = 0.880 ± 0.006