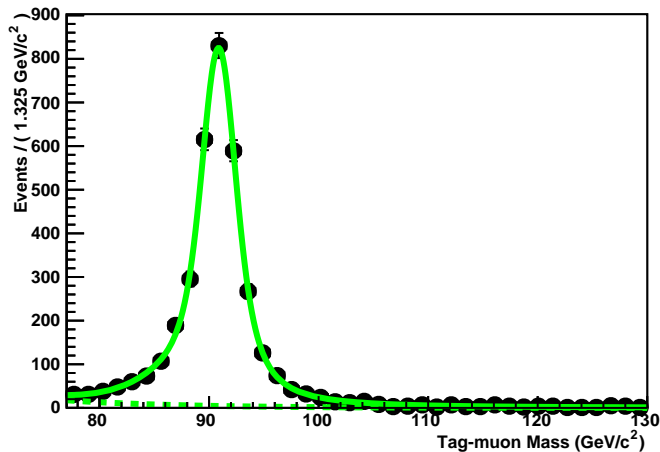
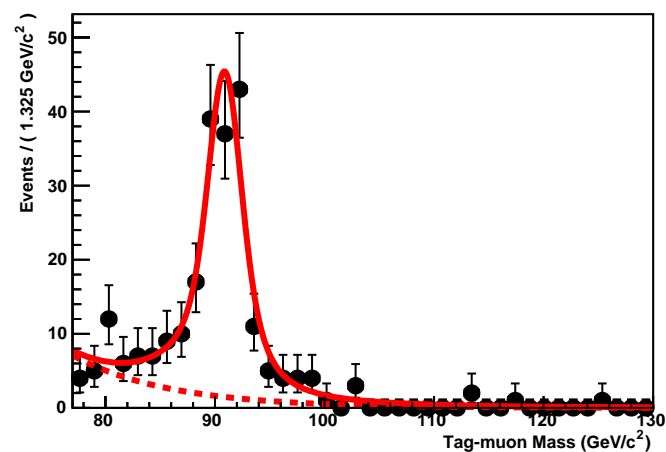
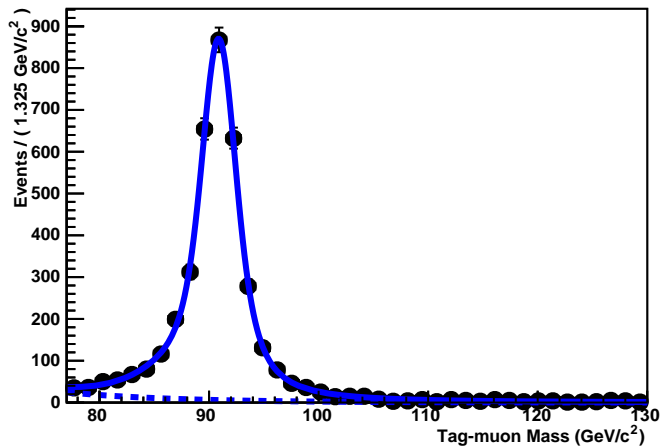


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.74 ± 0.10
 efficiency = 0.949 ± 0.004
 fSigAll = 0.95 ± 0.02
 lf = -0.113 ± 0.03
 lp = -0.100 ± 0.04
 mean1 = 90.90 ± 0.06
 mean2 = 87 ± 1
 numTot = 3815 ± 62
 sigma1 = 1.00 ± 0.09
 sigma2 = 3 ± 1
 vFrac = 0.90 ± 0.04