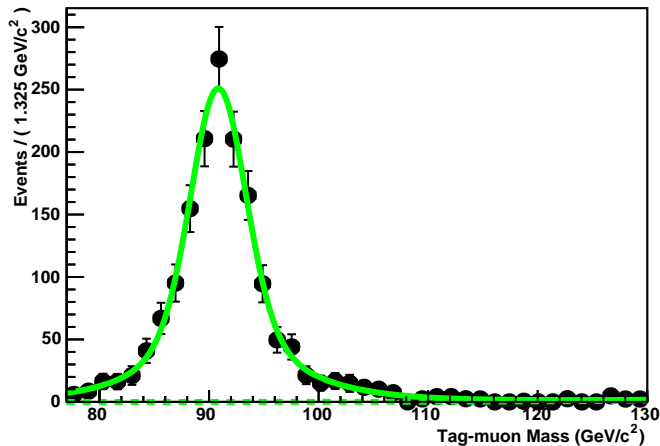
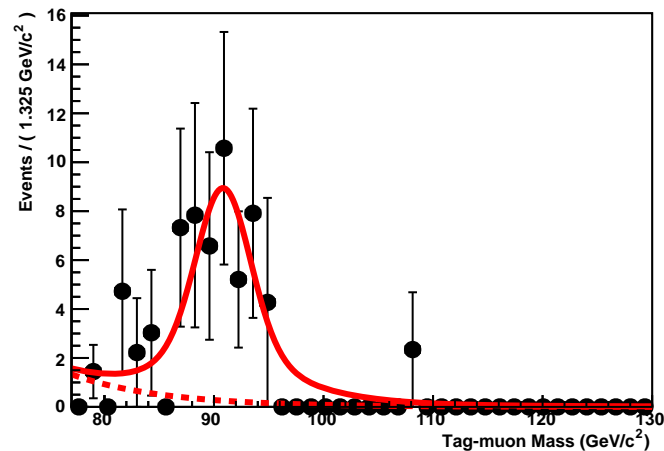
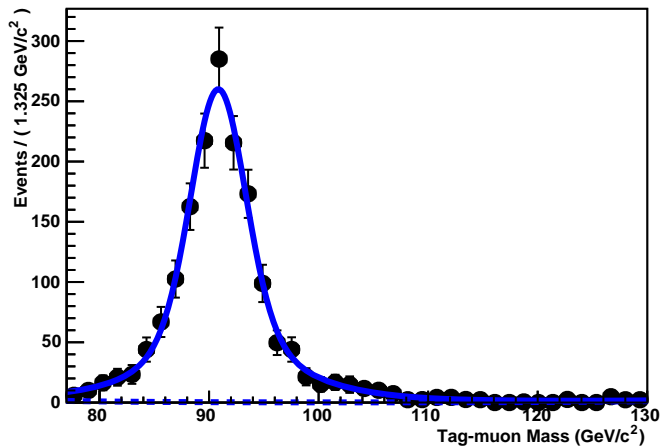


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.5 ± 0.2
 efficiency = 0.967 ± 0.005
 fSigAll = 0.990 ± 0.004
 lf = -0.120 ± 0.07
 lp = 0.10 ± 0.04
 mean1 = 90.8 ± 0.1
 mean2 = 92 ± 1
 numTot = 1664 ± 41
 sigma1 = 2.1 ± 0.2
 sigma2 = 7 ± 1
 vFrac = 0.84 ± 0.05