




Passing Probes

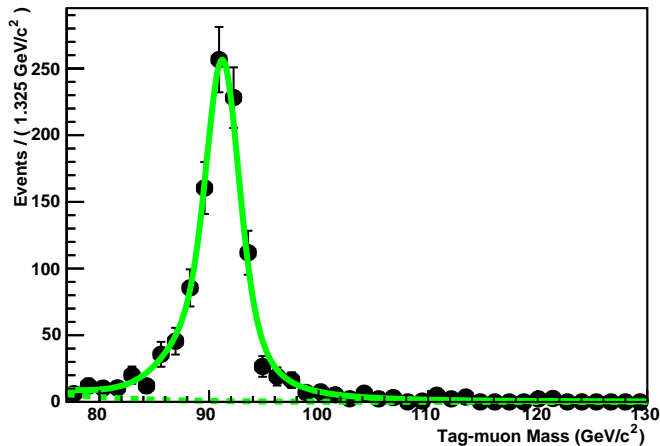

Failing Probes

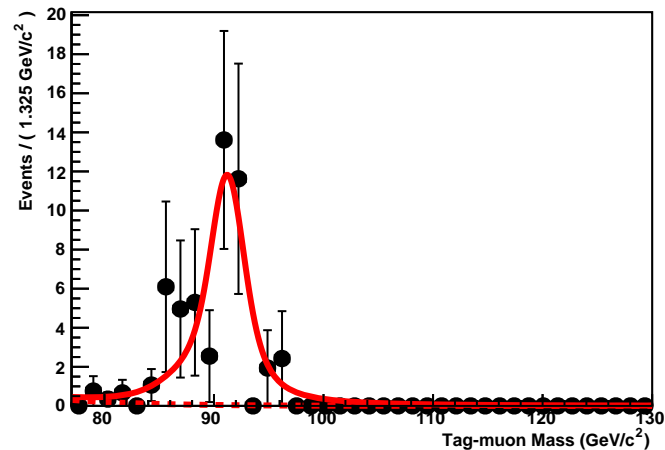

All Probes

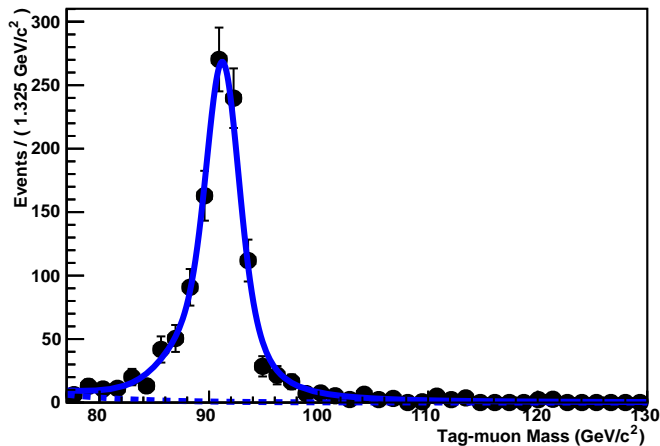

effBkg = 0.94 ± 0.10
efficiency = 0.956 ± 0.007
fSigAll = 0.97 ± 0.02
lf = -0.14 ± 0.1
lp = -0.16 ± 0.1
mean1 = 91.23 ± 0.09
mean2 = 87 ± 1
numTot = 1159 ± 34
sigma1 = 1.00 ± 0.04
sigma2 = 2 ± 2
vFrac = 0.91 ± 0.04