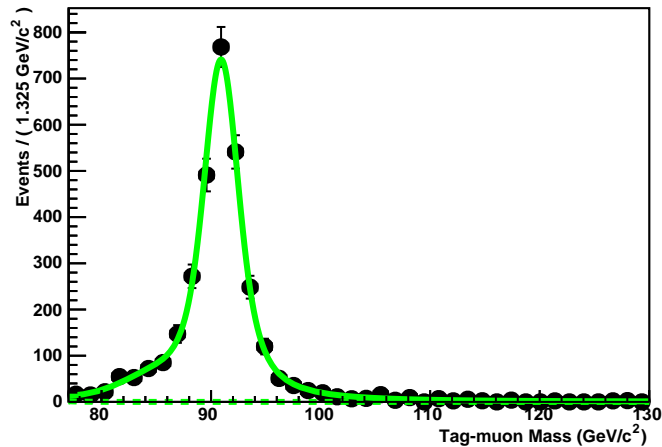
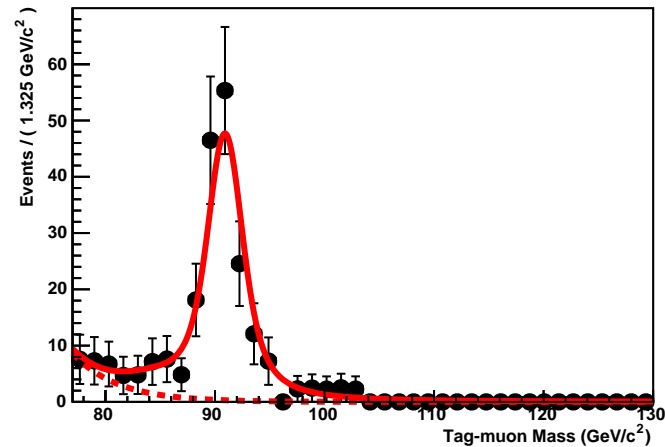
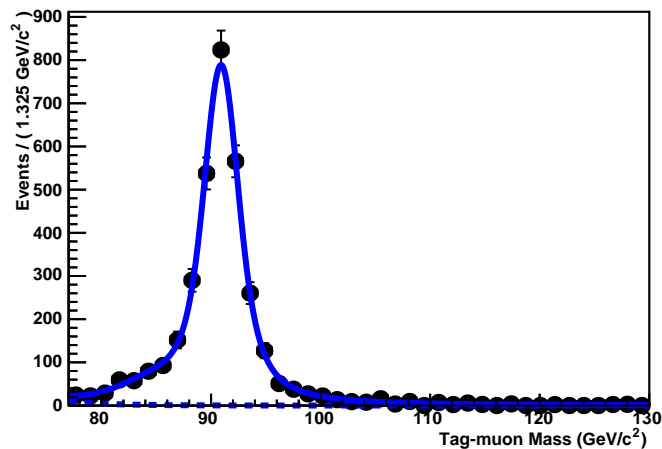


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.1 ± 0.5
 efficiency = 0.940 ± 0.005
 fSigAll = 0.992 ± 0.004
 lf = -0.24 ± 0.1
 lp = -0.76 ± 1.0
 mean1 = 90.92 ± 0.05
 mean2 = 85 ± 1
 numTot = 3346 ± 58
 sigma1 = 1.0 ± 0.1
 sigma2 = 2.5 ± 0.9
 vFrac = 0.93 ± 0.02