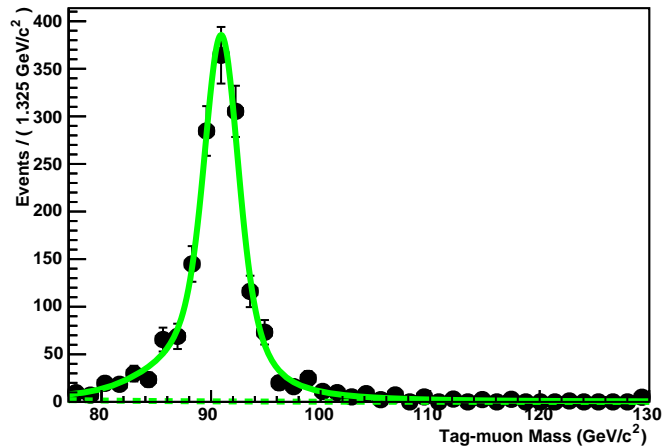
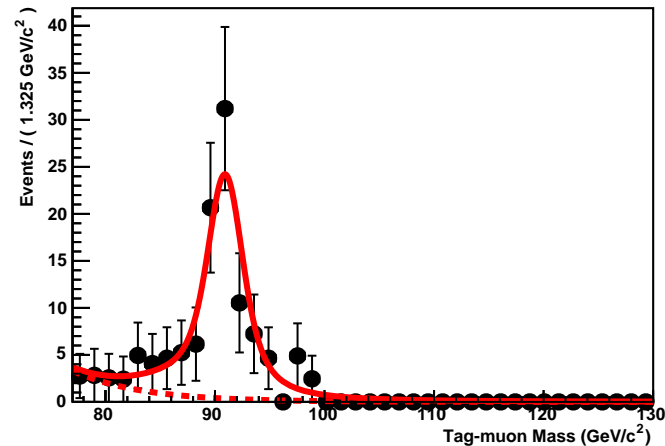
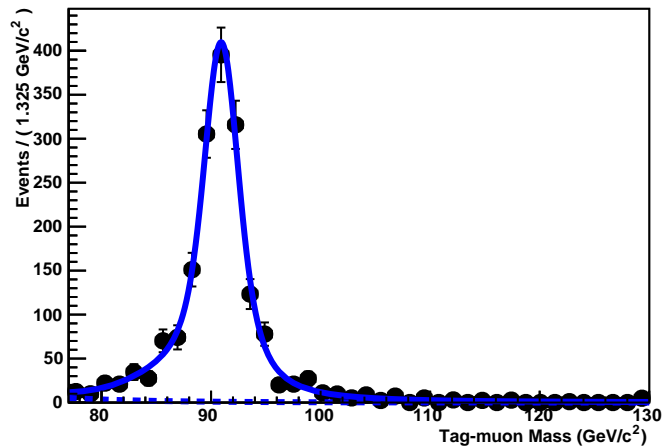


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.5 ± 0.7
 efficiency = 0.942 ± 0.006
 fSigAll = 0.98 ± 0.02
 lf = -0.160 ± 0.07
 lp = -0.09 ± 0.1
 mean1 = 90.94 ± 0.08
 mean2 = 87 ± 3
 numTot = 1772 ± 42
 sigma1 = 1.0 ± 0.4
 sigma2 = 3 ± 2
 vFrac = 0.90 ± 0.08