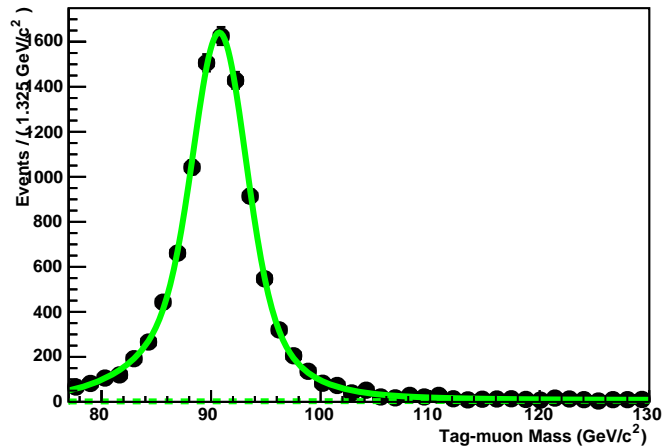
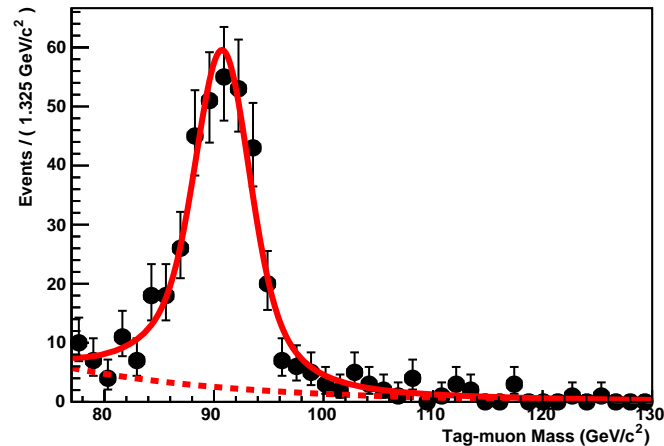
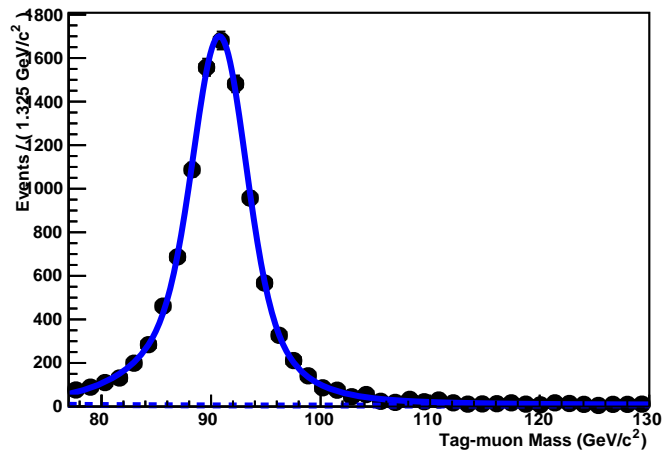


Passing Probes

Failing Probes

All Probes


effBkg = 0.7 ± 0.1
 efficiency = 0.966 ± 0.002
 fSigAll = 0.980 ± 0.007
 lf = -0.062 ± 0.01
 lp = 0.02 ± 0.03
 mean1 = 90.78 ± 0.06
 mean2 = 89.1 ± 0.5
 numTot = 10600 ± 103
 sigma1 = 1.93 ± 0.10
 sigma2 = 5.2 ± 0.6
 vFrac = 0.80 ± 0.05