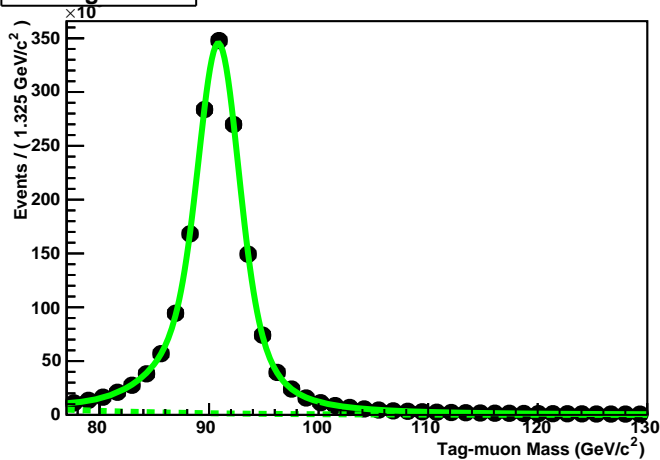
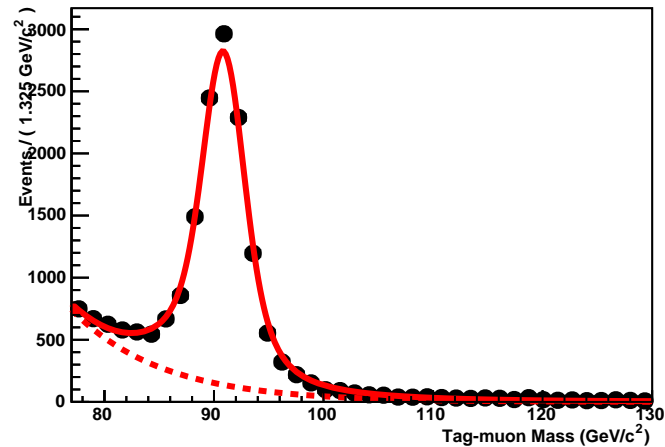
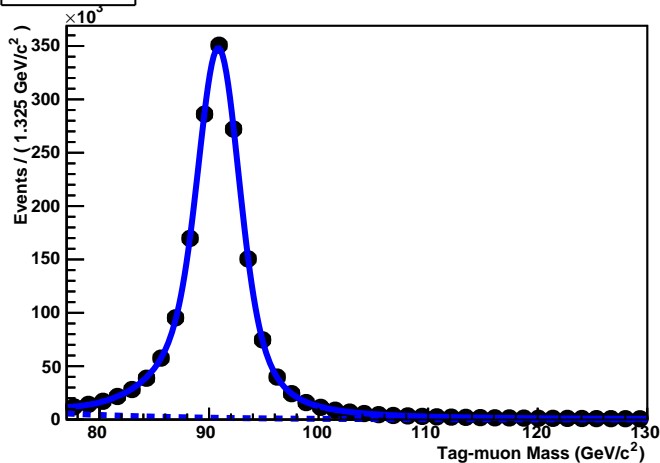


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.900 ± 0.003
 efficiency = 0.99225 ± 0.00009
 fSigAll = 0.9735 ± 0.0007
 lf = -0.1221 ± 0.004
 lp = -0.0888 ± 0.002
 mean1 = 90.874 ± 0.004
 mean2 = 88.22 ± 0.09
 numTot = 1736511 ± 1318
 sigma1 = 1.373 ± 0.006
 sigma2 = 3.70 ± 0.05
 vFrac = 0.878 ± 0.003