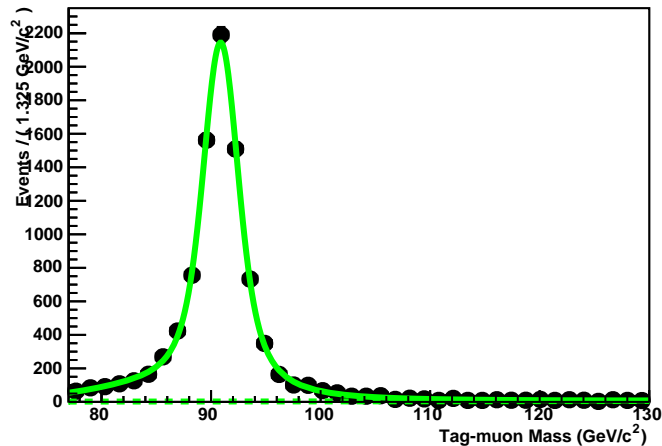
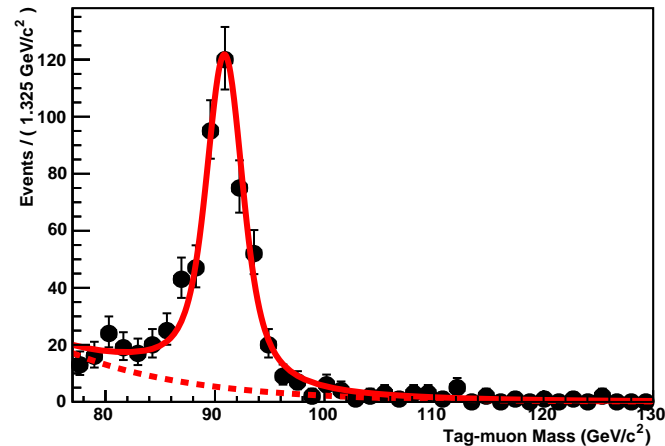
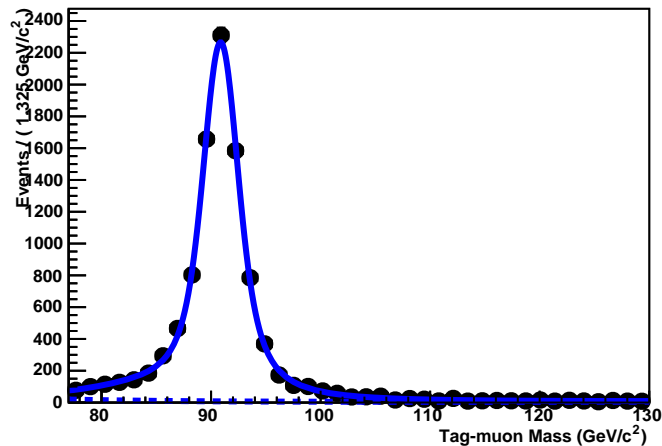


Passing Probes

Failing Probes

All Probes


effBkg = 0.5 ± 0.1
 efficiency = 0.948 ± 0.003
 fSigAll = 0.972 ± 0.006
 lf = -0.089 ± 0.01
 lp = 0.02 ± 0.03
 mean1 = 90.88 ± 0.03
 mean2 = 85 ± 1
 numTot = 9875 ± 99
 sigma1 = 1.03 ± 0.05
 sigma2 = 5.6 ± 0.9
 vFrac = 0.92 ± 0.02