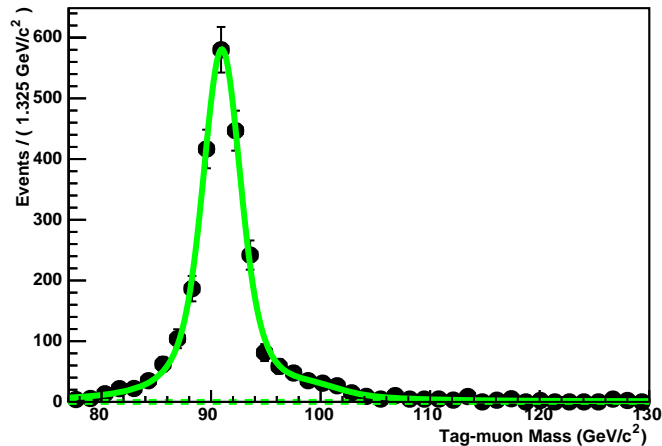
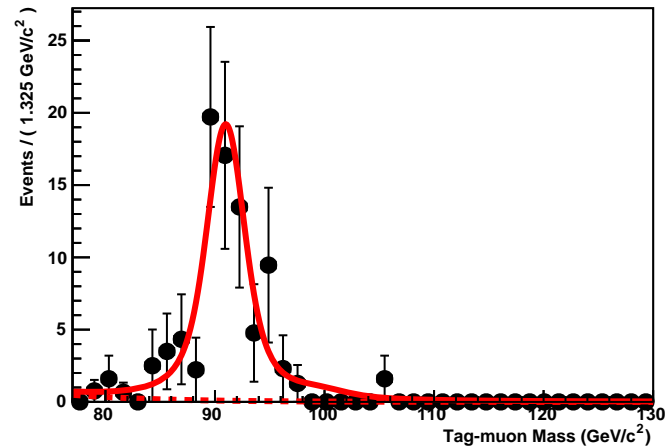
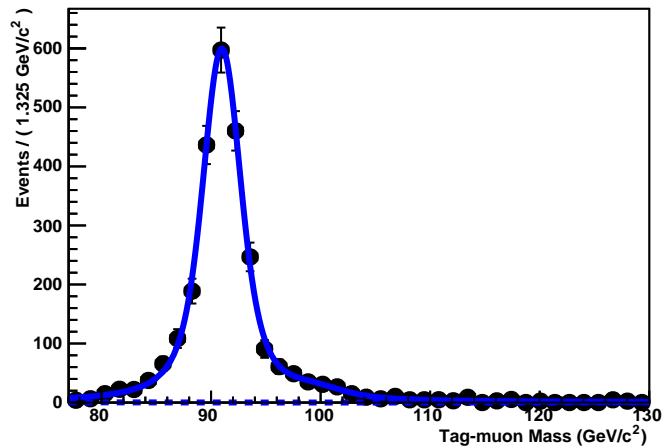


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.4 ± 0.5
 efficiency = 0.968 ± 0.004
 fSigAll = 1.00 ± 0.07
 lf = -0.13 ± 0.1
 lp = 0.1 ± 0.9
 mean1 = 90.98 ± 0.05
 mean2 = 99.4 ± 0.9
 numTot = 2587 ± 47
 sigma1 = 1.15 ± 0.07
 sigma2 = 2.0 ± 0.6
 vFrac = 0.97 ± 0.01