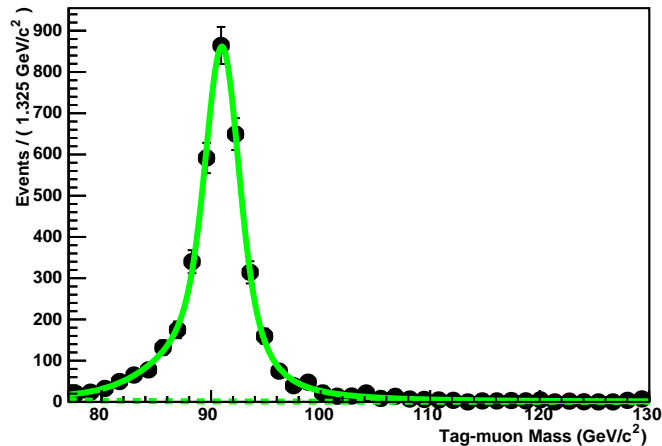
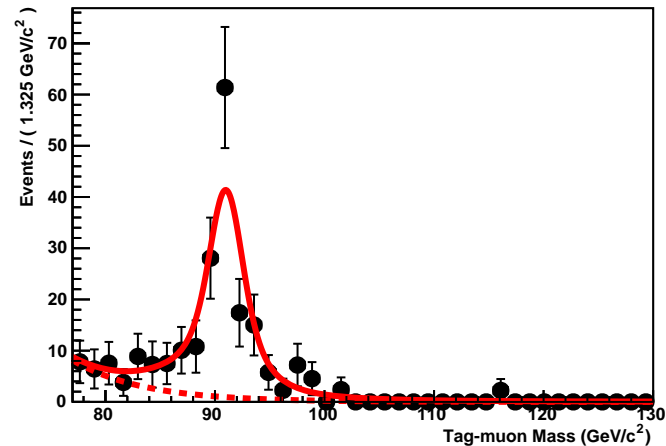
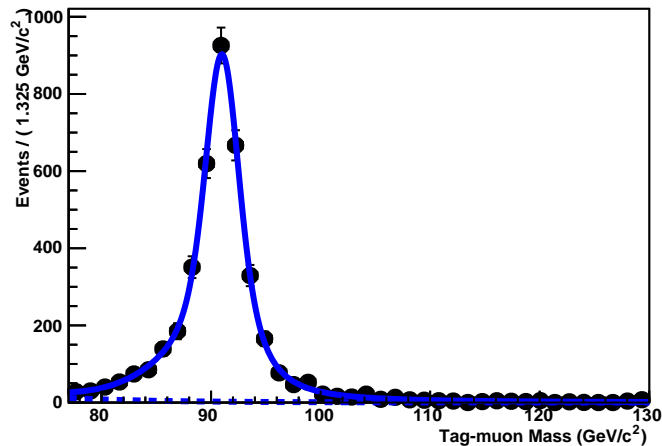


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.5 ± 0.3
 efficiency = 0.955 ± 0.004
 fSigAll = 0.98 ± 0.01
 lf = -0.156 ± 0.06
 lp = -0.076 ± 0.09
 mean1 = 91.02 ± 0.06
 mean2 = 88 ± 1
 numTot = 4016 ± 63
 sigma1 = 1.00 ± 0.07
 sigma2 = 3.7 ± 0.7
 vFrac = 0.84 ± 0.04