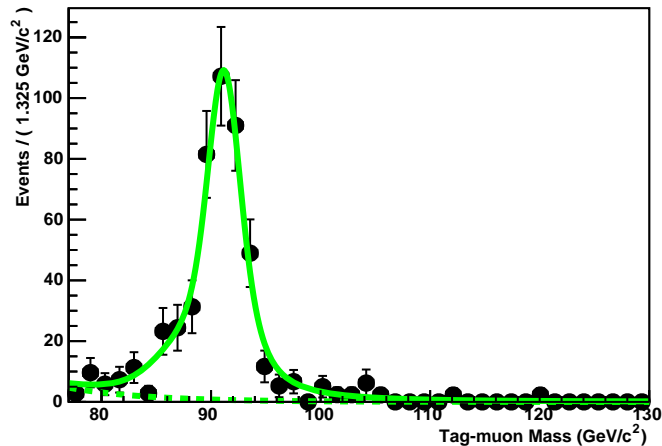
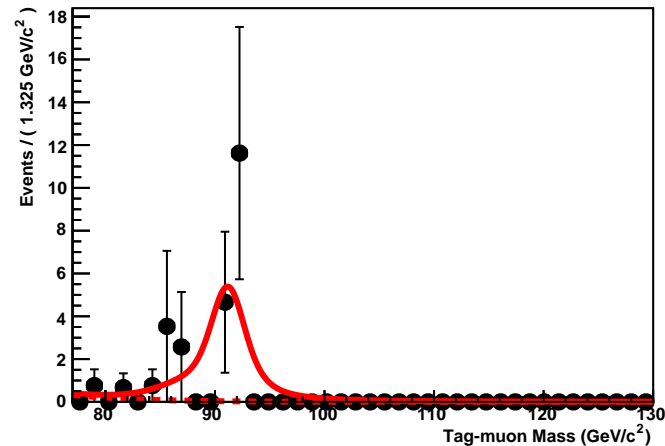
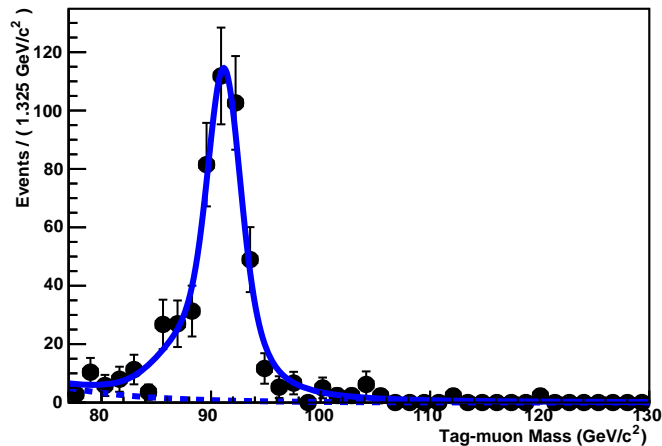


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.95 ± 0.08
 efficiency = 0.95 ± 0.01
 fSigAll = 0.95 ± 0.03
 lf = -0.17 ± 0.2
 lp = -0.137 ± 0.09
 mean1 = 91.2 ± 0.1
 mean2 = 87 ± 1
 numTot = 518 ± 23
 sigma1 = 1.00 ± 0.08
 sigma2 = 2 ± 1
 vFrac = 0.89 ± 0.05