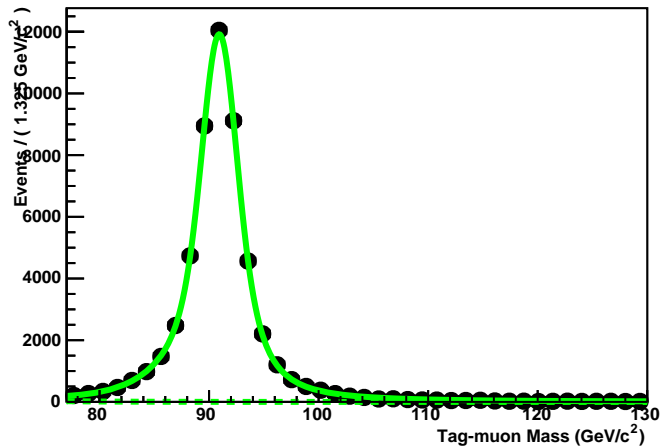
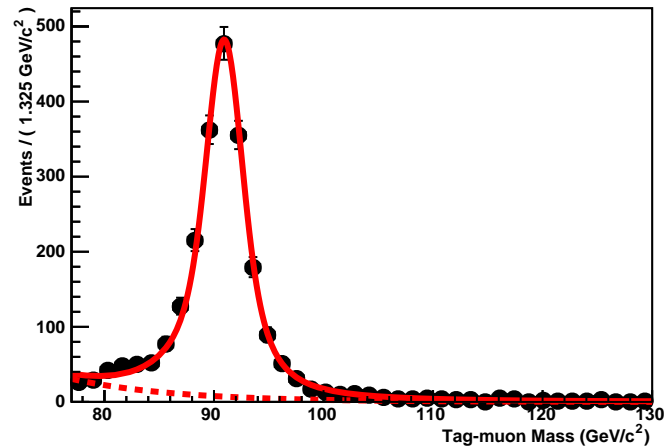
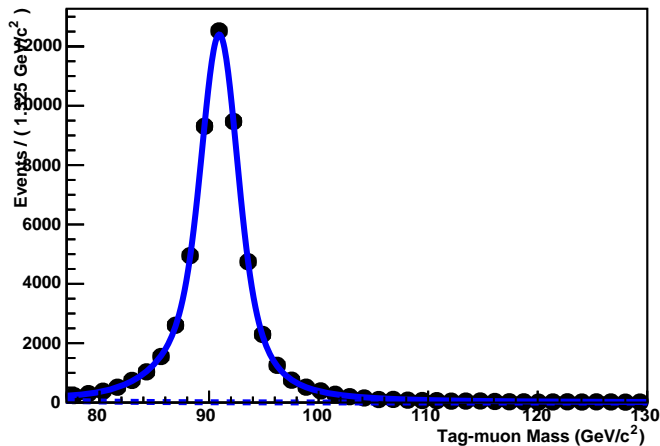


Passing Probes

Failing Probes

All Probes


effBkg = 0.3 ± 0.2
 efficiency = 0.9616 ± 0.0010
 fSigAll = 0.994 ± 0.002
 lf = -0.106 ± 0.02
 lp = -0.21 ± 0.1
 mean1 = 90.95 ± 0.02
 mean2 = 89.1 ± 0.3
 numTot = 55003 ± 235
 sigma1 = 1.12 ± 0.03
 sigma2 = 3.5 ± 0.2
 vFrac = 0.88 ± 0.02