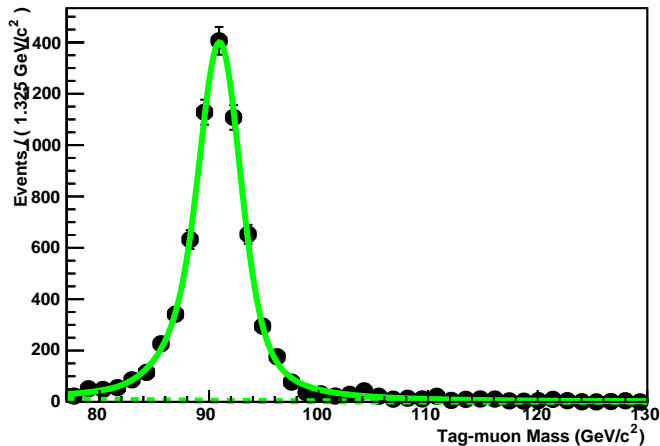
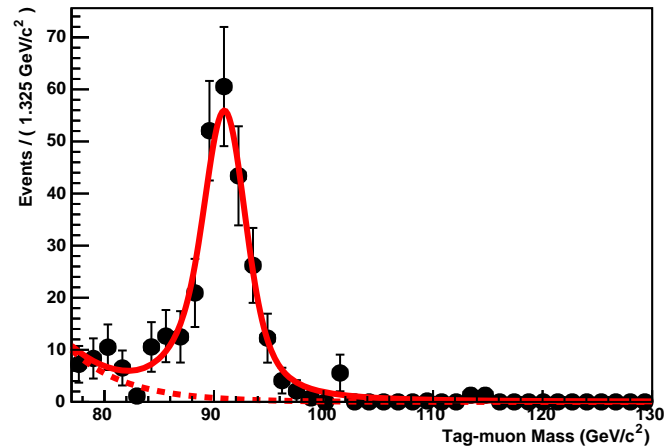
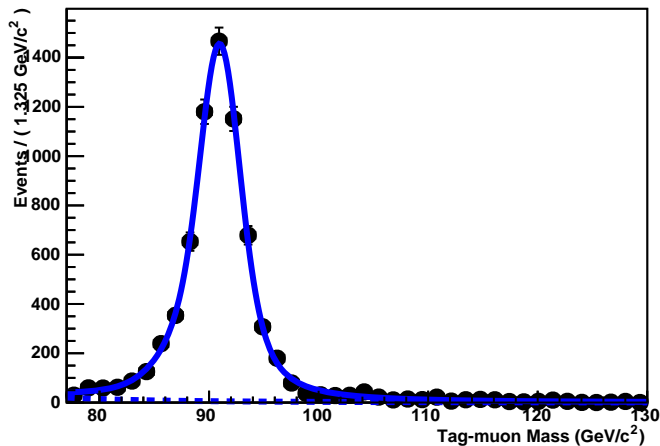


Passing Probes

Failing Probes

All Probes


effBkg = 0.77 ± 0.08
 efficiency = 0.962 ± 0.003
 fSigAll = 0.977 ± 0.006
 lf = -0.198 ± 0.07
 lp = -0.060 ± 0.02
 mean1 = 91.00 ± 0.08
 mean2 = 87 ± 1
 numTot = 7036 ± 84
 sigma1 = 1.35 ± 0.07
 sigma2 = 2.0 ± 0.6
 vFrac = 0.93 ± 0.04