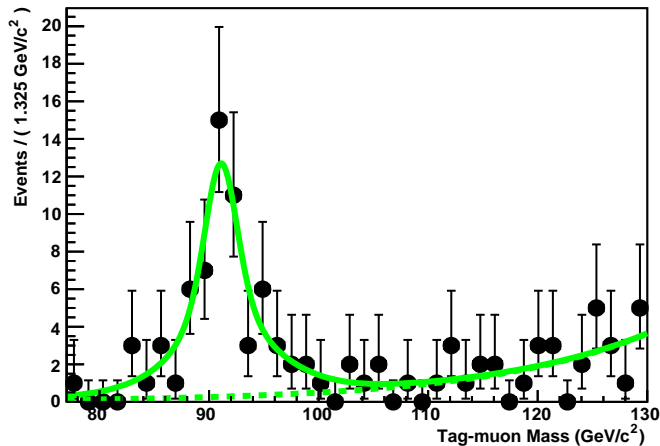
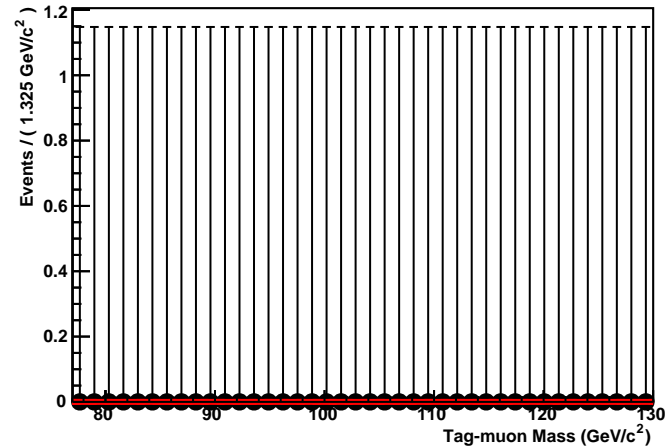
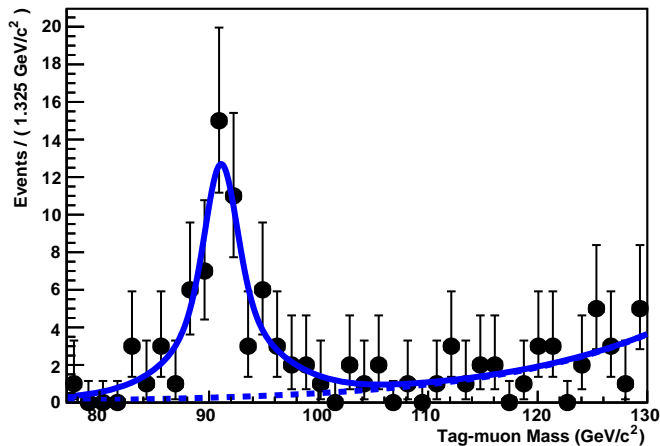


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 1.00 ± 0.01
 efficiency = 1.000 ± 0.008
 fSigAll = 0.61 ± 0.06
 lf = -0.62 ± 0.3
 lp = 0.07 ± 0.02
 mean1 = 91.1 ± 0.4
 mean2 = 92 ± 2
 numTot = 103 ± 10
 sigma1 = 1.0 ± 0.4
 sigma2 = 5 ± 2
 vFrac = 0.6 ± 0.2