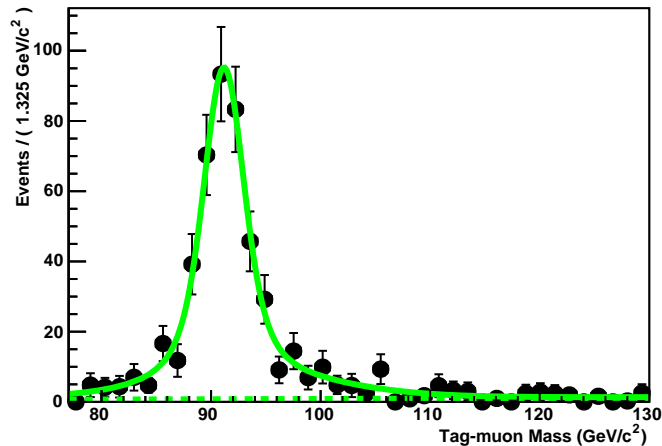
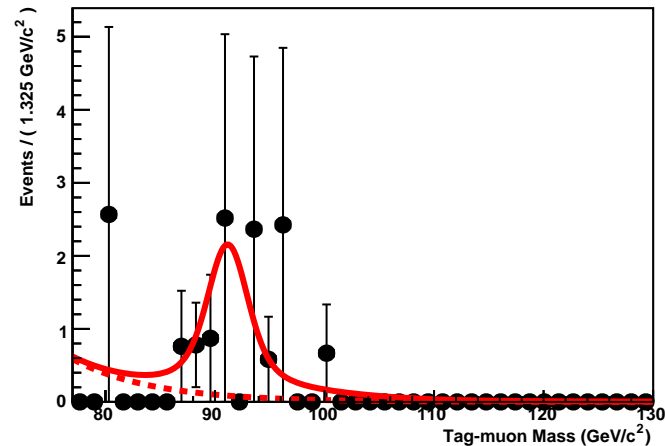
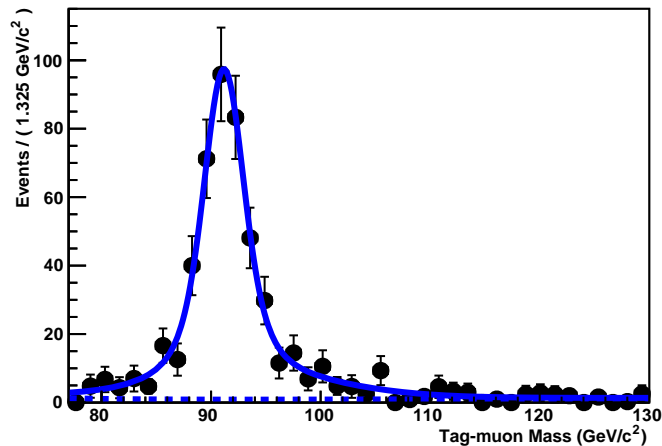


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.92 ± 0.09
 efficiency = 0.979 ± 0.008
 fSigAll = 0.93 ± 0.06
 lf = -0.14 ± 0.1
 lp = 0.01 ± 0.04
 mean1 = 91.2 ± 0.2
 mean2 = 94 ± 3
 numTot = 518 ± 23
 sigma1 = 1.3 ± 0.2
 sigma2 = 7 ± 3
 vFrac = 0.85 ± 0.07