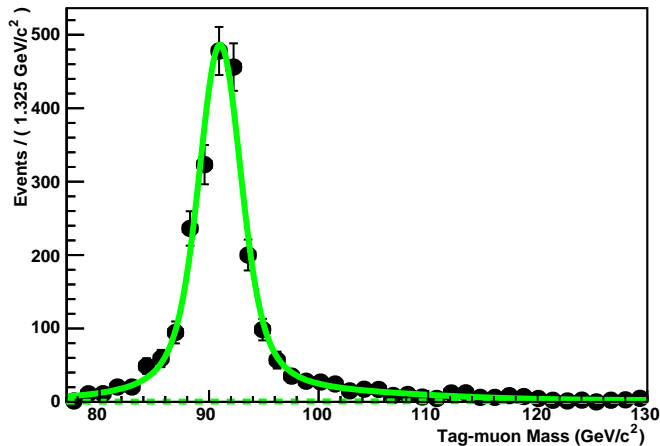
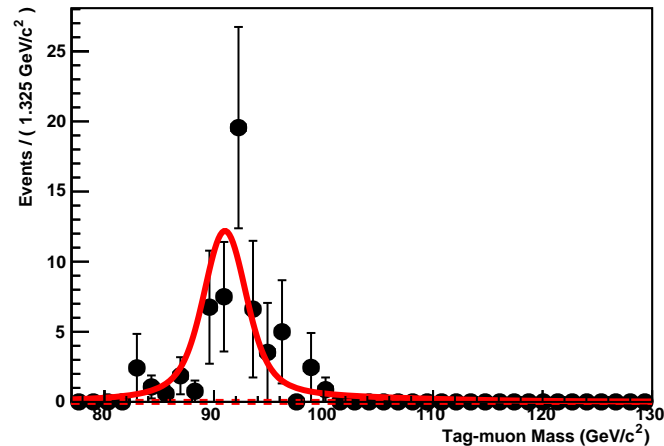
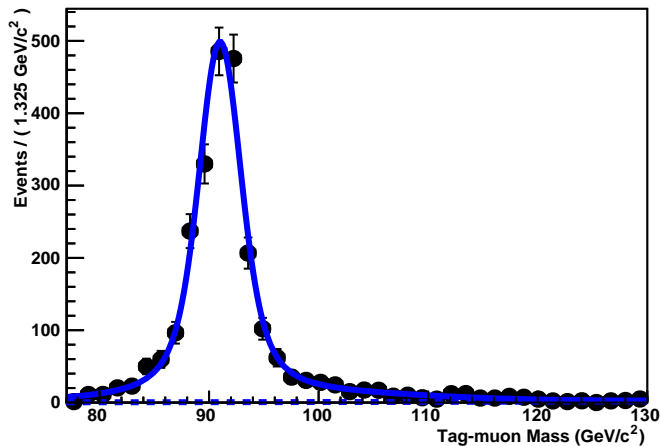


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 1.00 ± 0.02
 efficiency = 0.976 ± 0.003
 fSigAll = 0.99 ± 0.01
 lf = -0.31 ± 0.8
 lp = 0.03 ± 0.06
 mean1 = 91.00 ± 0.06
 mean2 = 100 ± 2
 numTot = 2442 ± 49
 sigma1 = 1.37 ± 0.08
 sigma2 = 10.0 ± 1.0
 vFrac = 0.93 ± 0.02