




Passing Probes

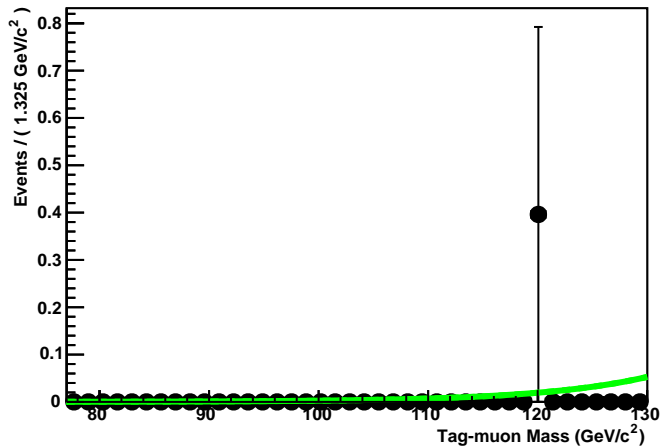

Failing Probes

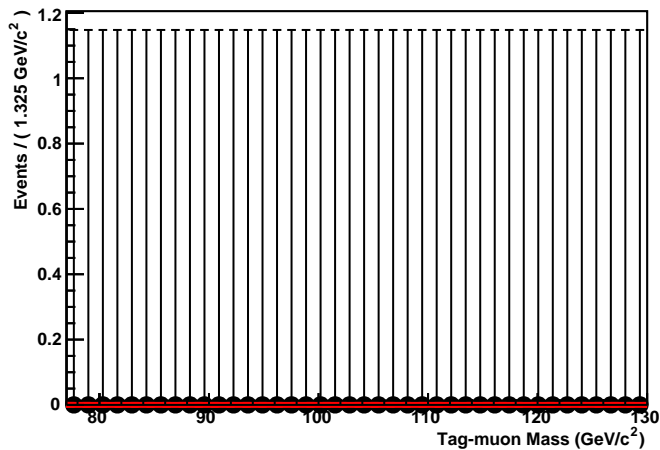

All Probes

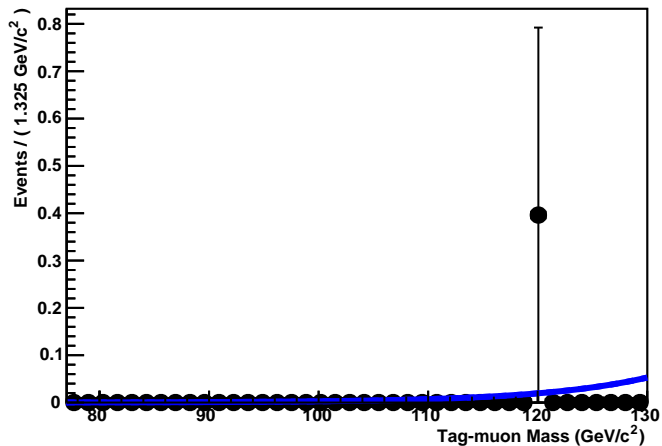

effBkg = 1.0 ± 0.9
efficiency = 1.0 ± 1.0
fSigAll = 0.0 ± 0.9
lf = -0.62 ± 0.3
lp = 0.10 ± 0.07
mean1 = 94 ± 7
mean2 = 94 ± 7
numTot = 0.4 ± 0.6
sigma1 = 1.6 ± 0.8
sigma2 = 6 ± 6
vFrac = 0.6 ± 0.7