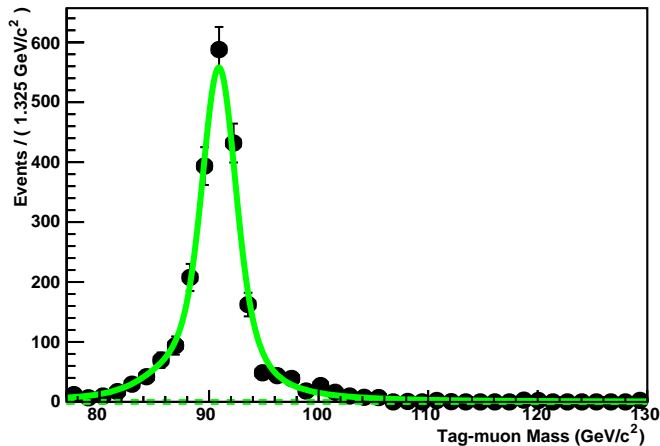
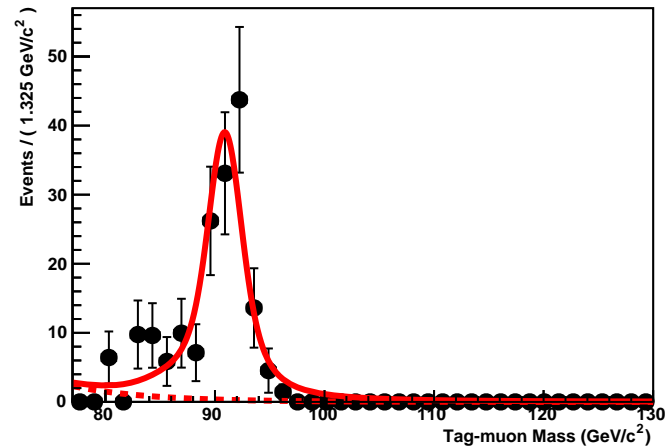
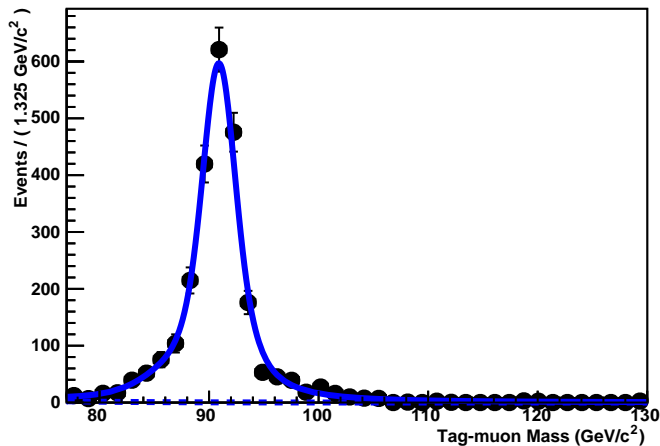


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.00 ± 0.09
 efficiency = 0.935 ± 0.005
 fSigAll = 0.995 ± 0.003
 lf = -0.144 ± 0.05
 lp = 0.0 ± 0.8
 mean1 = 90.91 ± 0.05
 mean2 = 86.0 ± 0.8
 numTot = 2465 ± 50
 sigma1 = 1.00 ± 0.02
 sigma2 = 2.0 ± 0.4
 vFrac = 0.95 ± 0.01