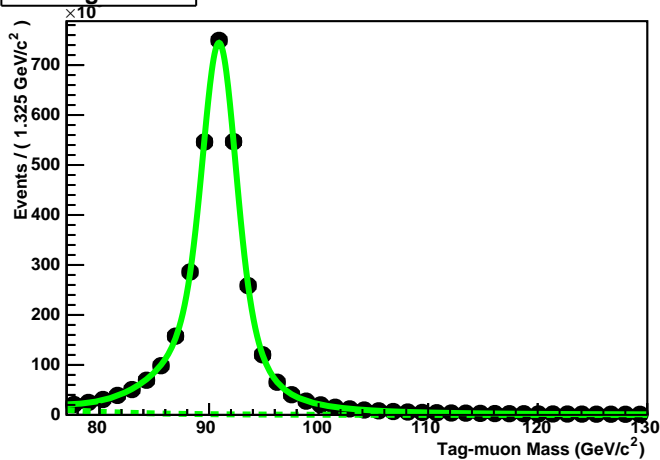
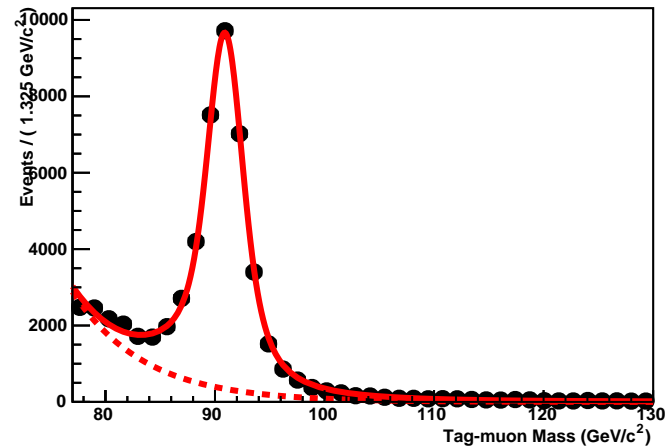
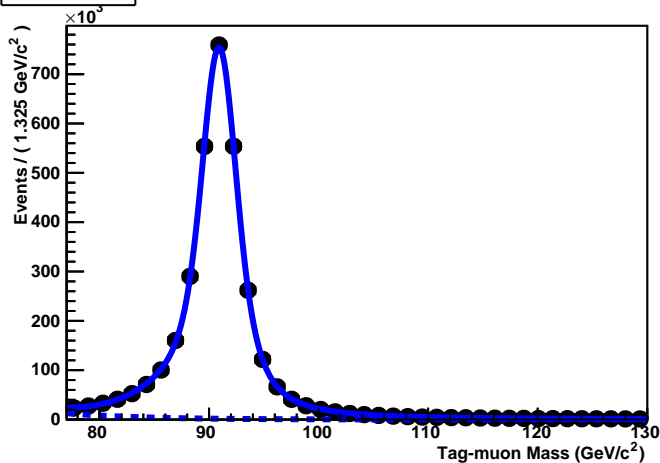


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.781 ± 0.007
 efficiency = 0.98761 ± 0.00008
 fSigAll = 0.9804 ± 0.0006
 lf = -0.1535 ± 0.003
 lp = -0.1480 ± 0.005
 mean1 = 90.930 ± 0.002
 mean2 = 87.49 ± 0.06
 numTot = 3304175 ± 1818
 sigma1 = 1.043 ± 0.003
 sigma2 = 3.38 ± 0.04
 vFrac = 0.893 ± 0.002