




Passing Probes

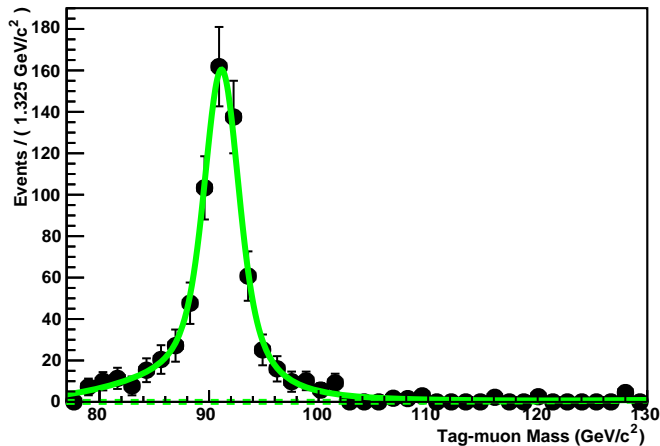

Failing Probes

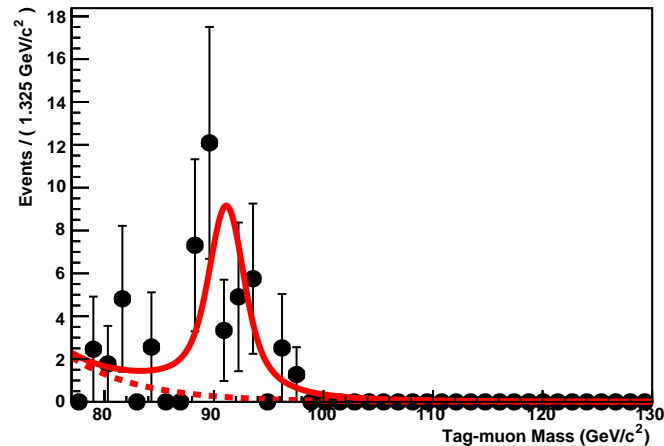

All Probes

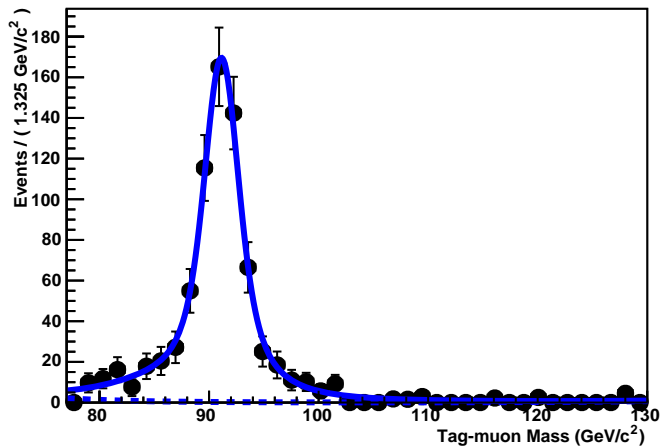

effBkg = 0.3 ± 0.2
 efficiency = 0.947 ± 0.010
 fSigAll = 0.980 ± 0.008
 lf = -0.158 ± 0.07
 lp = 0.10 ± 0.06
 mean1 = 91.1 ± 0.1
 mean2 = 87 ± 2
 numTot = 750 ± 27
 sigma1 = 1.0 ± 0.2
 sigma2 = 5 ± 1
 vFrac = 0.87 ± 0.05