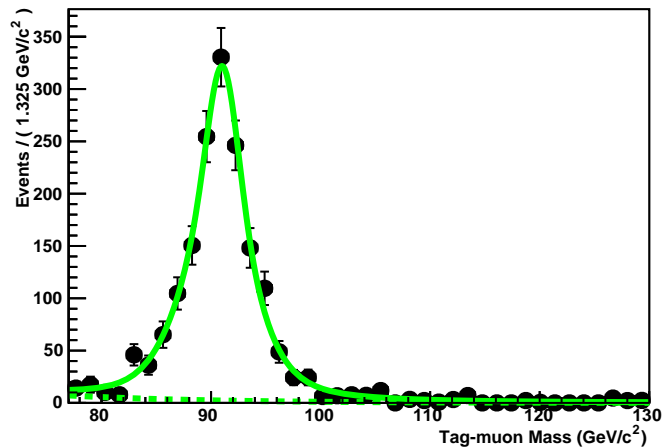
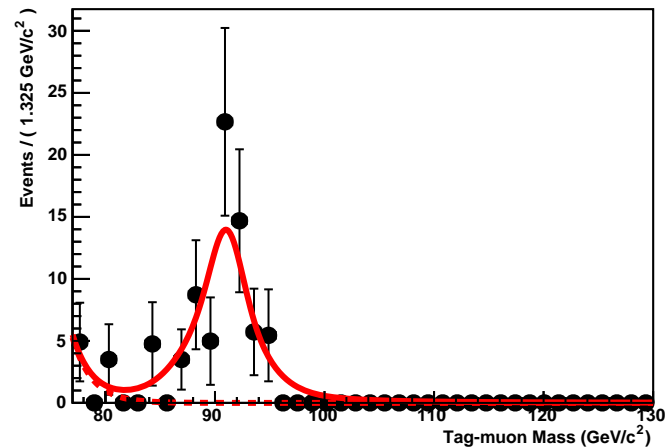
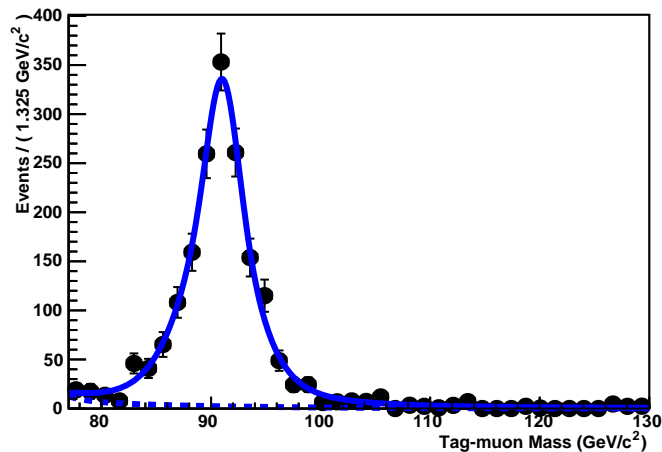


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.90 ± 0.05
 efficiency = 0.958 ± 0.005
 fSigAll = 0.96 ± 0.02
 lf = -0.55 ± 0.3
 lp = -0.082 ± 0.04
 mean1 = 91.1 ± 0.2
 mean2 = 90.4 ± 0.3
 numTot = 1785 ± 42
 sigma1 = 1.0 ± 0.2
 sigma2 = 2.8 ± 0.3
 vFrac = 0.48 ± 0.08