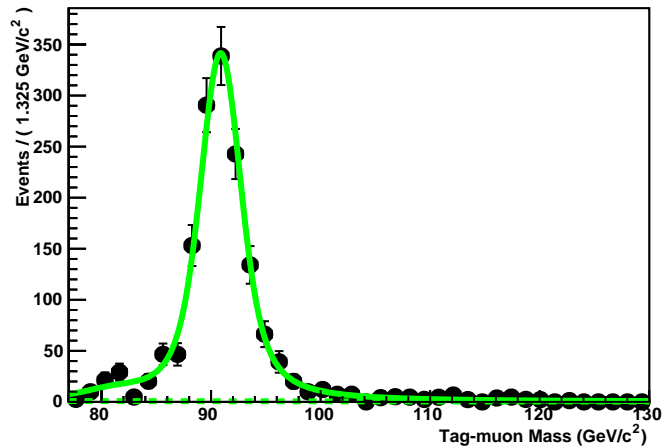
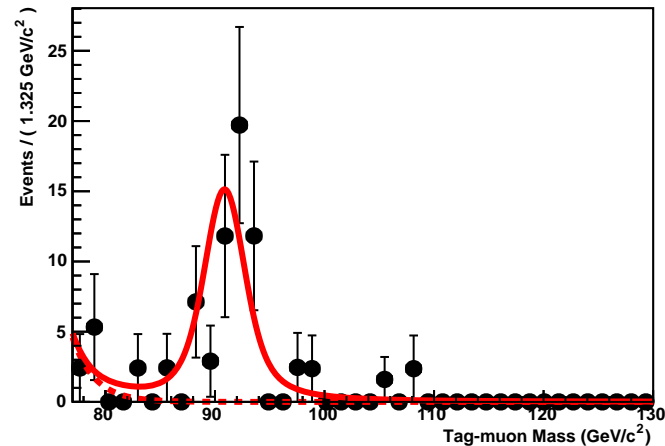
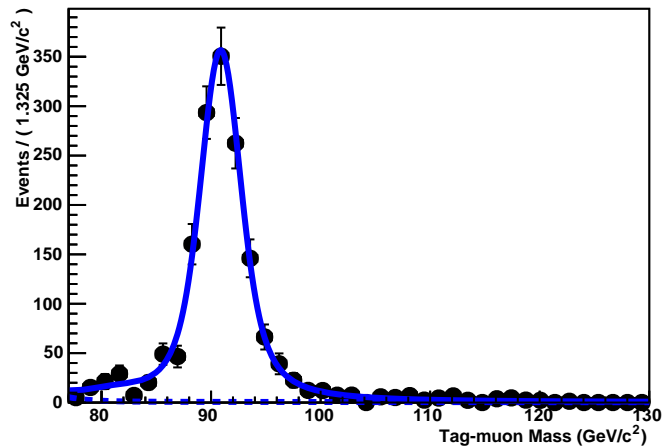


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.8 ± 0.2
 efficiency = 0.957 ± 0.005
 fSigAll = 0.98 ± 0.01
 lf = -0.50 ± 0.3
 lp = -0.019 ± 0.03
 mean1 = 90.88 ± 0.07
 mean2 = 81.0 ± 0.8
 numTot = 1622 ± 40
 sigma1 = 1.27 ± 0.08
 sigma2 = 2.0 ± 0.2
 vFrac = 0.977 ± 0.008