




Passing Probes

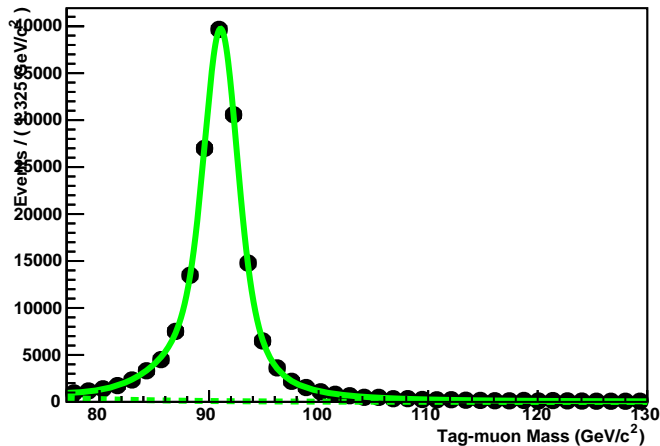

Failing Probes

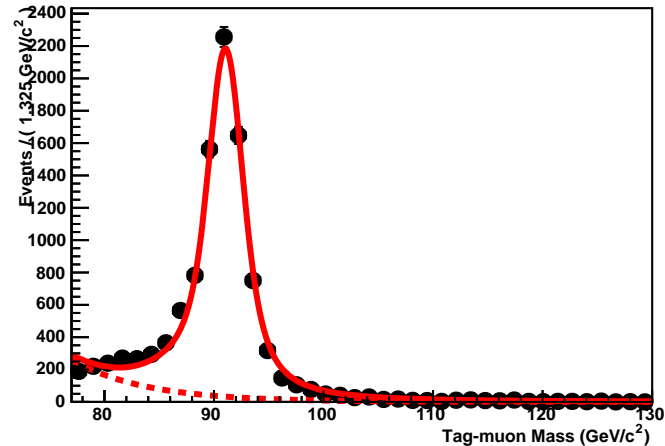

All Probes

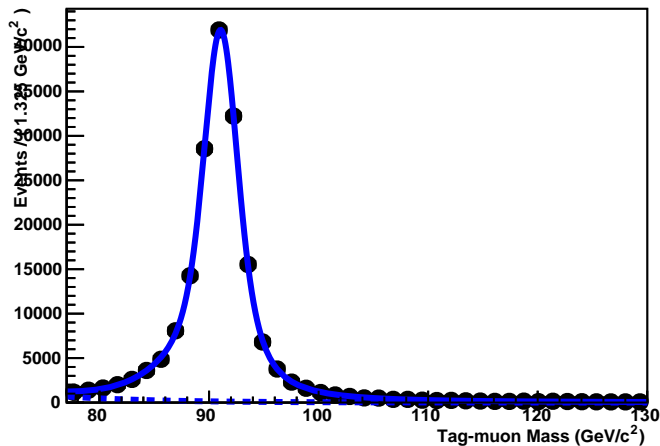

effBkg = 0.68 ± 0.03
 efficiency = 0.9485 ± 0.0006
 fSigAll = 0.977 ± 0.003
 lf = -0.1485 ± 0.008
 lp = -0.115 ± 0.01
 mean1 = 91.07 ± 0.02
 mean2 = 88 ± 1
 numTot = 178953 ± 423
 sigma1 = 1 ± 1
 sigma2 = 3.1 ± 0.2
 vFrac = 0.91 ± 0.03