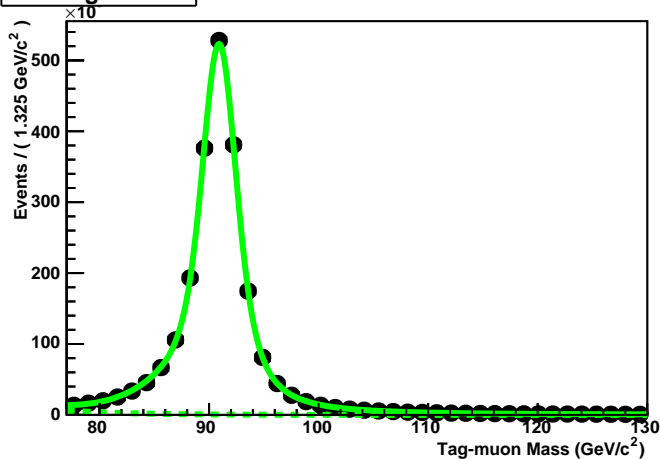
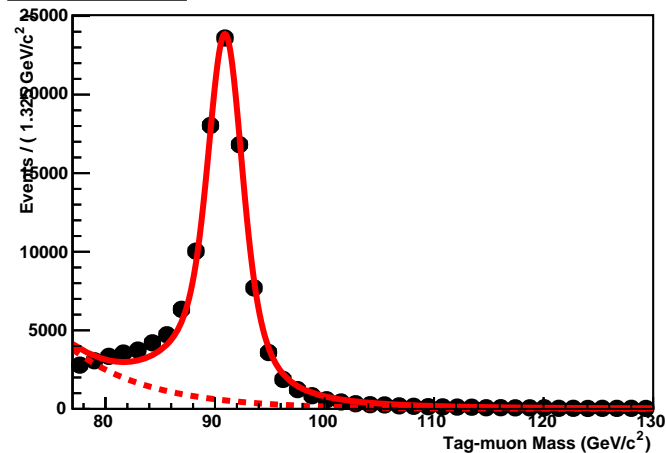
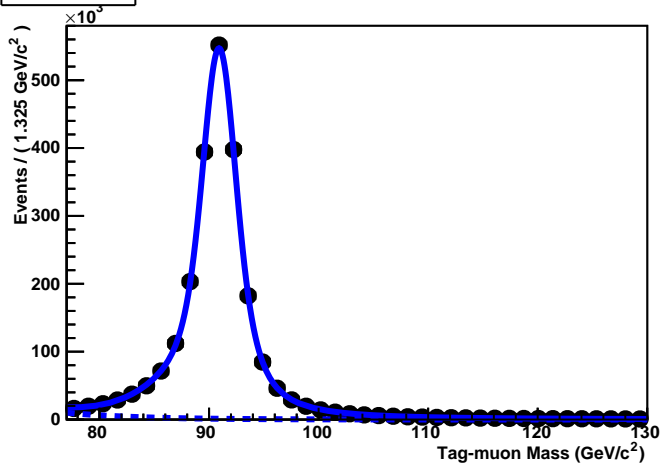


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.57 ± 0.01
 efficiency = 0.9573 ± 0.0002
 fSigAll = 0.9796 ± 0.0006
 lf = -0.1400 ± 0.002
 lp = -0.1722 ± 0.008
 mean1 = 90.935 ± 0.002
 mean2 = 87.37 ± 0.06
 numTot = 2349997 ± 1533
 sigma1 = 1.00000 ± 0.00008
 sigma2 = 3.18 ± 0.04
 vFrac = 0.900 ± 0.002