




Passing Probes

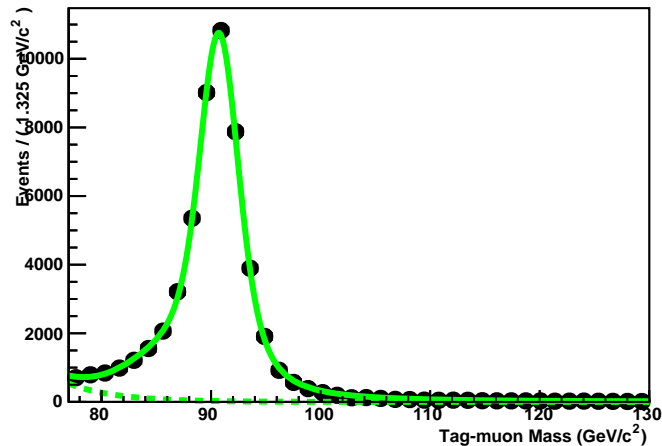

Failing Probes

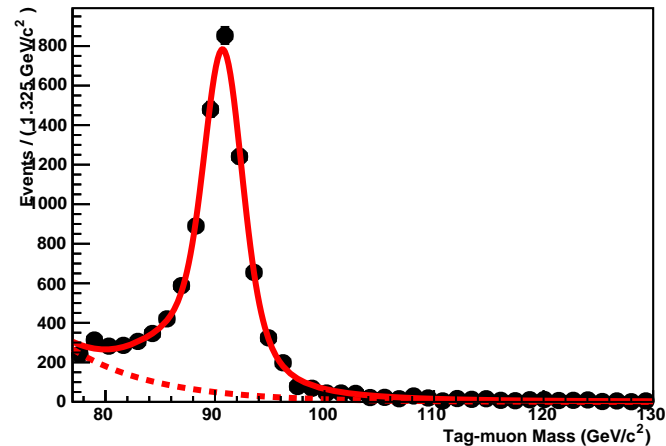

All Probes

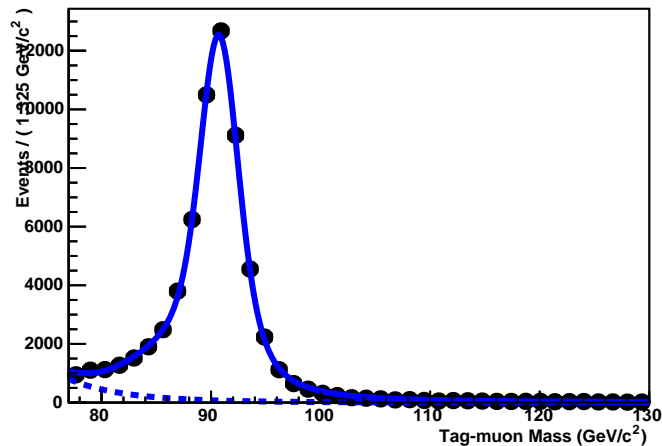

effBkg = 0.53 ± 0.03
efficiency = 0.861 ± 0.002
fSigAll = 0.948 ± 0.005
lf = -0.1296 ± 0.008
lp = -0.229 ± 0.02
mean1 = 90.74 ± 0.02
mean2 = 86.1 ± 0.3
numTot = 63494 ± 252
sigma1 = 1.24 ± 0.02
sigma2 = 3.4 ± 0.2
vFrac = 0.85 ± 0.01