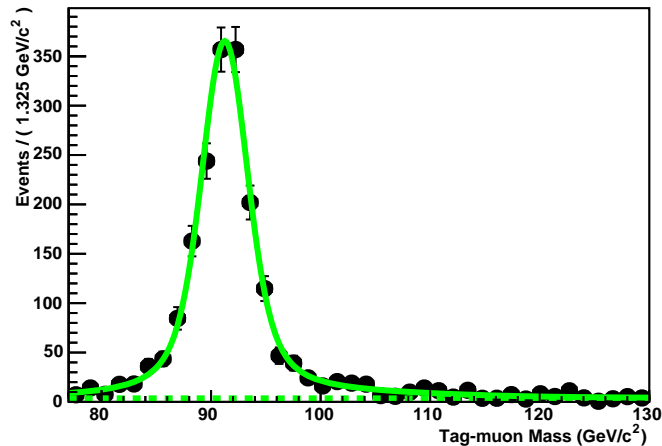
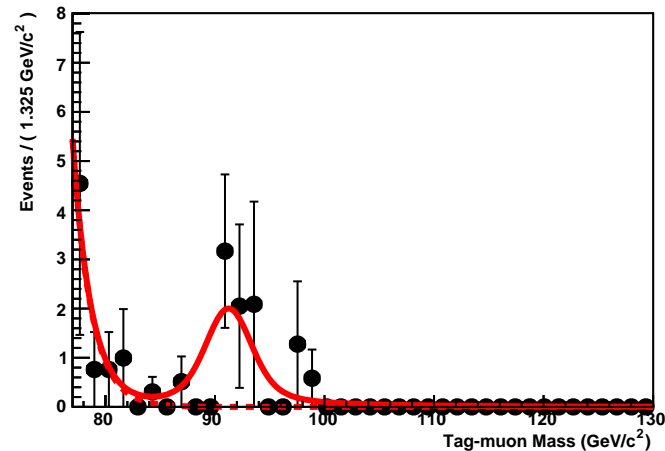
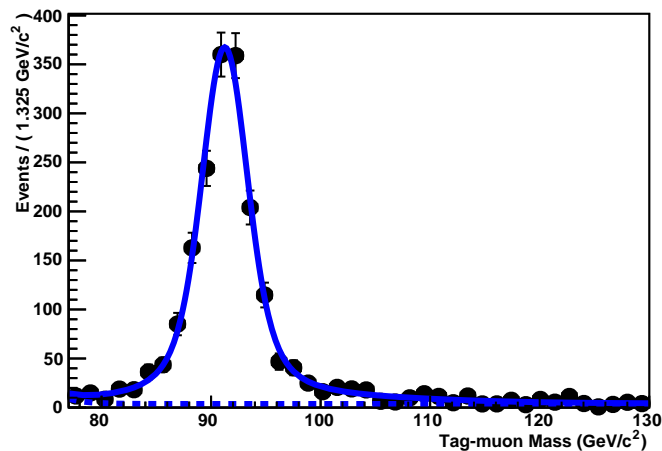


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.95 ± 0.02
 efficiency = 0.995 ± 0.002
 fSigAll = 0.92 ± 0.02
 lf = -0.59 ± 0.3
 lp = -0.000 ± 0.02
 mean1 = 91.25 ± 0.07
 mean2 = 99 ± 20
 numTot = 1991 ± 45
 sigma1 = 1.56 ± 0.10
 sigma2 = 10 ± 7
 vFrac = 0.95 ± 0.03