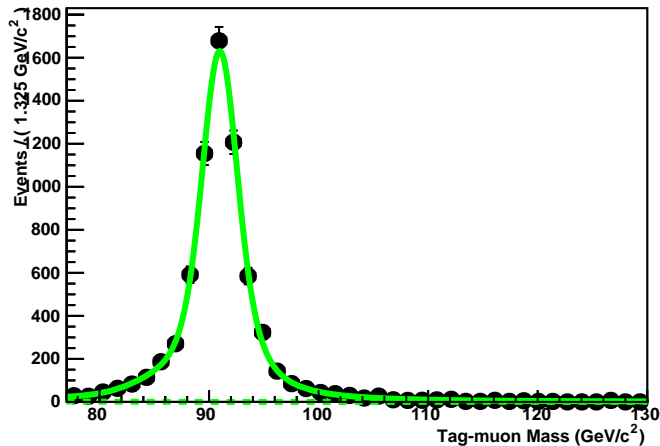
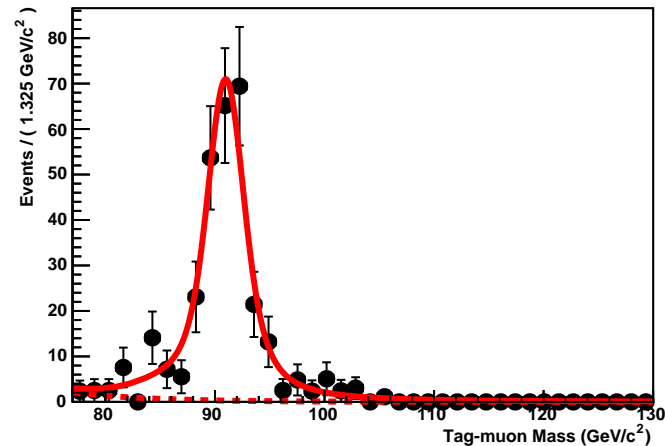
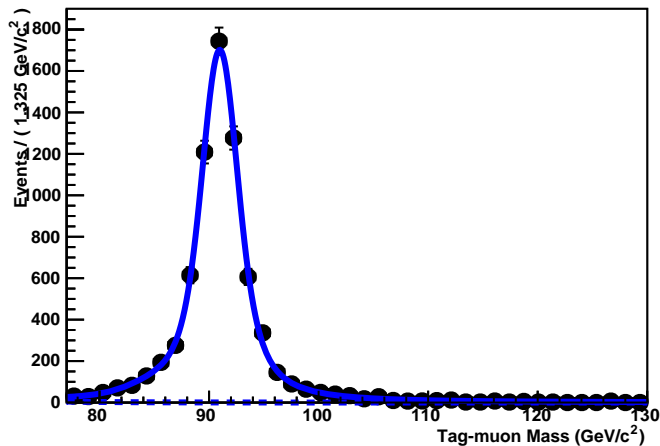


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.5 ± 0.6
 efficiency = 0.958 ± 0.002
 fSigAll = 1.00 ± 0.03
 lf = -0.142 ± 0.07
 lp = -0.22 ± 0.7
 mean1 = 90.98 ± 0.03
 mean2 = 85 ± 2
 numTot = 7192 ± 72
 sigma1 = 1.10 ± 0.04
 sigma2 = 2 ± 8
 vFrac = 0.97 ± 0.02