




Passing Probes

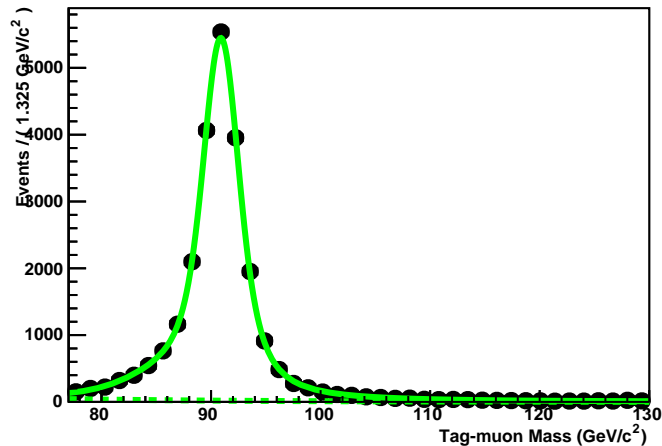

Failing Probes

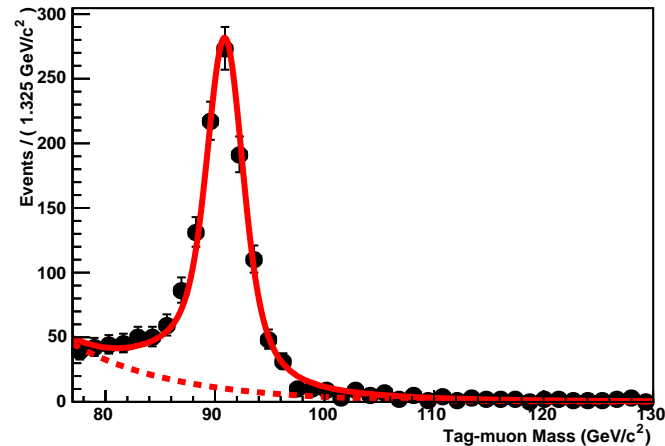

All Probes

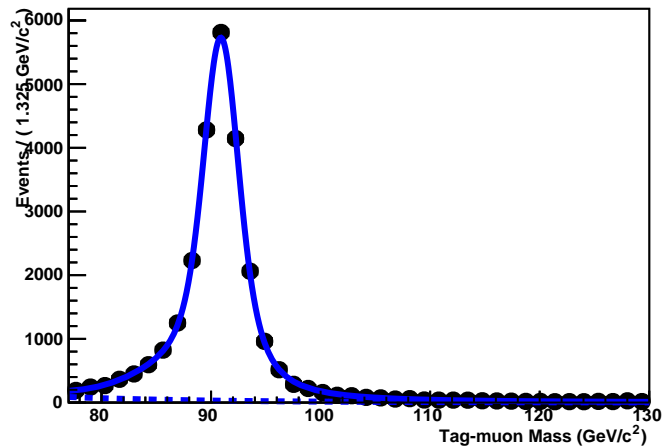

effBkg = 0.6 ± 0.1
 efficiency = 0.952 ± 0.002
 fSigAll = 0.968 ± 0.010
 lf = -0.106 ± 0.01
 lp = -0.060 ± 0.02
 mean1 = 90.91 ± 0.02
 mean2 = 86.6 ± 0.7
 numTot = 25718 ± 160
 sigma1 = 1.07 ± 0.03
 sigma2 = 3.5 ± 0.6
 vFrac = 0.90 ± 0.02