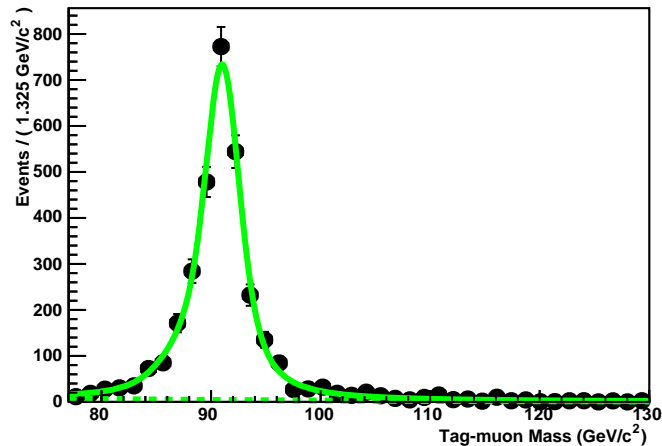
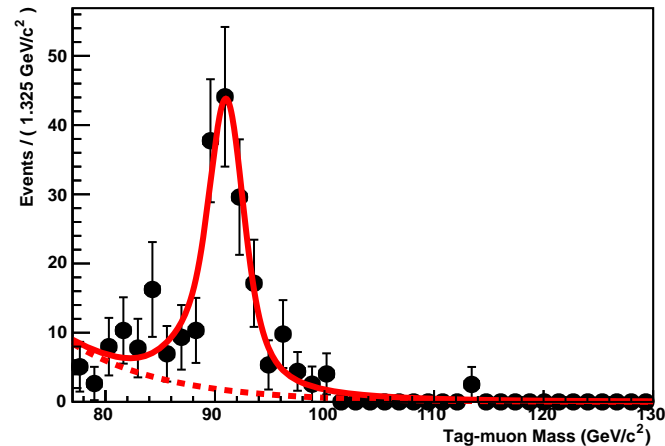
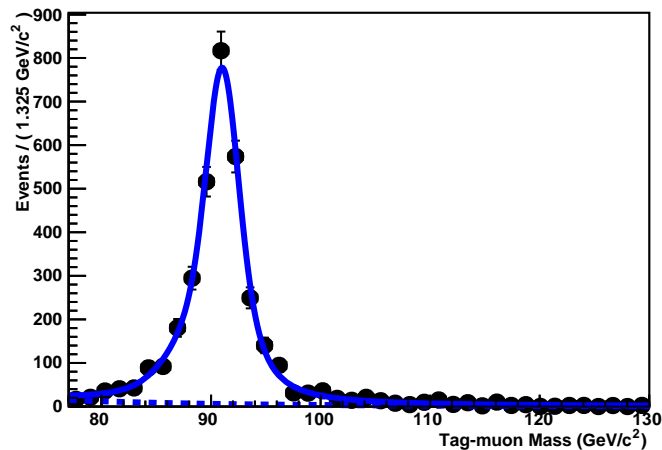


Passing Probes

Failing Probes

All Probes


effBkg = 0.68 ± 0.07
 efficiency = 0.945 ± 0.005
 fSigAll = 0.95 ± 0.01
 lf = -0.115 ± 0.02
 lp = -0.037 ± 0.01
 mean1 = 91.05 ± 0.06
 mean2 = 88 ± 1
 numTot = 3449 ± 59
 sigma1 = 1.00 ± 0.04
 sigma2 = 2 ± 1
 vFrac = 0.89 ± 0.05