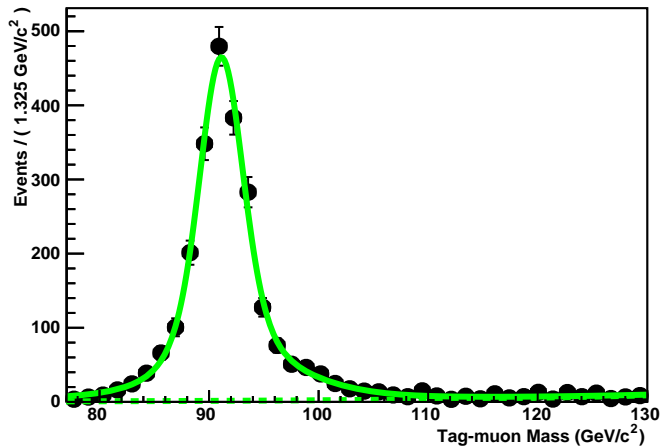
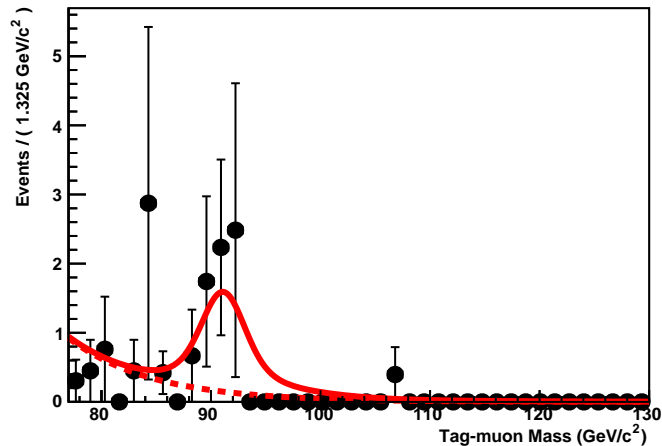
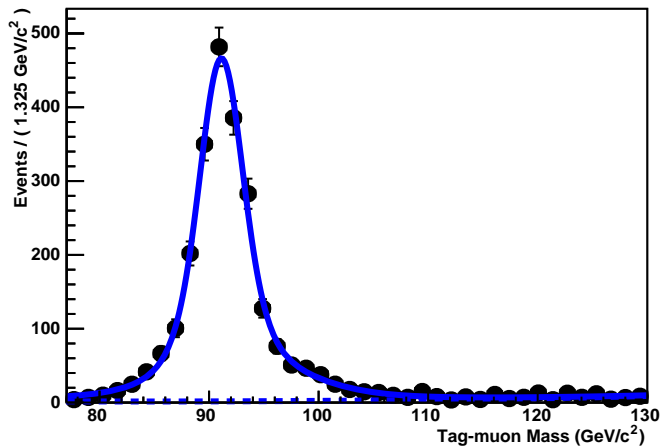


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.96 ± 0.02
 efficiency = 0.997 ± 0.001
 fSigAll = 0.95 ± 0.01
 lf = -0.130 ± 0.07
 lp = 0.05 ± 0.02
 mean1 = 91.11 ± 0.07
 mean2 = 95 ± 2
 numTot = 2528 ± 50
 sigma1 = 1.5 ± 0.1
 sigma2 = 5.1 ± 0.8
 vFrac = 0.89 ± 0.04