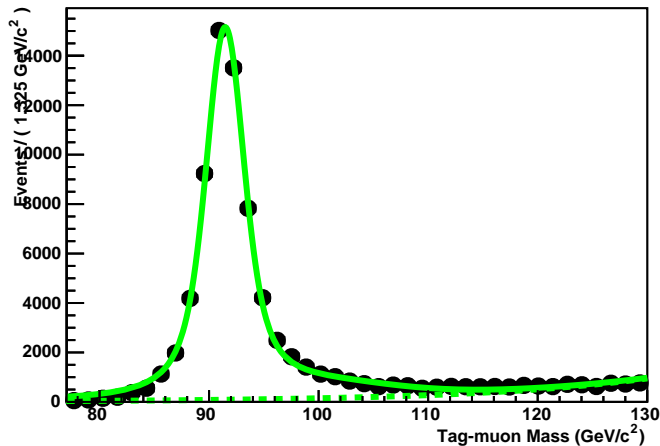
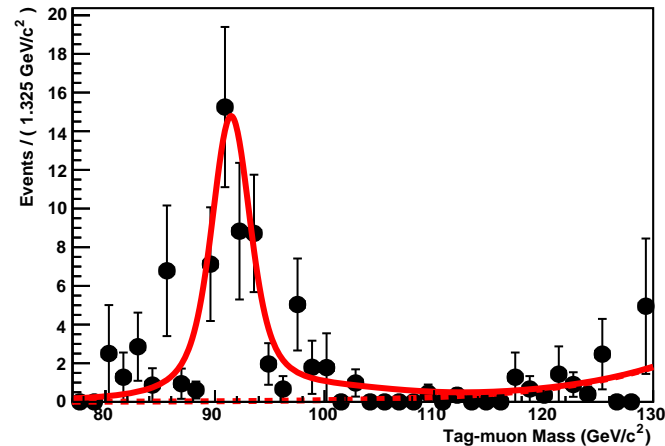
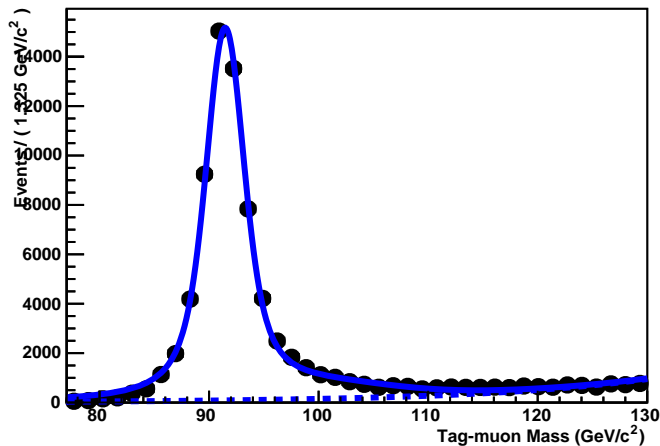


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.9988 ± 0.0004
 efficiency = 0.9990 ± 0.0001
 fSigAll = 0.862 ± 0.003
 lf = 0.10 ± 0.02
 lp = 0.062 ± 0.002
 mean1 = 91.46 ± 0.01
 mean2 = 100.00 ± 0.05
 numTot = 80408 ± 284
 sigma1 = 1.15 ± 0.01
 sigma2 = 6.3 ± 0.2
 vFrac = 0.896 ± 0.004