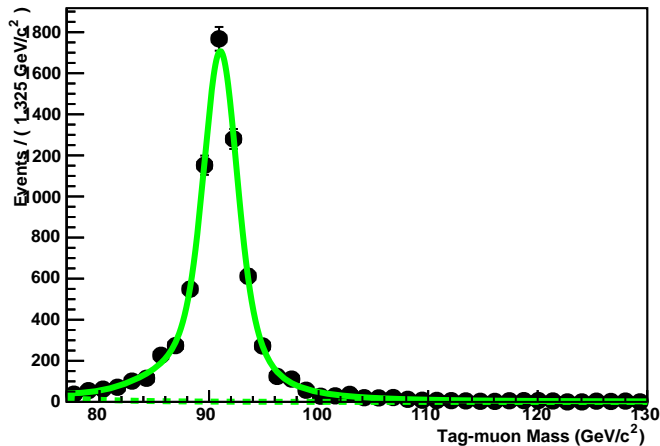
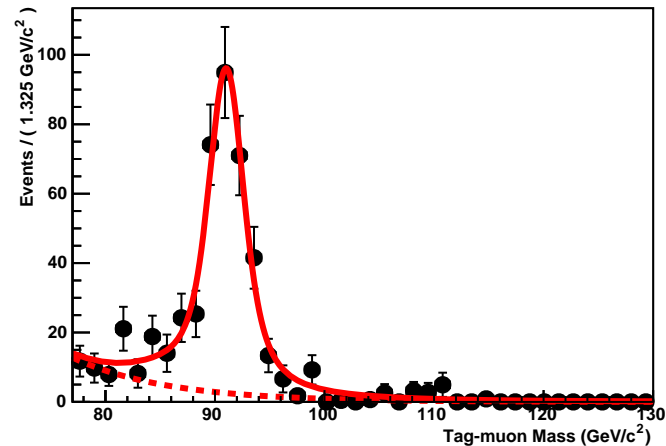
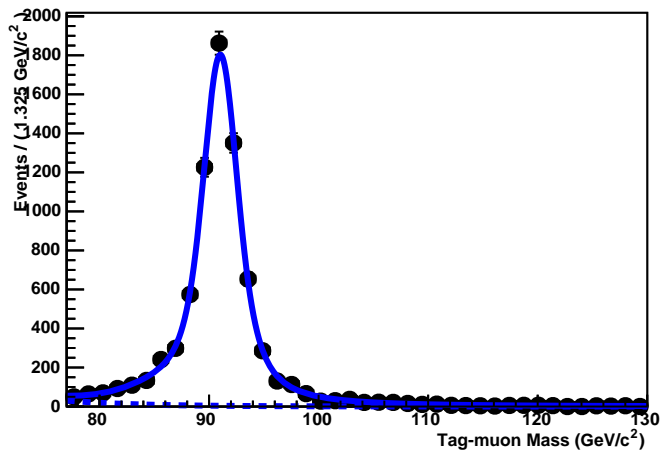


Passing Probes**Failing Probes****All Probes**

effBkg = 0.5 ± 0.2
 efficiency = 0.948 ± 0.003
 fSigAll = 0.98 ± 0.01
 lf = -0.115 ± 0.02
 lp = -0.19 ± 0.1
 mean1 = 91.04 ± 0.03
 mean2 = 86 ± 1
 numTot = 7569 ± 87
 sigma1 = 1.00 ± 0.02
 sigma2 = 3 ± 1
 vFrac = 0.95 ± 0.02