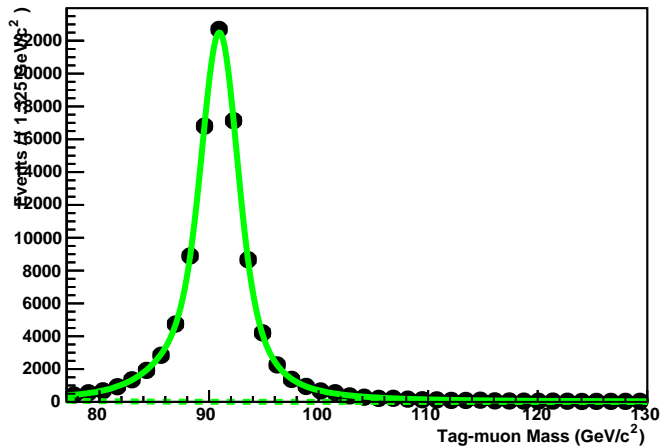
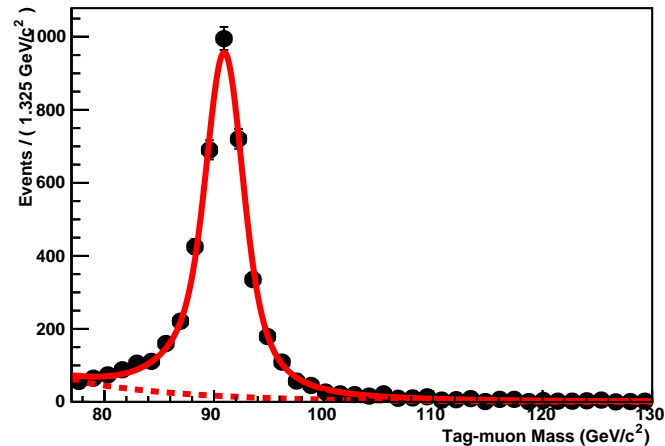
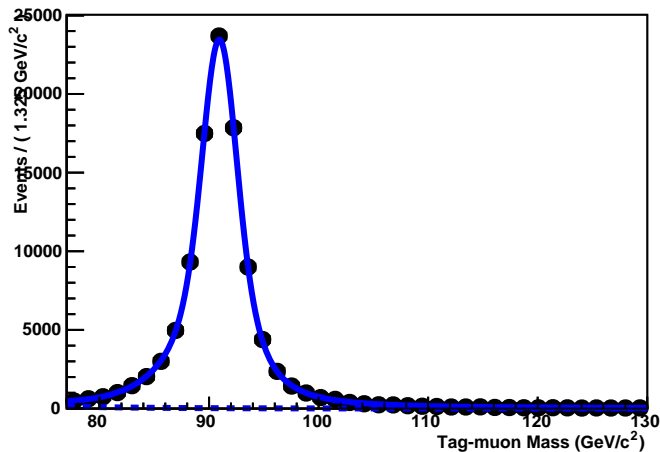


Passing Probes

Failing Probes

All Probes


effBkg = 0.4 ± 0.1
 efficiency = 0.9598 ± 0.0007
 fSigAll = 0.992 ± 0.001
 lf = -0.0962 ± 0.009
 lp = -0.186 ± 0.06
 mean1 = 90.96 ± 0.01
 mean2 = 89.1 ± 0.2
 numTot = 104513 ± 323
 sigma1 = 1.11 ± 0.02
 sigma2 = 3.5 ± 0.2
 vFrac = 0.87 ± 0.01