



OMI TOTAL FULL-AUTOMATIC DRYER SYSTEM TFD

穀類サンプルの自主検査工程を効率化 **米・麦・大豆 3品目兼用**

省スペース



ACCESS

名神高速道路「栗東IC」「瀬田西IC」より15分
京滋バイパス「瀬田東IC」より10分
新名神高速道路「草津田上IC」より10分

JR琵琶湖線「南草津駅」
東口より徒歩25分



フルオートドライヤーシステム

業界初のサンプル全自動自主検査装置※が、
さらなる高効率化を実現してフルモデルチェンジ！

これまでに200台以上の穀類フルオートドライヤーを納入してきたノウハウを結集し、現代のプラント設備に求められる性能を高い次元で実現した新型システムです。

※ 近江度量衡が1986年に開発・発売した検査装置

FEATURE 特長

- 01 省人化**

搬送・乾燥・検査の
全工程を
オートメーション化
- 02 省エネ**

乾燥性能をおとさず
消費電力を
約72%削減
- 03 省スペース**

設置面積を
約64%削減した
コンパクトなサイズ
- 04**

米・麦・大豆の
3品目兼用可能
- 05**

更新時の建築工事を
縮小してトータルコスト削減


DETAILS 機器詳細

ドライヤー本体 CFD-120

- ① サンプル投入口
- ② メンテナンス用扉セーフティドアスイッチ
(前面4カ所、後面1カ所)
- ③ ドライヤー操作部
(正面のフックにも移動可能)
- ④ ドライヤー盤
- ⑤ 排気ダクト
- ⑥ 搬入用キャスター




◀ **集中盤**
(専用タッチパネル操作盤)
検査結果を含む全情報を集約

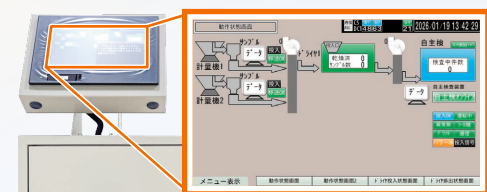

FLOW 工程

フルオートドライヤーシステム

近江度量衡では、共同乾燥調製施設の
荷受・サンプル検査・出荷の計量に係る
重要な部分を担っています。本システム
は、サンプル検査に係るサンプル搬送・
乾燥・検査までをワンストップで行い
ます。

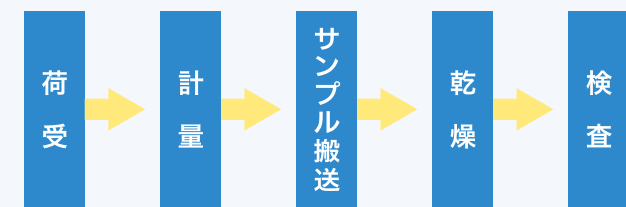

内部機構

A 搬送部




電磁吸着式アーム
高速且つ精密にサンプルを
搬送し格納します。



静電容量式水分計
サンプルを破壊せず、
高精度の水分検査を行います。




防塵仕様
機械内部の配線は全て
防塵仕様となっています。

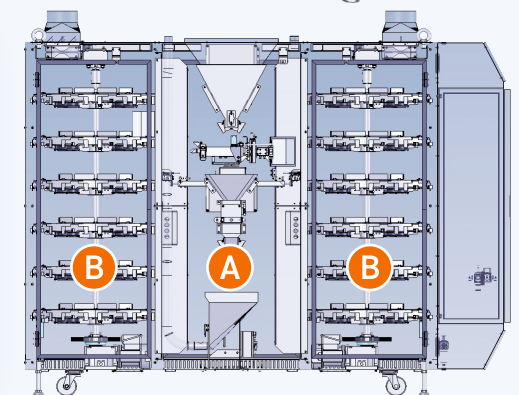

B サンプルボックス

サンプルボックスの底面はメッシュ機構になっており、下からの熱風で
サンプルを乾燥させます。電磁吸着式4軸アームによりサンプルが
投入されるとファンゲートが開き、乾燥を終えると自動的に閉まり
ます。各テーブルの上下2箇所に搭載されたヒーターで、室内の温度
を適切に管理します。

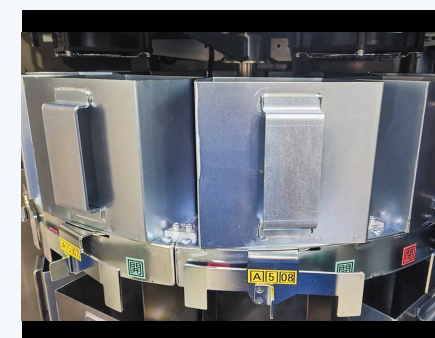


▲ 回転式の乾燥ケース一目で開閉が分かるシャッター付



開いた状態



閉じた状態

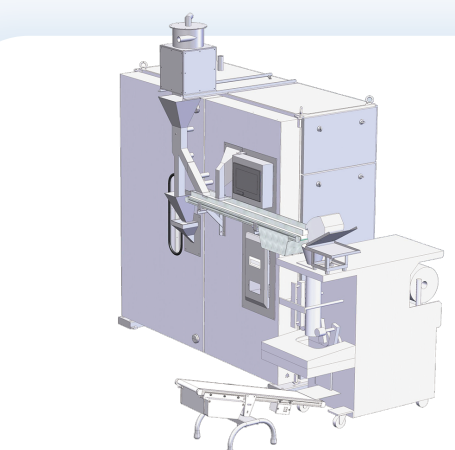

オートチェッカー

ドライヤーで乾燥されたサンプルが搬送され、自動検査
を行います。粉摺り・選別の後、選別結果ごとにシール
バックされます。オプションで、大豆用転選機仕様や品
位計、食味計といった分析装置との自動連動も可能です。