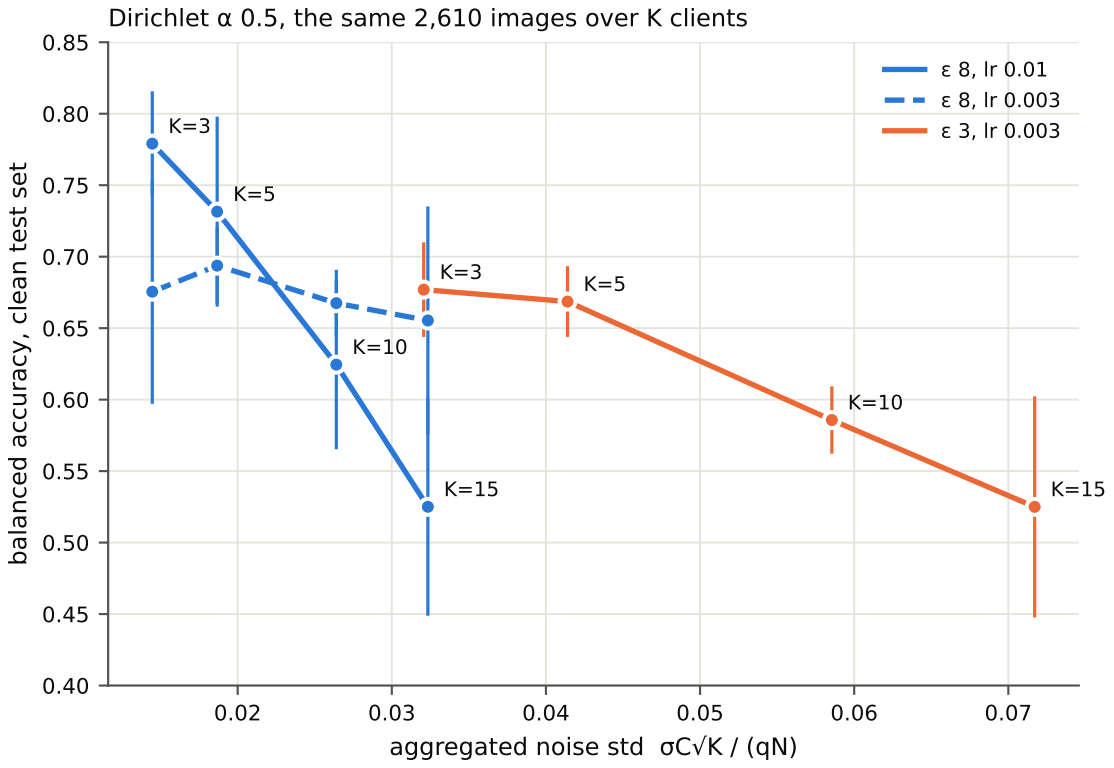
Dirichlet α 0.5, the same 2,610 images over K clients
ε 8, lr 0.01
ε 8, lr 0.003
ε 3, lr 0.003
K=3
K=5
K=10
K=15
K=3
K=5
K=10
K=15
balanced accuracy, clean test set
aggregated noise std σC√K / (qN)
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07