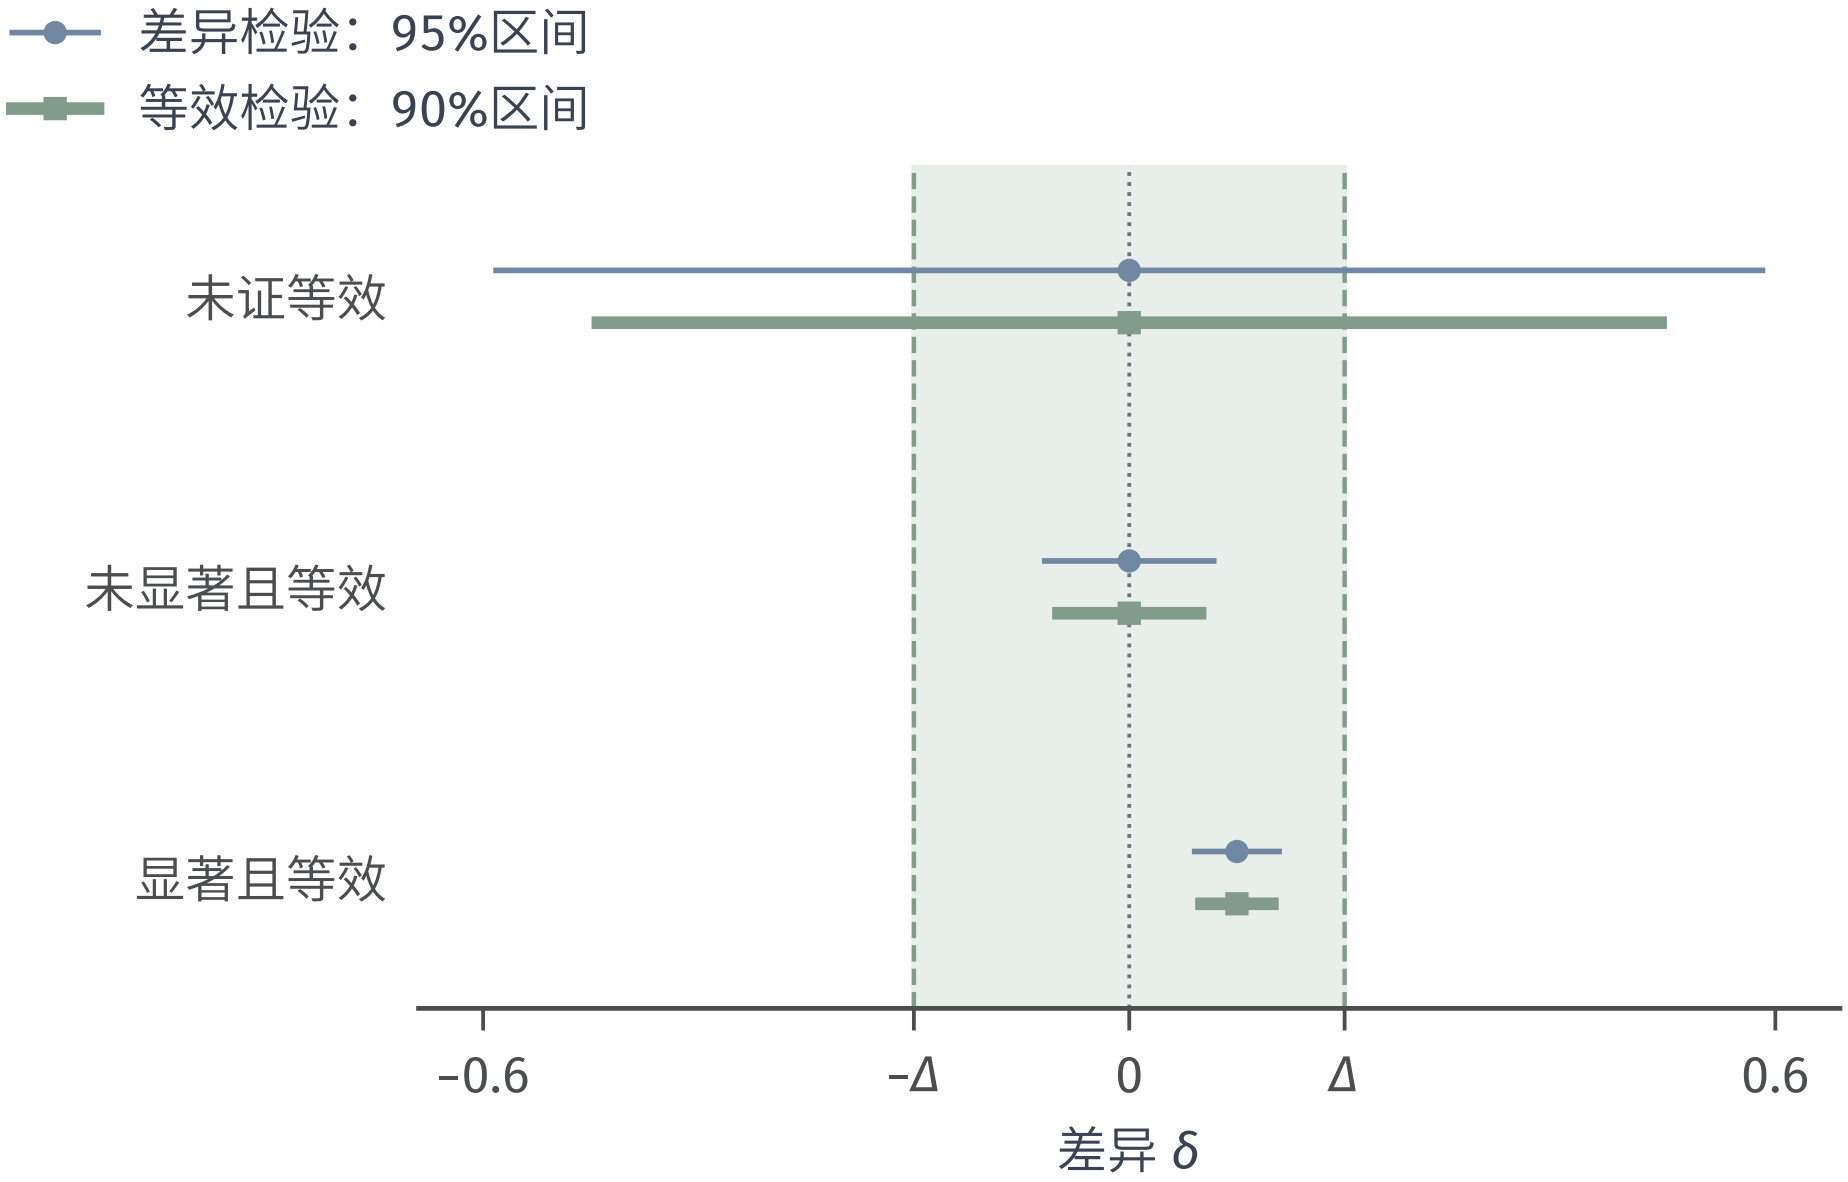
差异检验：95%区间
等效检验：90%区间
未证等效
未显著且等效
显著且等效
−0.6
−Δ
0
Δ
0.6
差异 δ