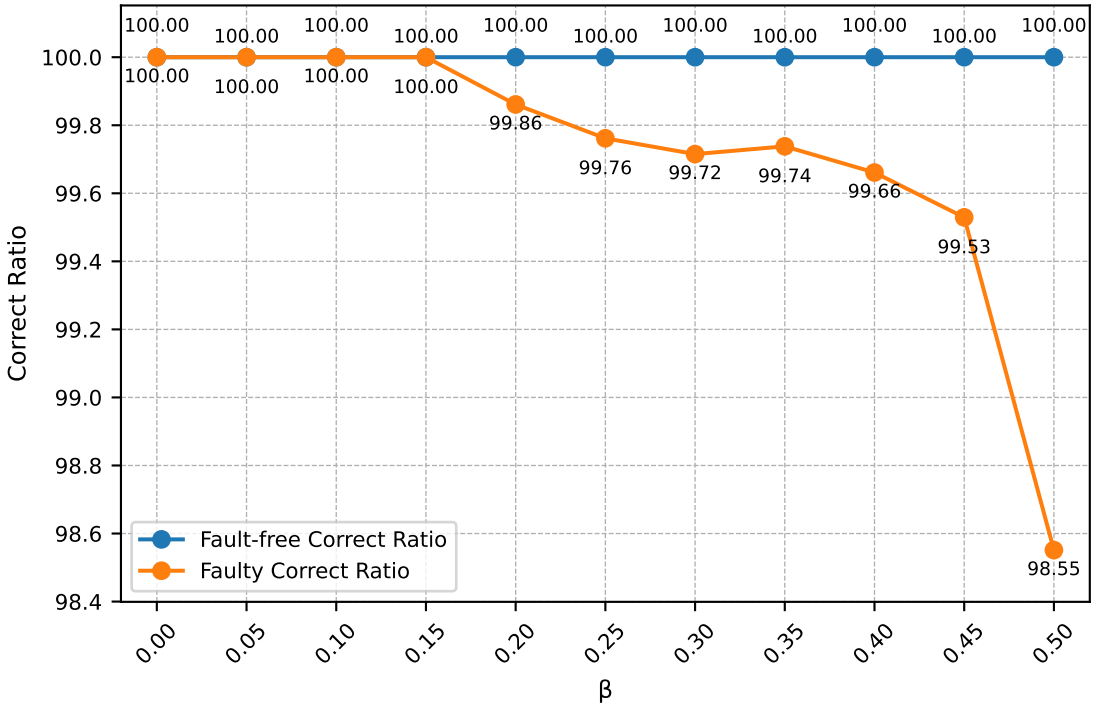
Diagnosis Performance (n=6, k=3, p=0.9, γ=0.9)
Correct Ratio
β
Fault-free Correct Ratio
Faulty Correct Ratio
100.0
99.8
99.6
99.4
99.2
99.0
98.8
98.6
98.4
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.86
99.76
99.72
99.74
99.66
99.53
98.55