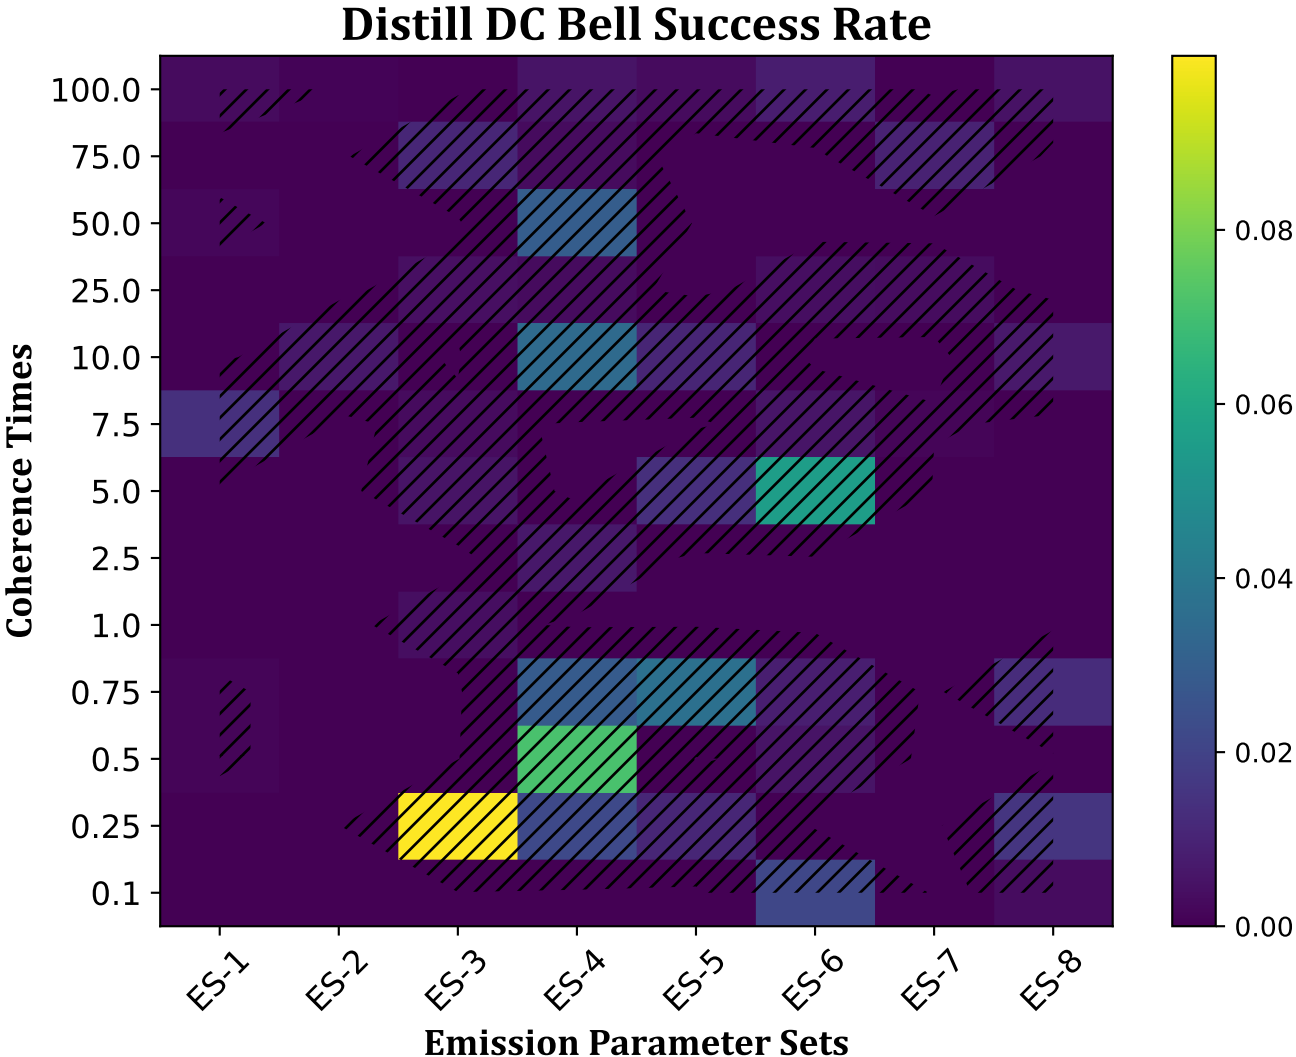
Distill DC Bell Success Rate
Coherence Times
100.0
75.0
50.0
25.0
10.0
7.5
5.0
2.5
1.0
0.75
0.5
0.25
0.1
ES-1
ES-2
ES-3
ES-4
ES-5
ES-6
ES-7
ES-8
Emission Parameter Sets
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00