




Test Precision:(2,10)

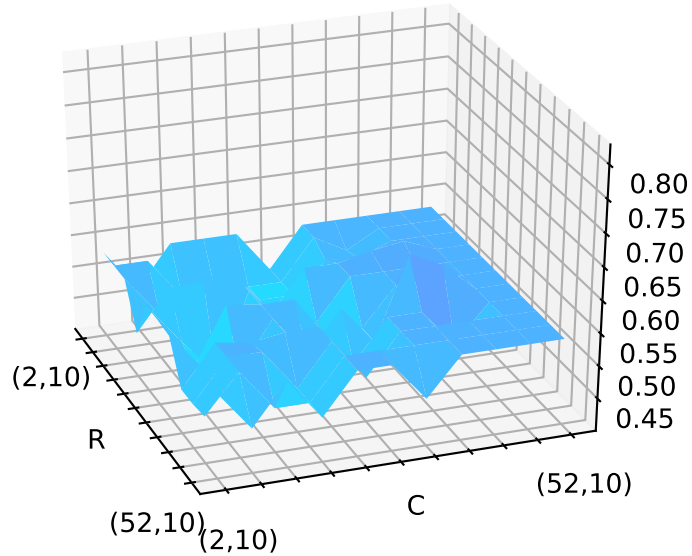


Test Precision:(3,10)

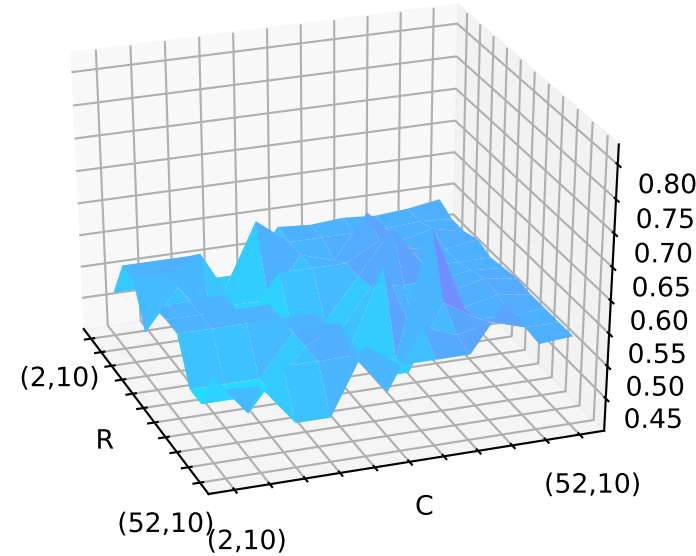


Test Precision:(4,10)

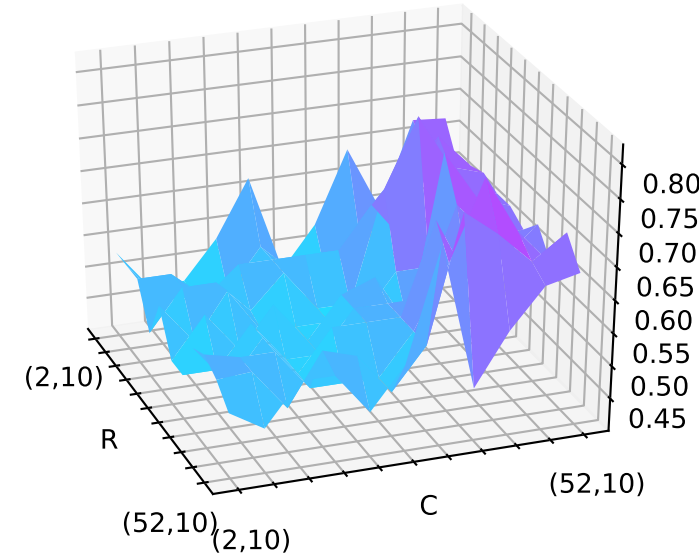


Test Precision:(5,10)

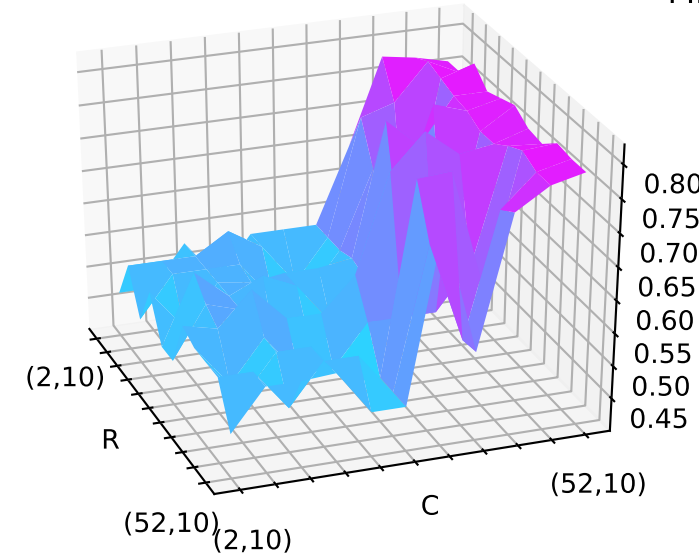


Test Precision:(6,10)

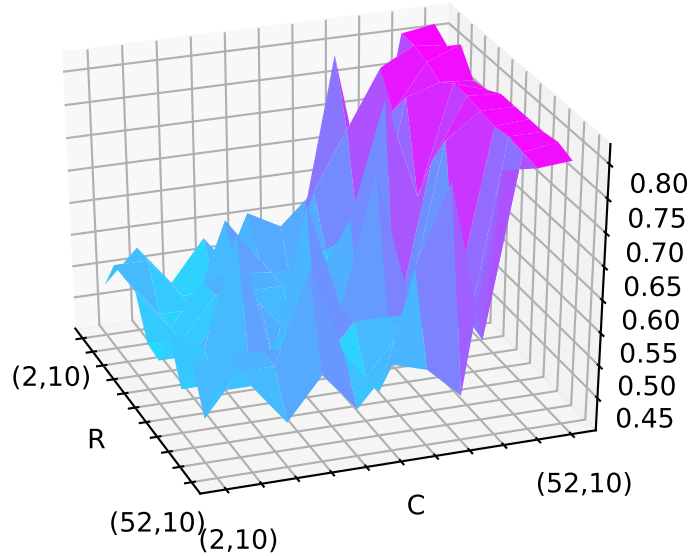


Test Precision:(7,10)

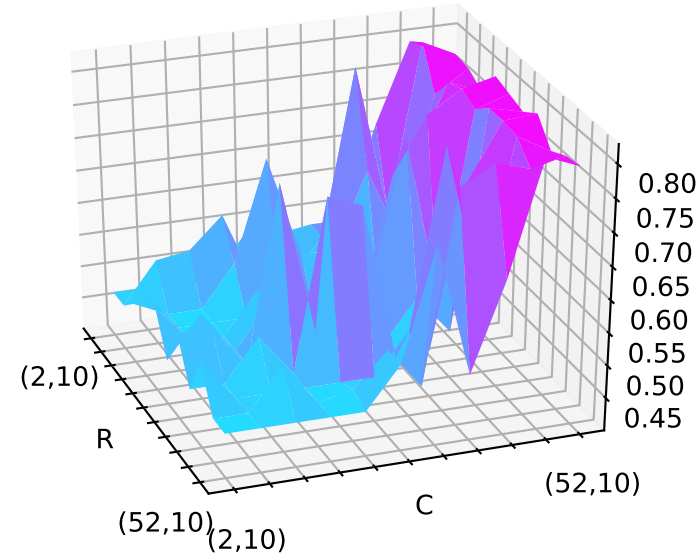


Test Precision:(8,10)

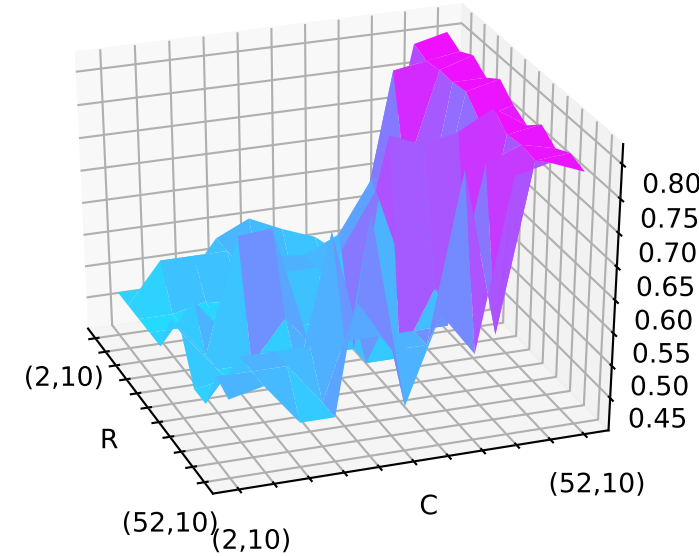


Test Precision:(9,10)

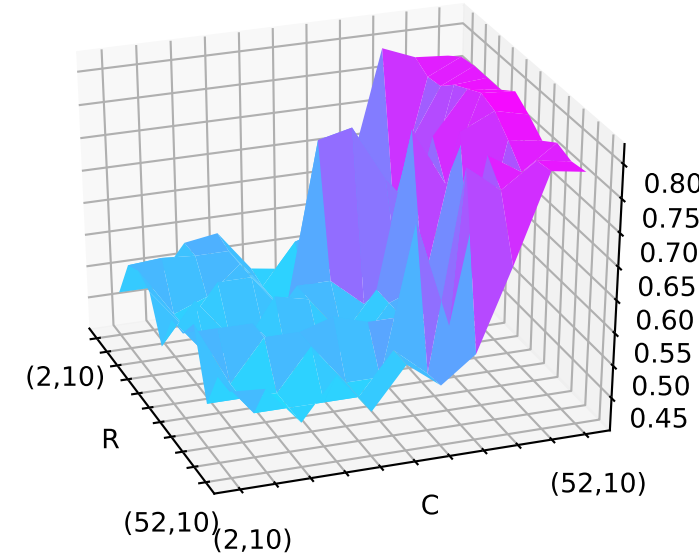


Test Precision:(10,10)

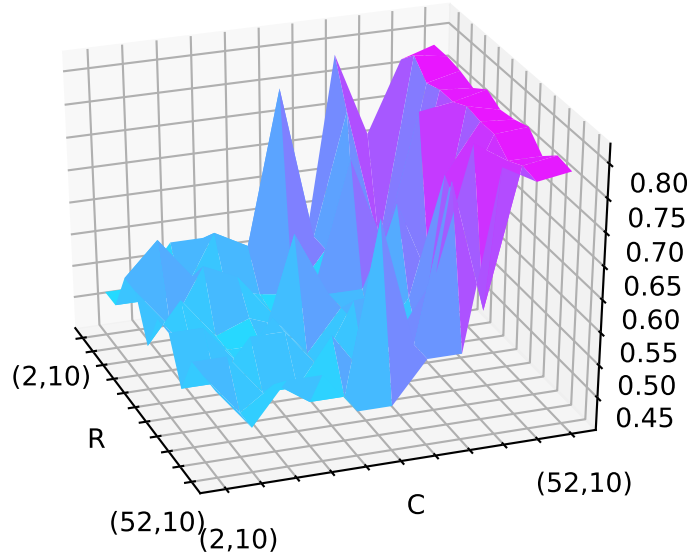

Test Precision:(23,10)

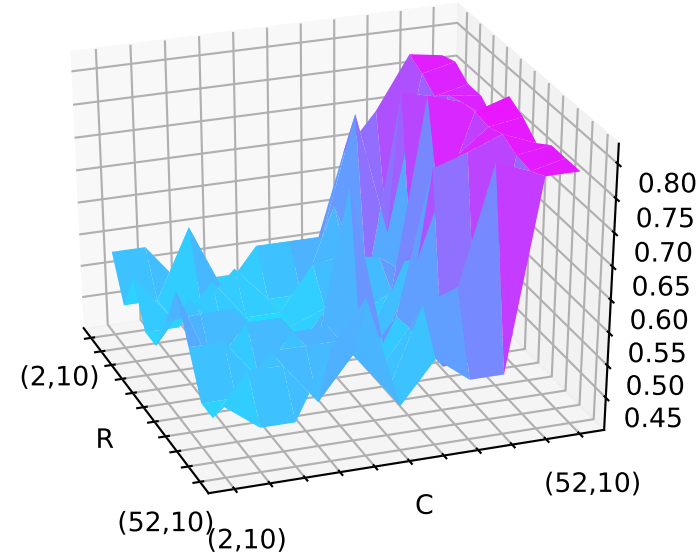

Test Precision:(52,10)

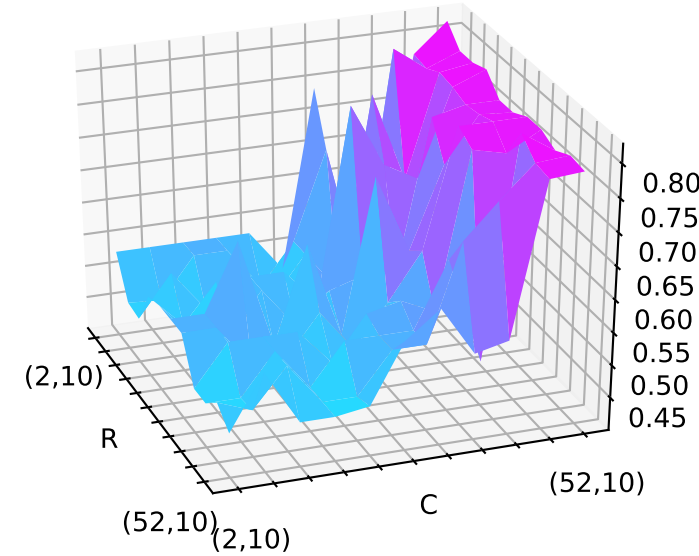

MPFRpart1SVMTest

0.80

0.75

0.70

0.65

0.60

0.55

0.50

0.45