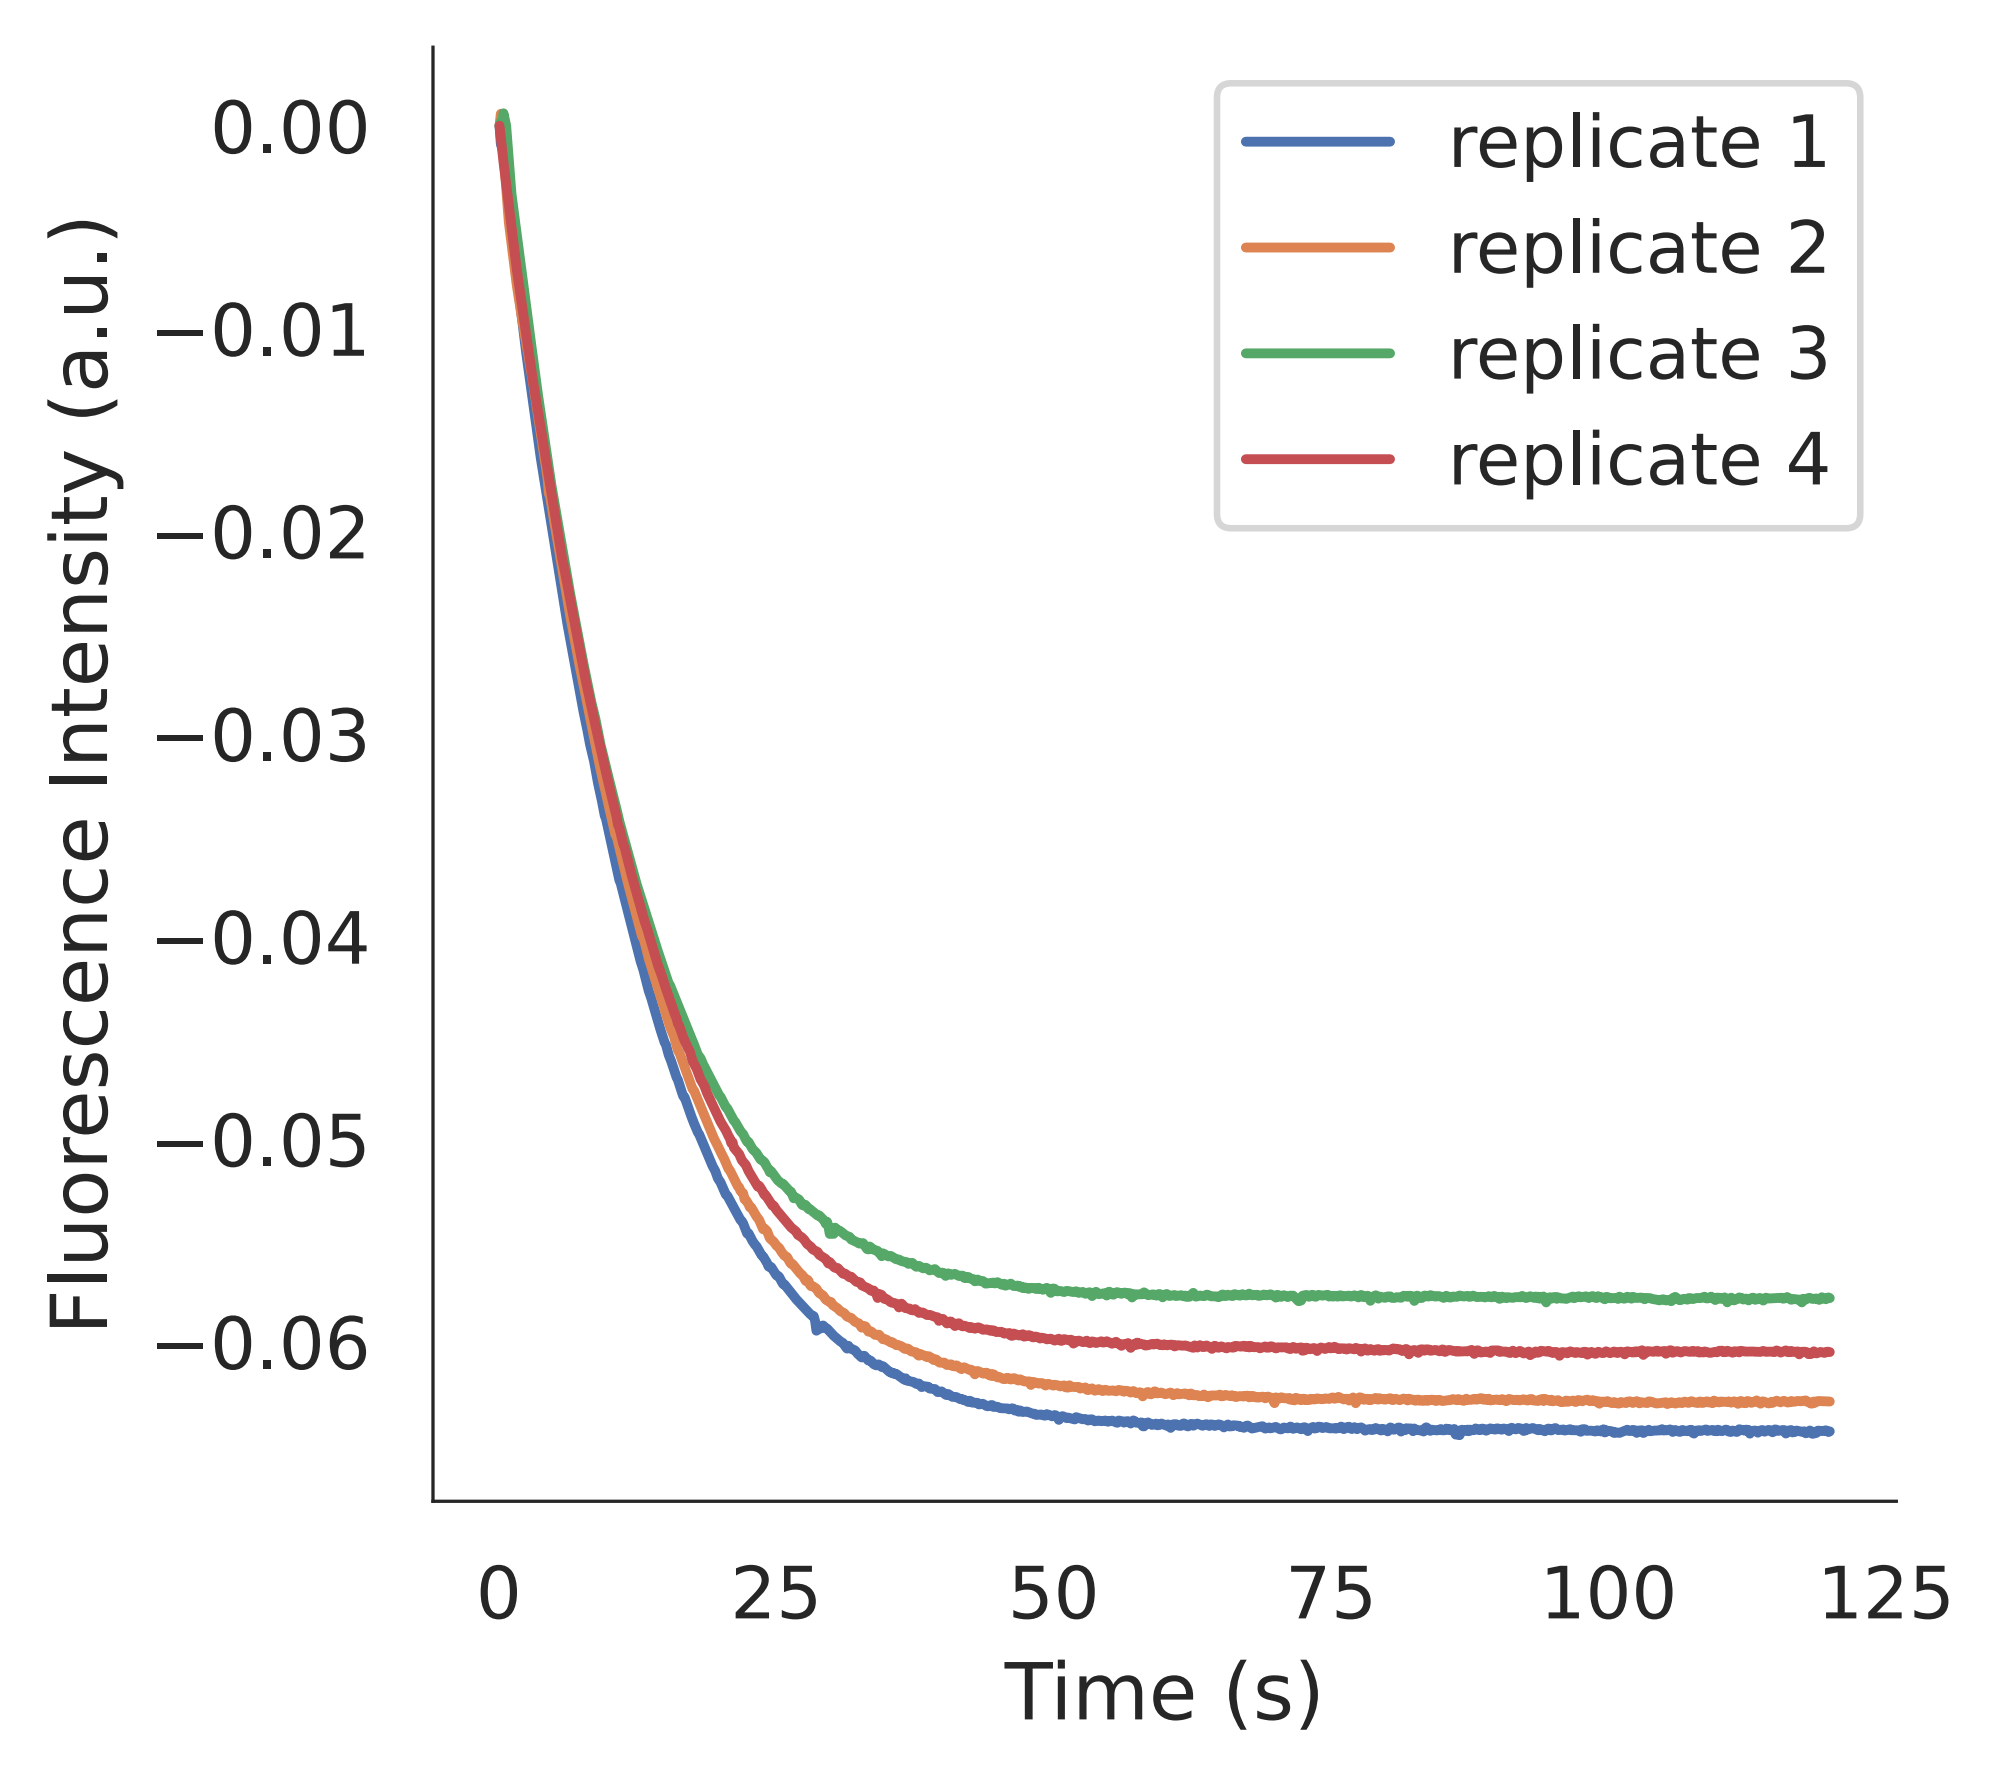
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
−0.05
−0.06
Fluorescence Intensity (a.u.)
0
25
50
75
100
125
Time (s)
replicate 1
replicate 2
replicate 3
replicate 4