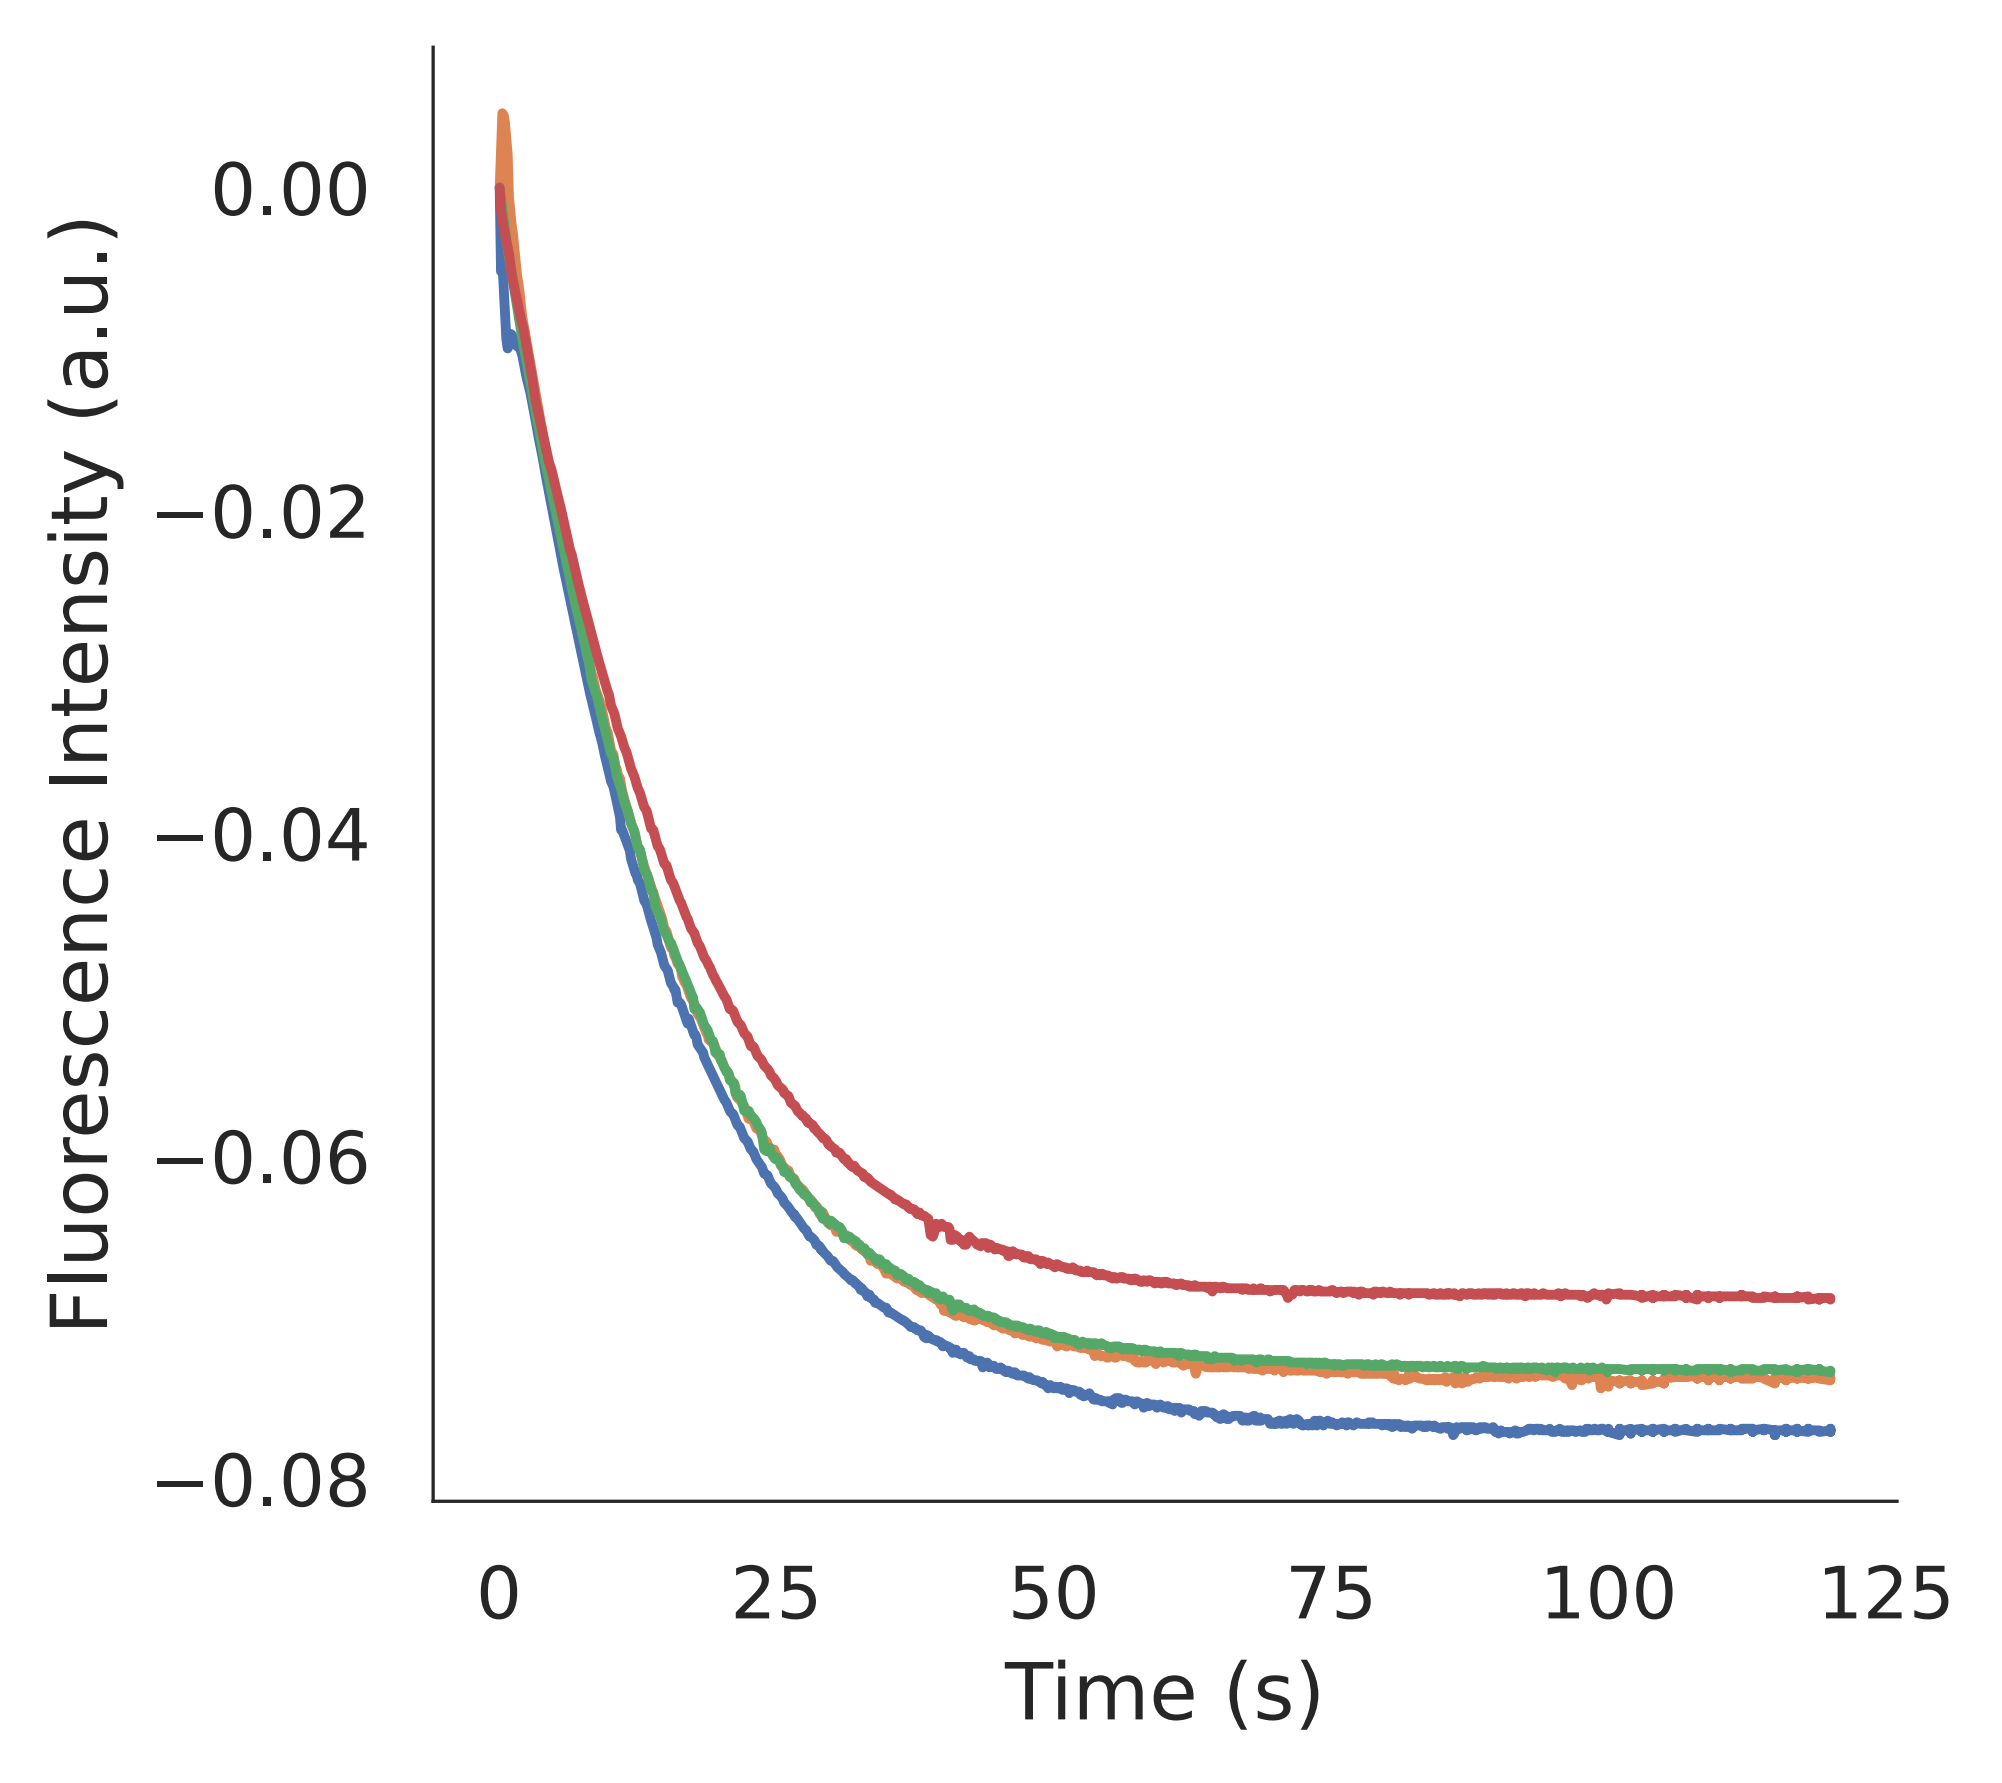
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
Fluorescence Intensity (a.u.)
0
25
50
75
100
125
Time (s)