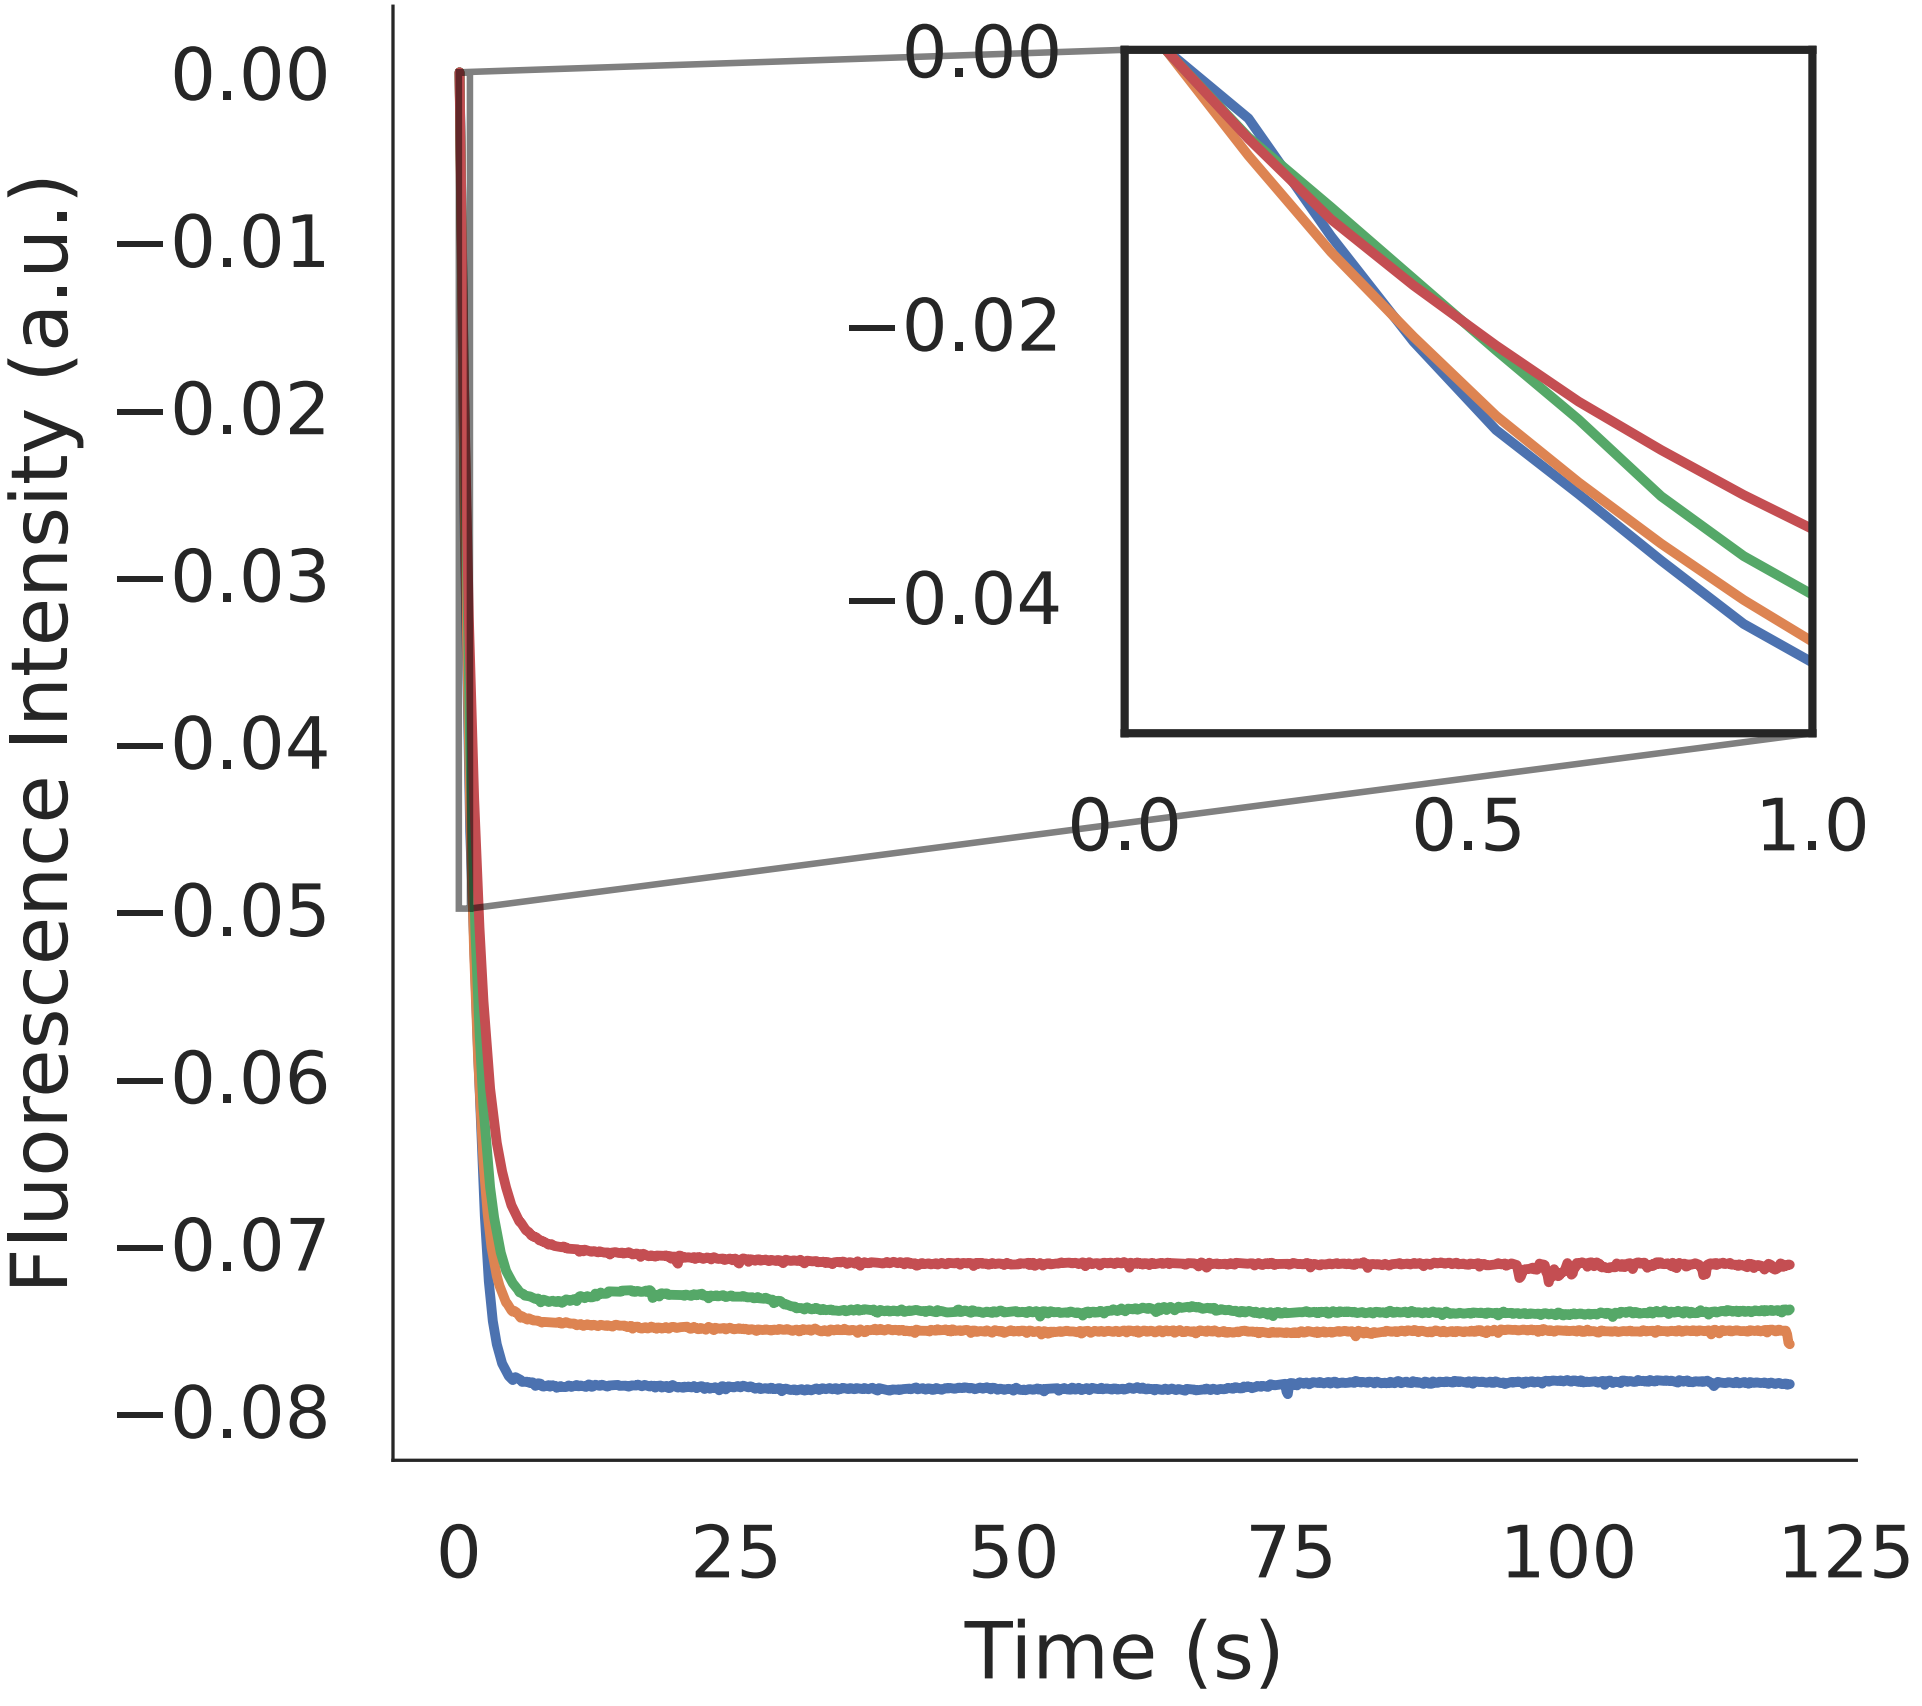
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
−0.05
−0.06
−0.07
−0.08
Fluorescence Intensity (a.u.)
0
25
50
75
100
125
Time (s)
0.00
−0.02
−0.04
0.0
0.5
1.0