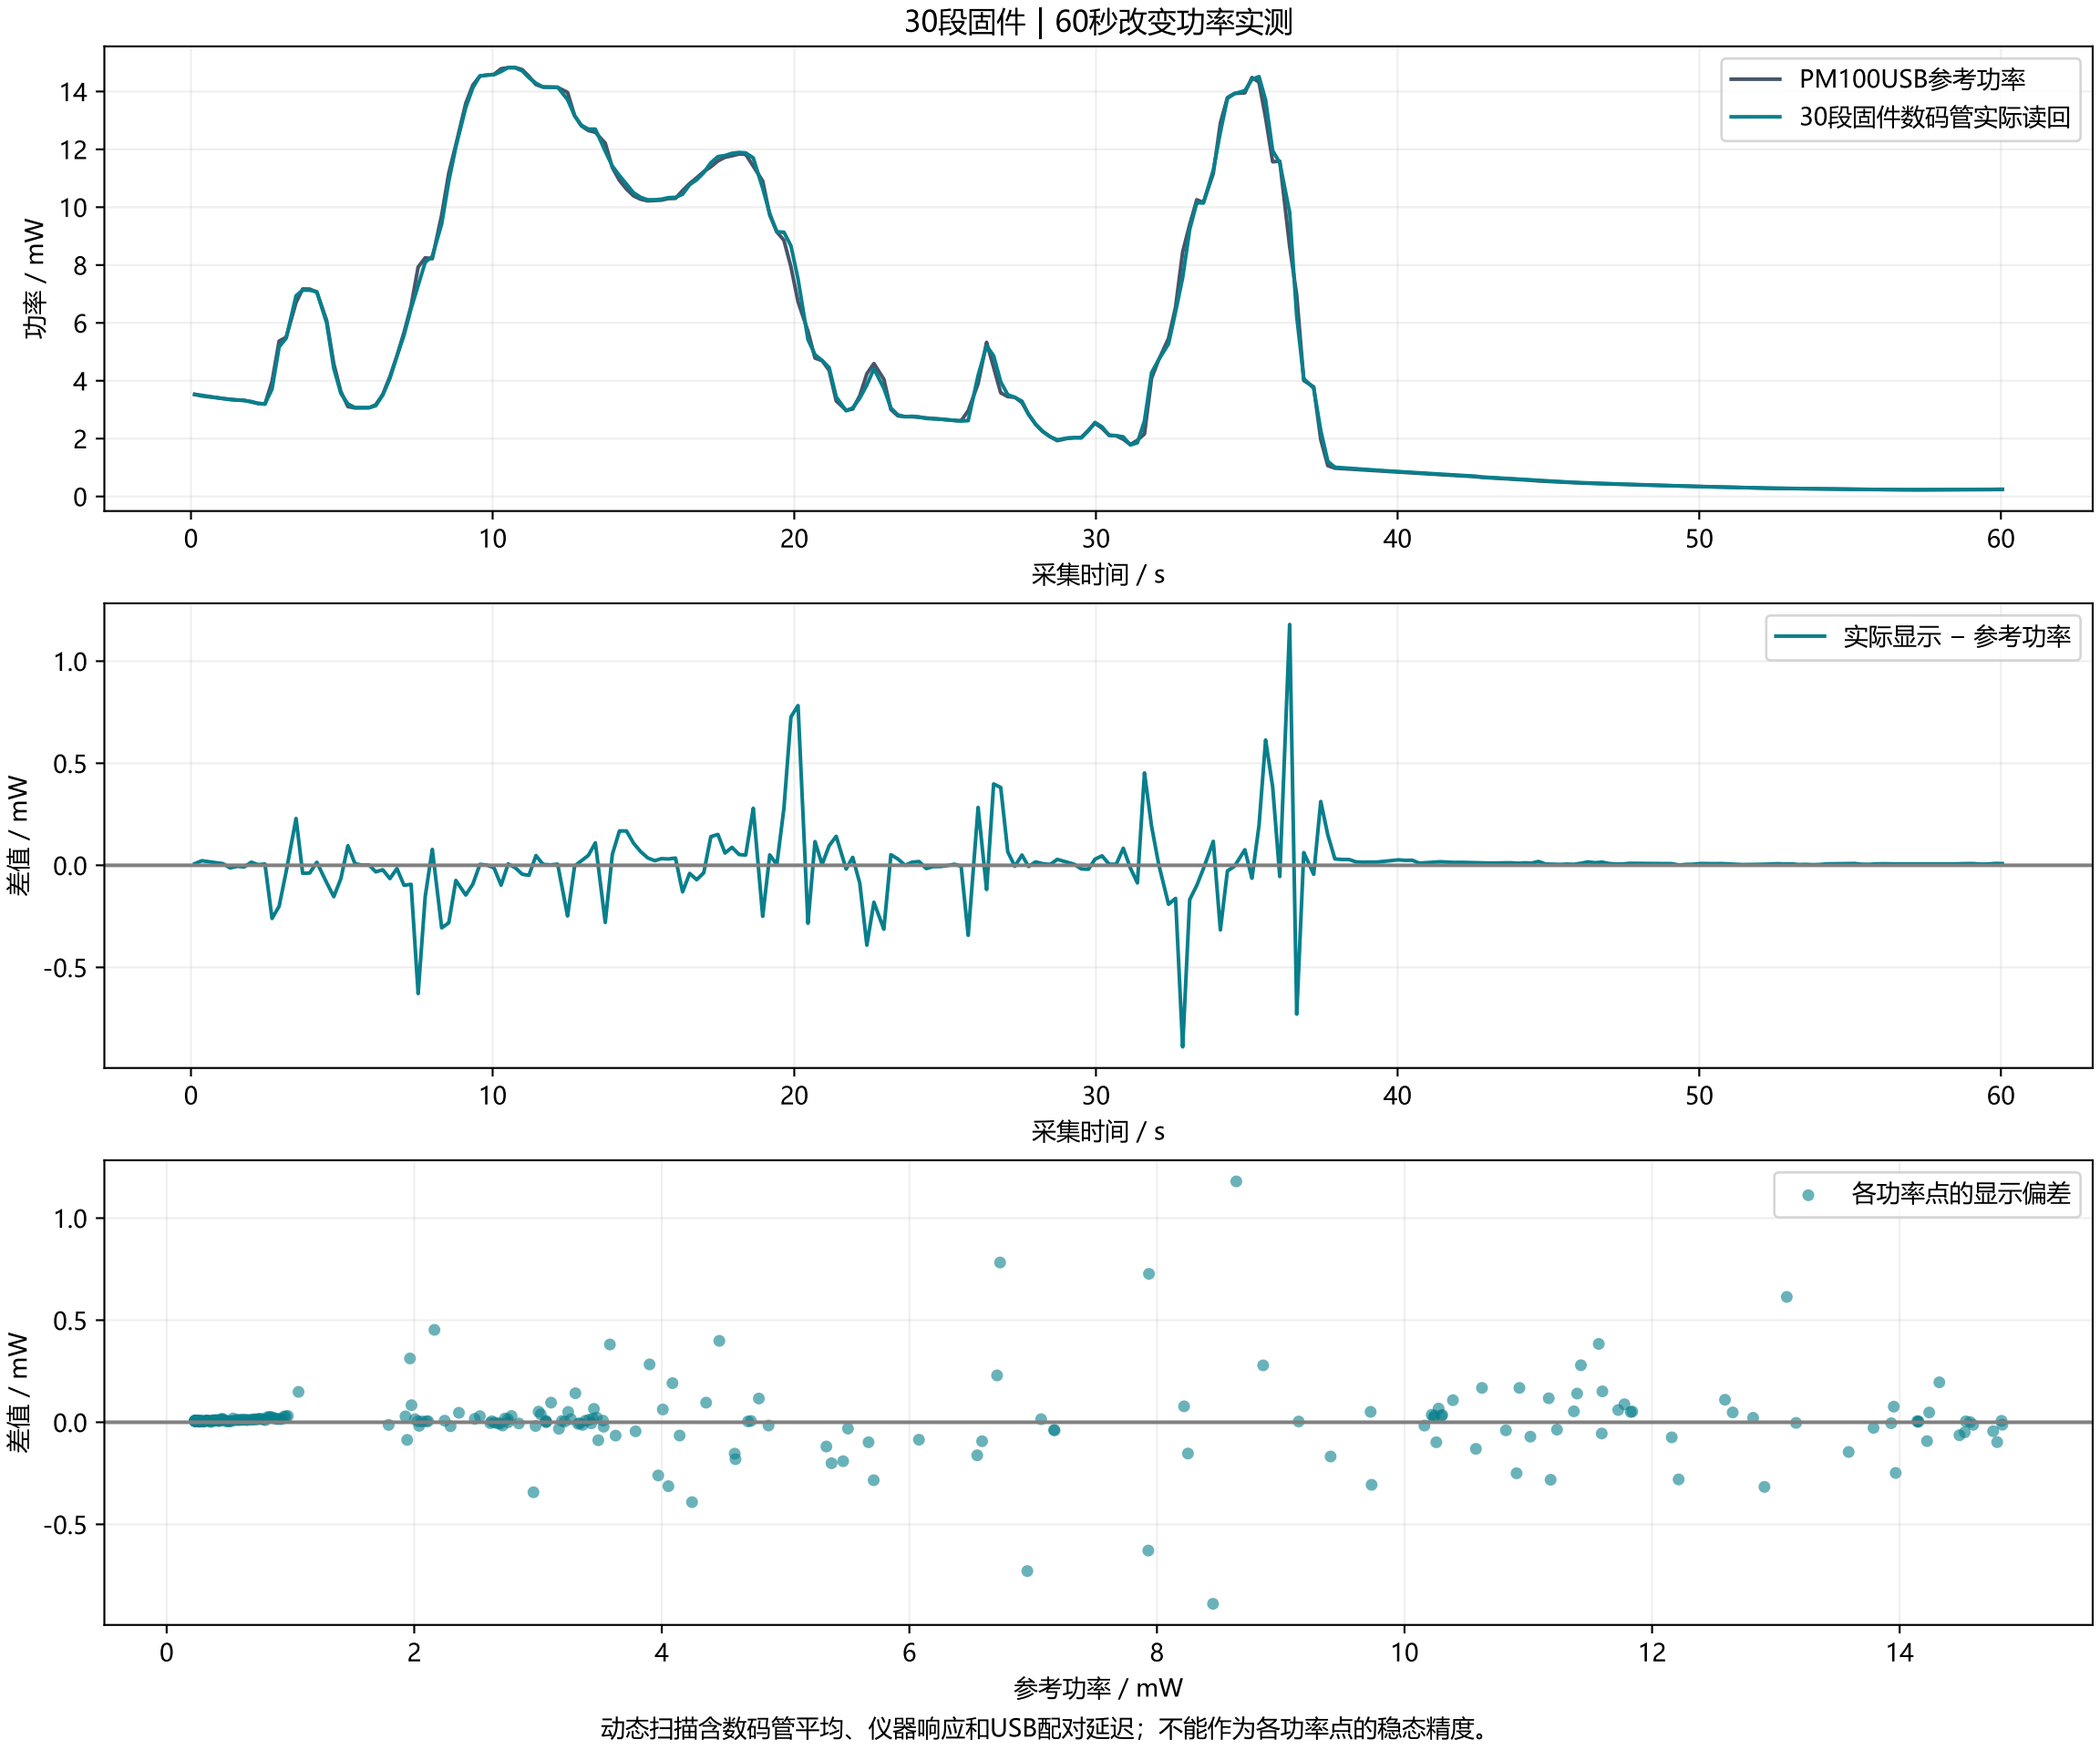

动态扫描含数码管平均、仪器响应和USB配对延迟；不能作为各功率点的稳态精度。