



# Gepulste Entladung - Spannungsvergleich

## Gemeinsamer Aufzeichnungszeitraum


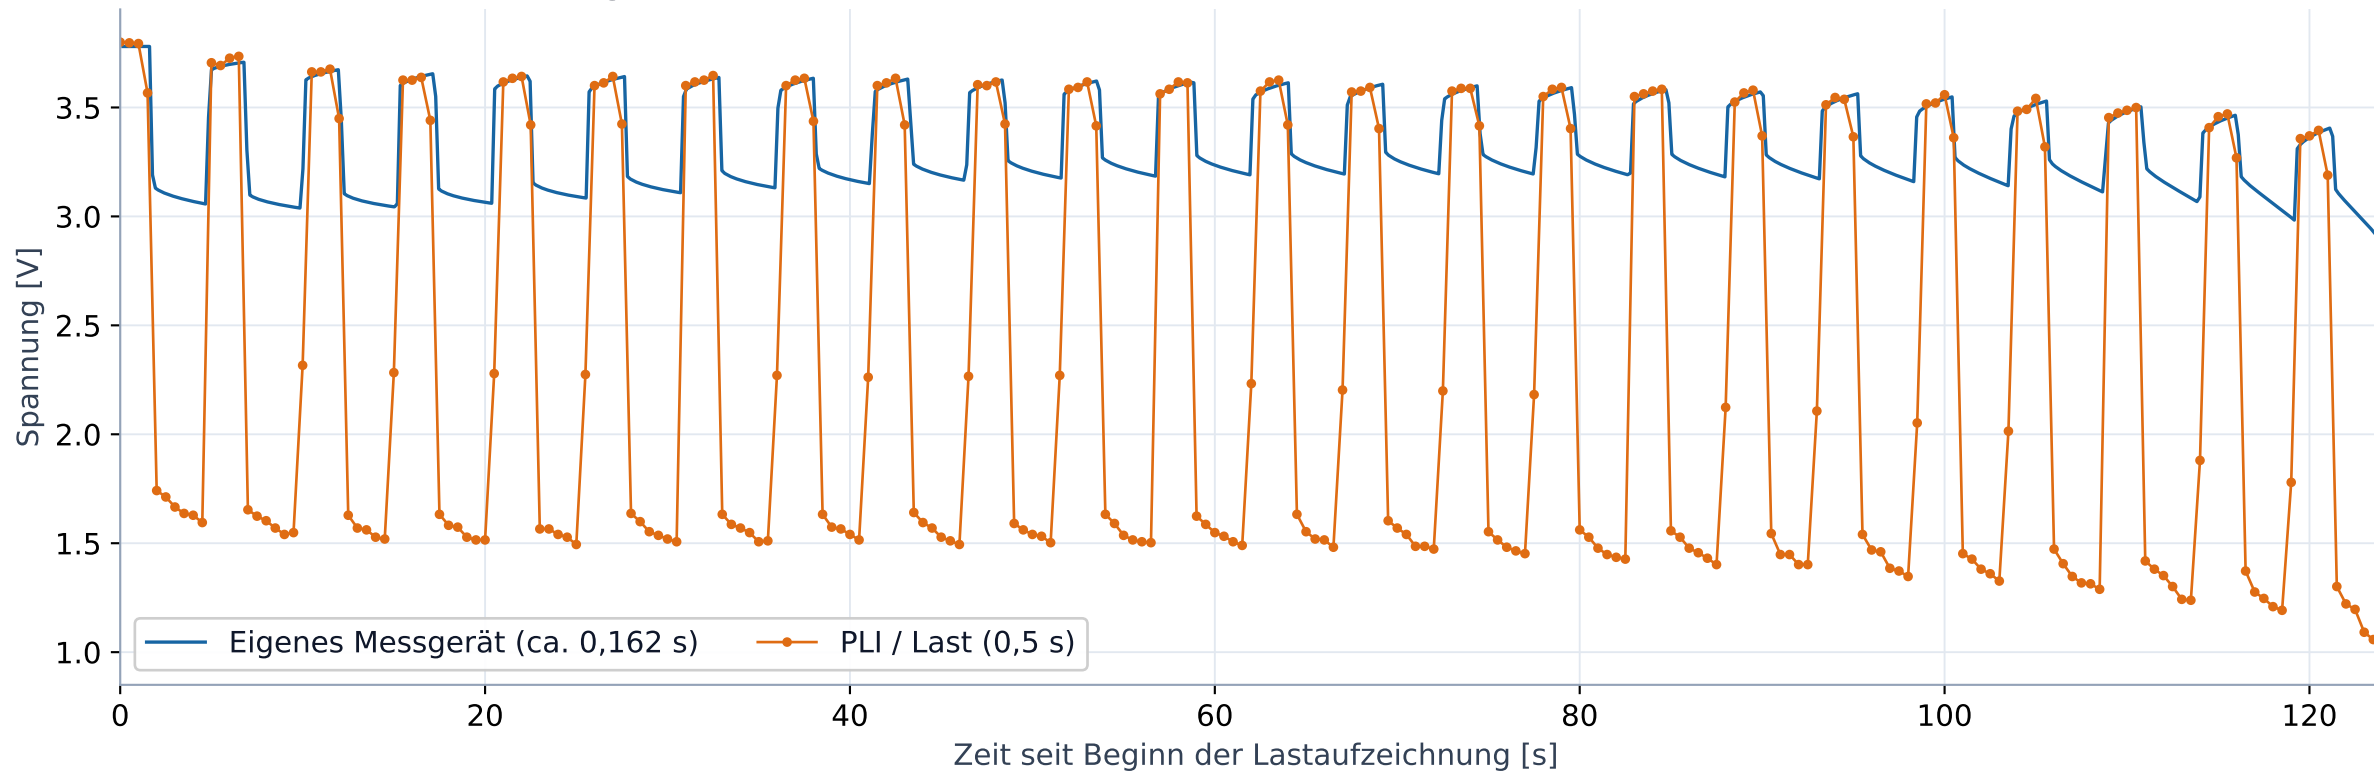


## Detail: erste Pulse

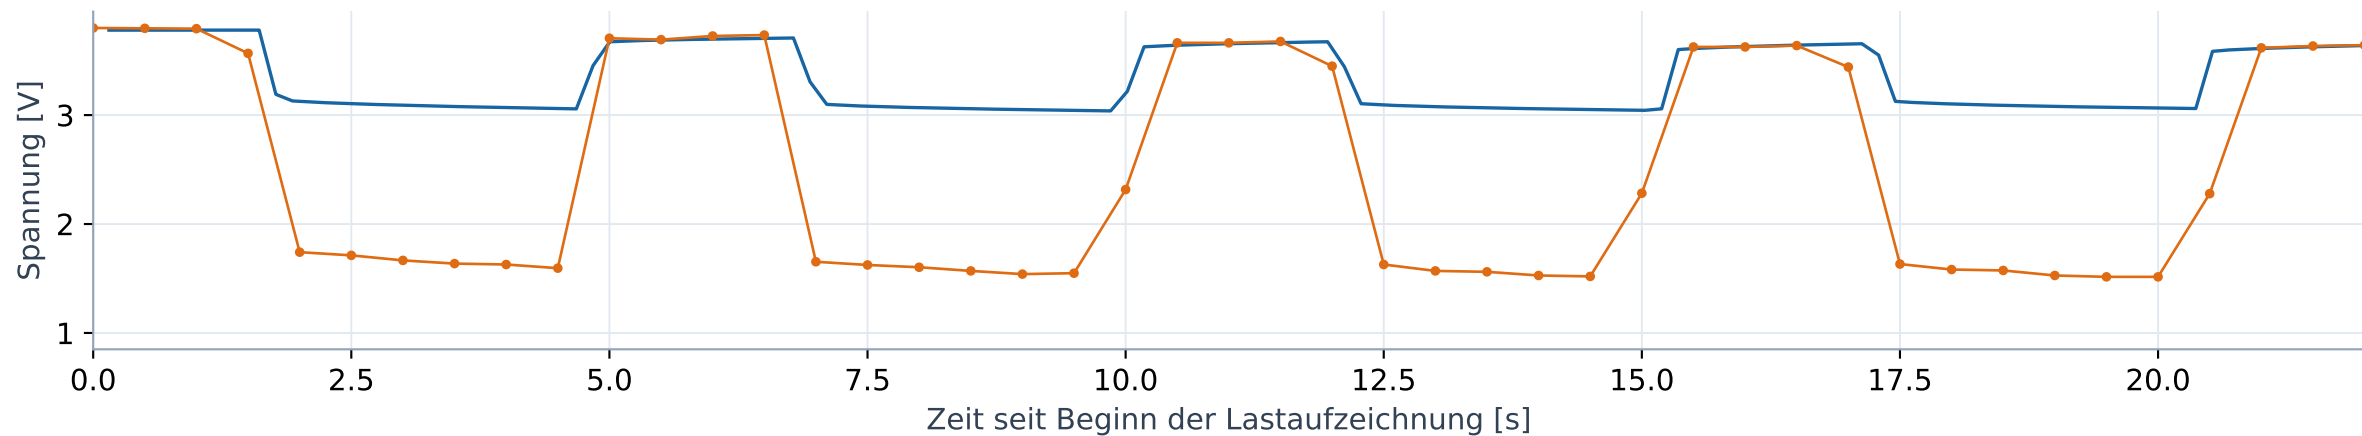

Zeitabgleich:  $t = t_{\text{Messgerät}} - 0.65 \text{ s}$ . Originale Spannungswerte; Linien verbinden Messpunkte.  
Schaltzeiten der PLI sind durch das 0,5-s-Raster nur näherungsweise bestimmbar.

# Gepulste Entladung - Temperaturverlauf

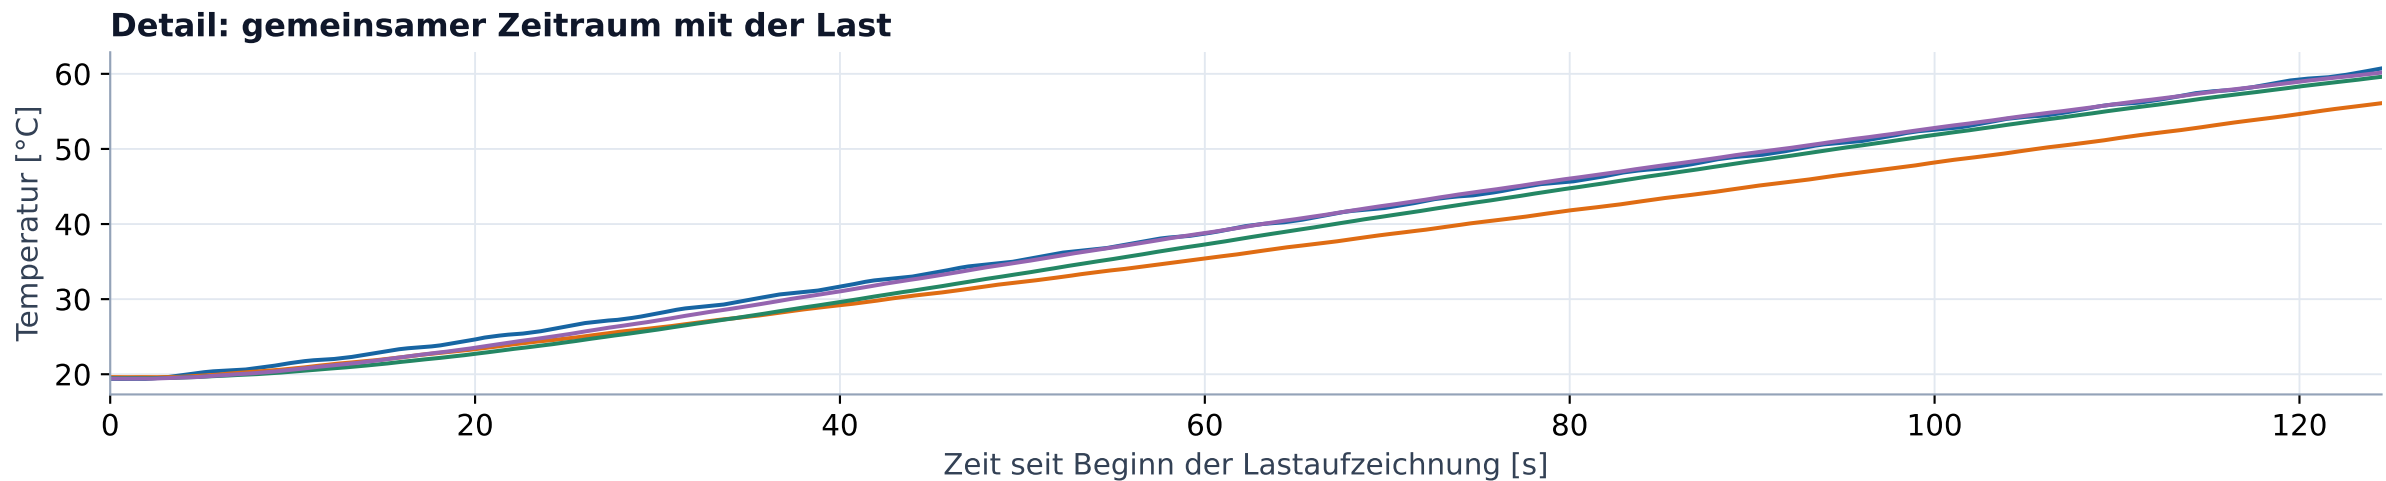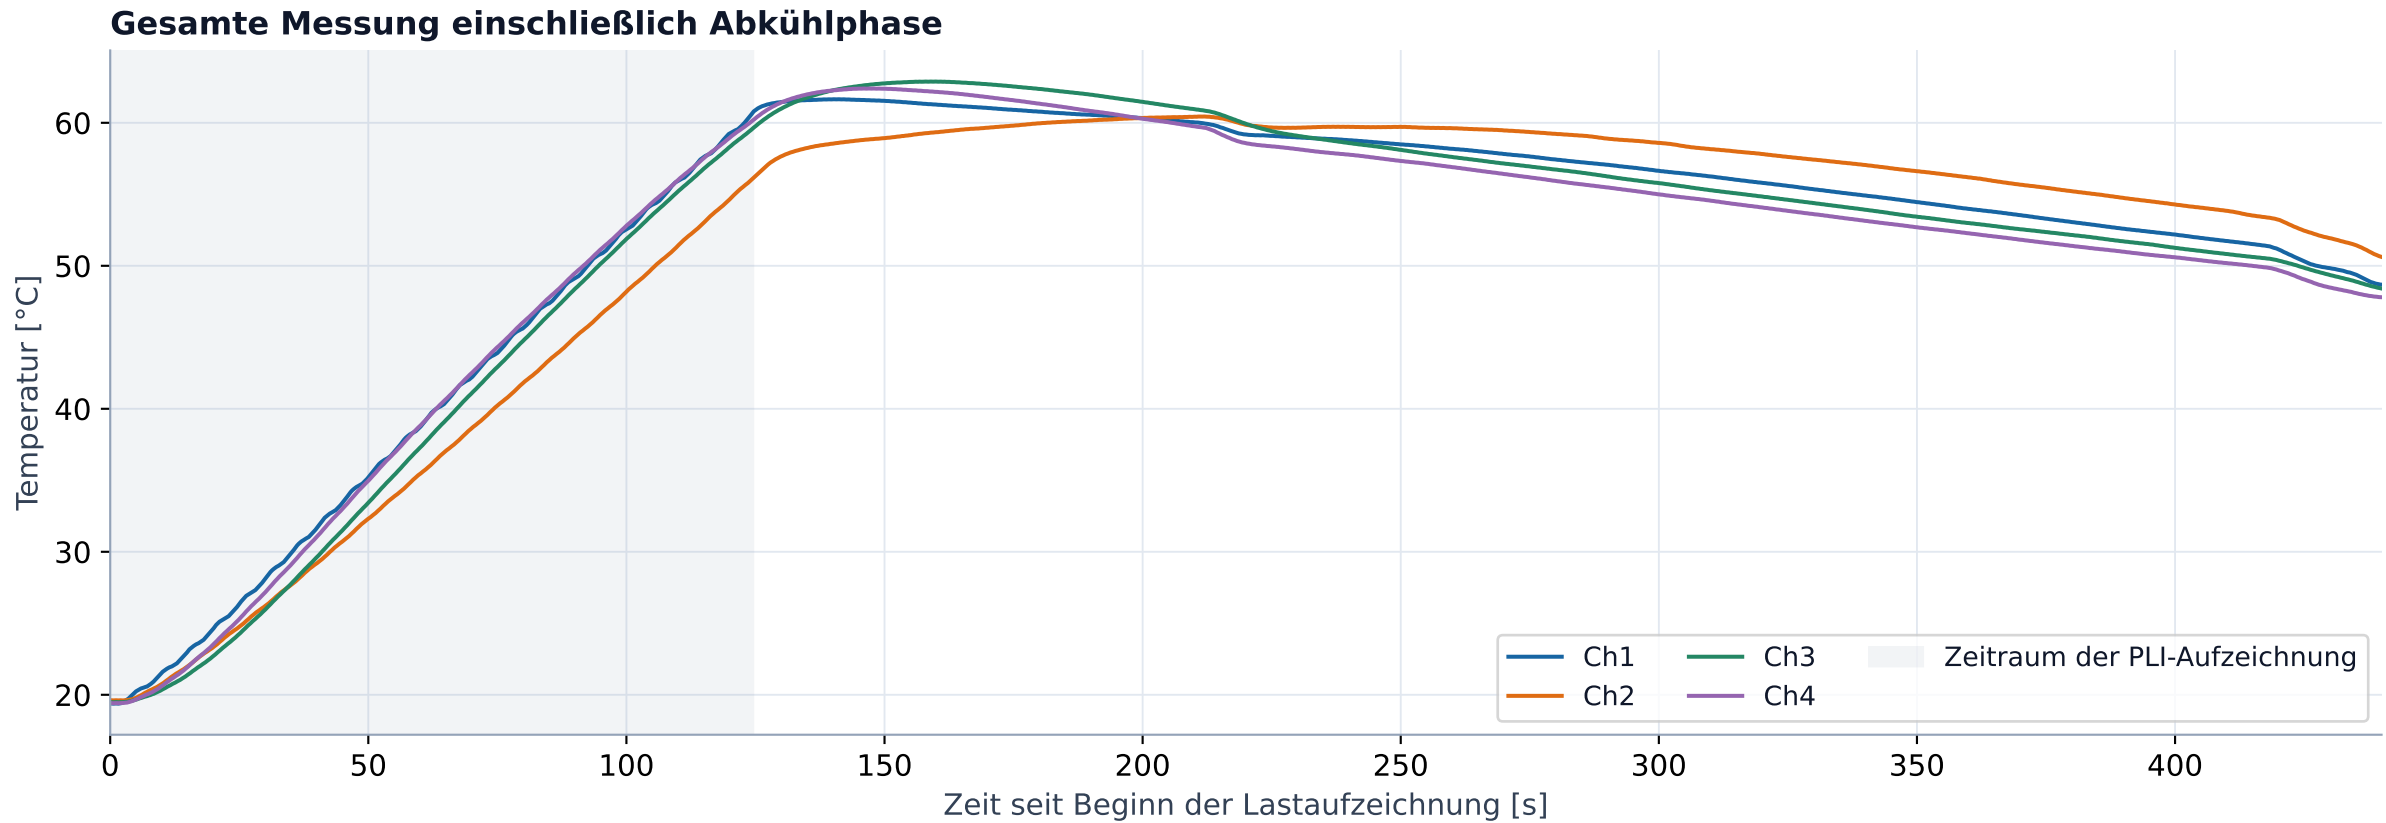

Gleicher Zeitabgleich wie im Spannungsdiagramm. Kanalbezeichnungen gemäß Messdatei; Temperaturen als °C interpretiert.