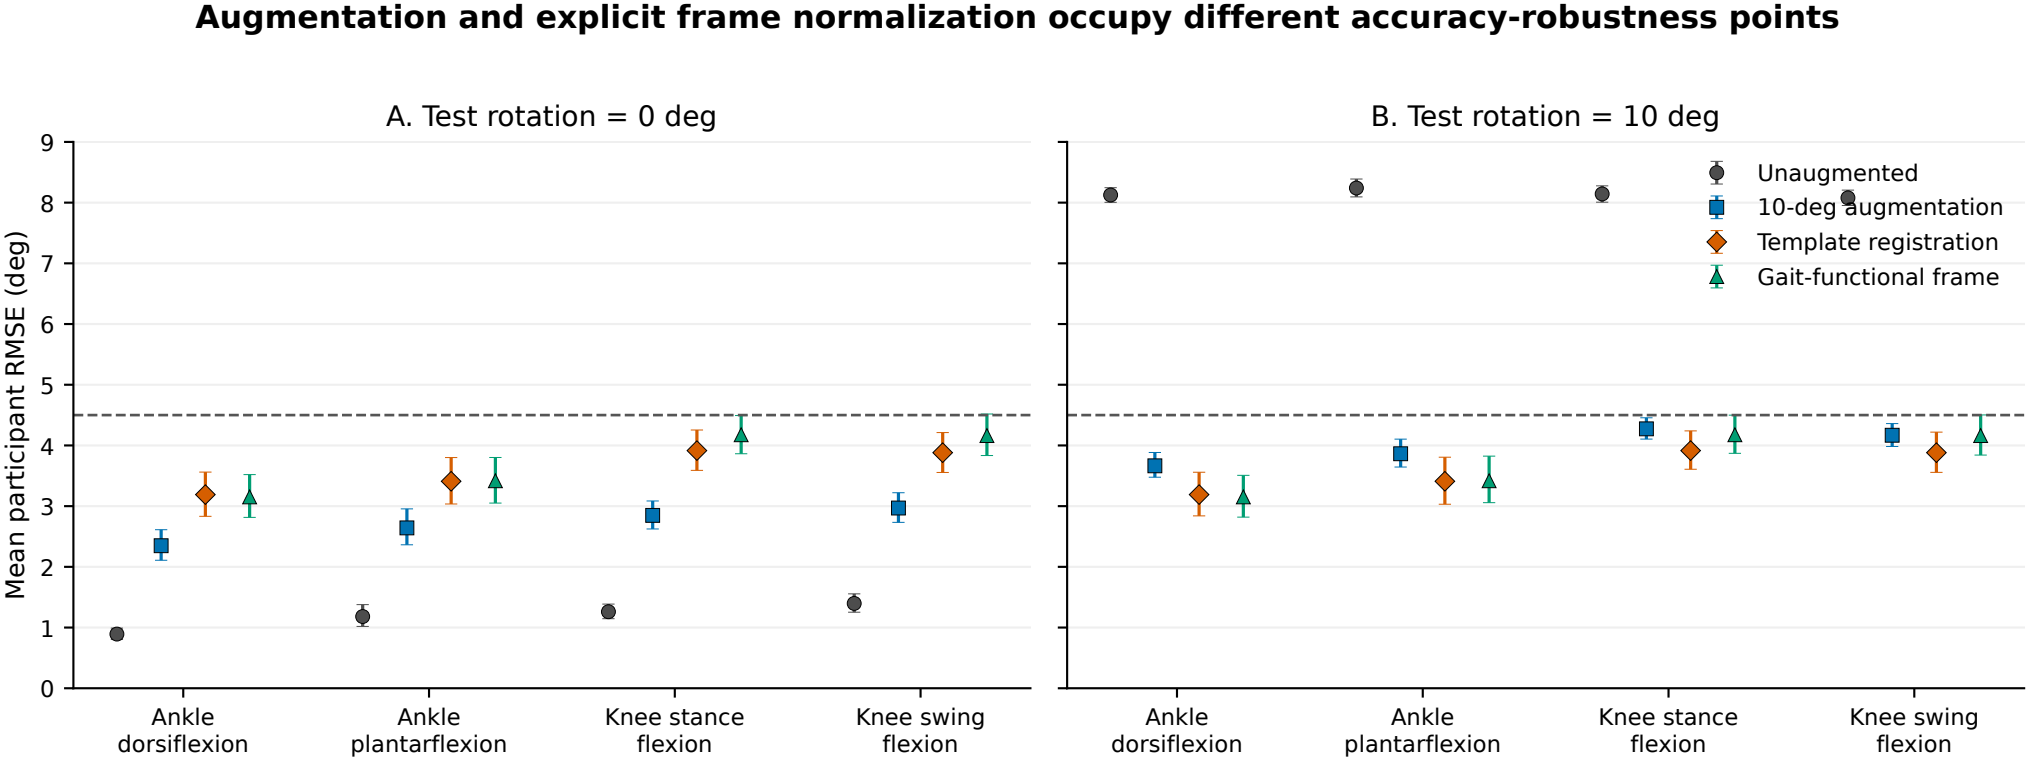
Augmentation and explicit frame normalization occupy different accuracy-robustness points
A. Test rotation = 0 deg
B. Test rotation = 10 deg
Mean participant RMSE (deg)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Unaugmented
10-deg augmentation
Template registration
Gait-functional frame
Ankle dorsiflexion
Ankle plantarflexion
Knee stance flexion
Knee swing flexion