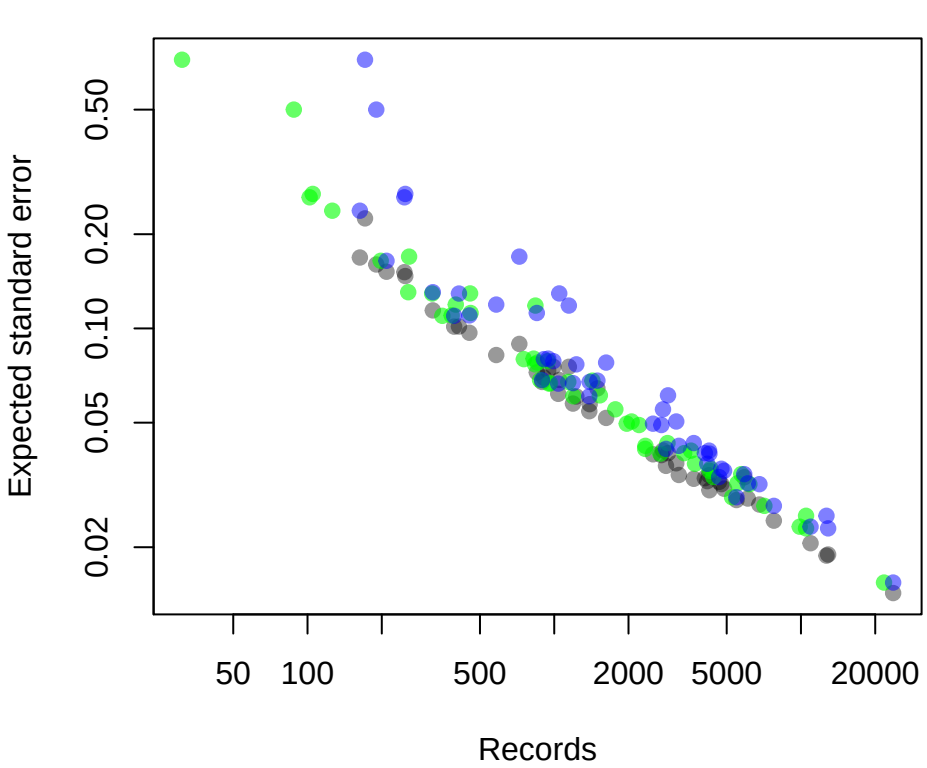
Expected standard error
0.02
0.05
0.10
0.20
0.50
50
100
500
2000
5000
20000
Records

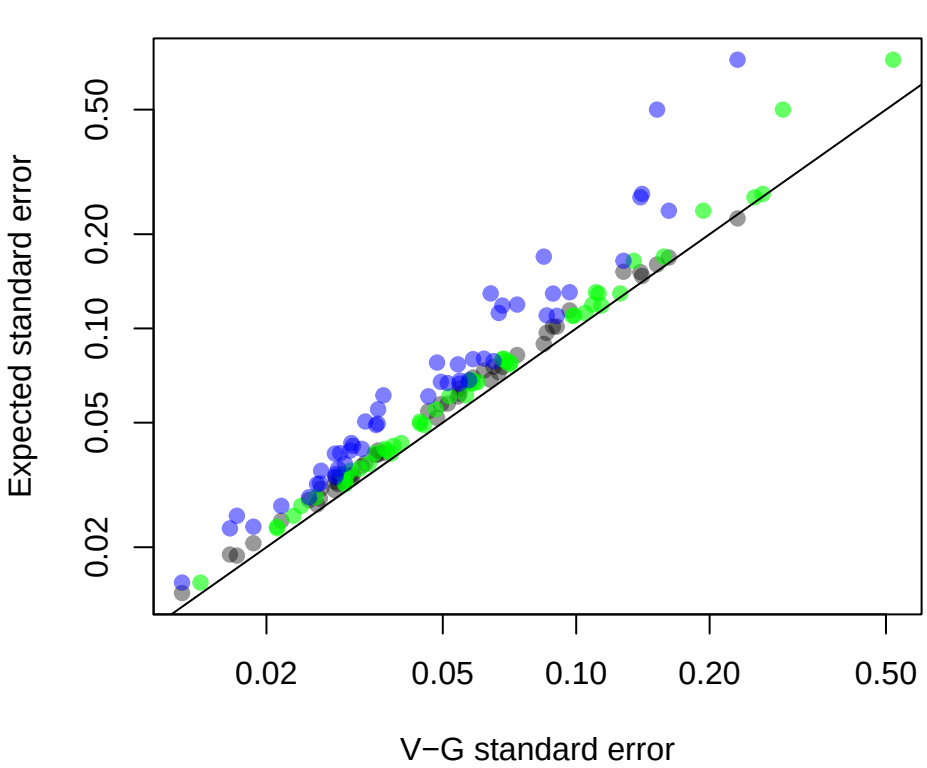
Expected standard error
0.02
0.05
0.10
0.20
0.50
V−G standard error